



KLION Report

Proprietà Sito

Sito: GE006_Costafigara

Attuatore: Comune di Rezzoaglio

Proprietà Tubo

Nome: S3_RM126

Azimuth [°]: 330,00

Latitudine: 44,512132

Altitudine [m s.l.m.]: 810


Orientamento: VERTICALE

Longitudine: 9,369108

Sporgenza dal Suolo [m]: 0

Posizione

Orientamento

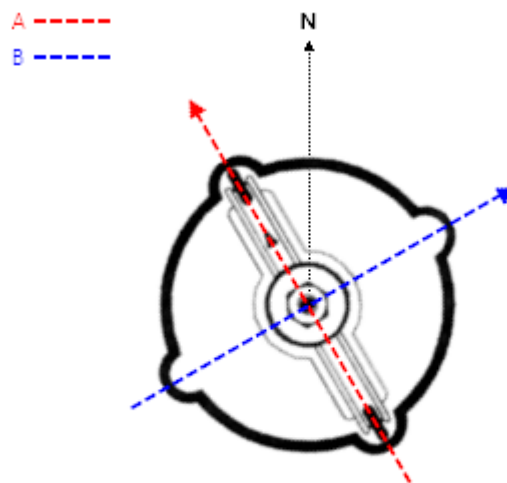

Azimuth [°]: 330,00

Opzioni di elaborazione inclinometrica

Riferimento al fondo: Sì

Relativo – variazione dalla misura di riferimento

Correzione Bias Shift: No

Compensazione spiralometrica: No

Curva cumulata

Misura di riferimento: 16/06/2009 00:00		
Spostamenti rispetto alla verticale		
Prof [m]	Nord [mm]	Est [mm]
0,50	-3,07	-1,14
1,00	-3,15	-1,25
1,50	-3,03	-1,87
2,00	-2,70	-2,61
2,50	0,03	-4,96
3,00	-0,17	-2,05
3,50	-0,56	-2,40
4,00	0,17	-4,11
4,50	0,91	-4,07
5,00	0,45	-2,04
5,50	-0,07	0,71
6,00	-0,97	1,74
6,50	-0,34	1,57
7,00	0,27	1,06
7,50	0,61	0,52
8,00	0,72	0,16
8,50	0,89	0,85
9,00	2,19	1,11
9,50	2,10	1,13
10,00	1,90	1,11
10,50	1,71	0,92
11,00	1,70	0,48
11,50	2,45	0,07
12,00	2,63	-0,23
12,50	2,72	-0,81
13,00	2,87	-1,05
13,50	3,07	-0,98
14,00	3,33	-0,65
14,50	2,94	0,57
15,00	2,61	1,62
15,50	2,96	1,46
16,00	3,25	0,99
16,50	3,49	0,43
17,00	3,65	-0,01
17,50	4,05	1,05
18,00	5,13	2,22
18,50	5,83	2,38
19,00	5,91	2,34
19,50	5,52	1,98
20,00	5,28	1,71
20,50	6,35	1,17
21,00	6,88	0,55
21,50	6,91	0,82
22,00	6,94	0,67
22,50	7,10	0,41
23,00	7,38	0,19
23,50	8,09	0,53
24,00	7,96	1,45
24,50	8,01	1,78
25,00	8,16	2,09
25,50	8,25	2,16

Misura inclinometrica del 29/06/2010 00:00

Data/Ora: 29/06/2010 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314.

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 16/06/2009 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Elaborazione dati - misura del 29/06/2010 00:00						
			Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	809,50	-0,20	0,18	0,27	137,91	-0,75	-15,32	15,34	267,18
1,00	809,00	-0,22	0,02	0,22	175,11	-0,56	-15,50	15,51	267,95
1,50	808,50	-0,22	-0,64	0,67	250,68	-0,33	-15,52	15,52	268,76
2,00	808,00	0,03	-2,05	2,05	270,78	-0,11	-14,88	14,88	269,57
2,50	807,50	0,62	-4,39	4,43	278,07	-0,14	-12,83	12,83	269,37
3,00	807,00	-0,27	-0,97	1,01	254,38	-0,76	-8,44	8,48	264,85
3,50	806,50	-0,43	-0,92	1,02	244,94	-0,49	-7,47	7,49	266,24
4,00	806,00	-0,12	-2,30	2,30	267,12	-0,06	-6,55	6,55	269,47
4,50	805,50	0,23	-2,52	2,53	275,14	0,06	-4,25	4,25	270,75
5,00	805,00	-0,01	-1,42	1,42	269,62	-0,17	-1,73	1,74	264,36
5,50	804,50	-0,28	-0,18	0,33	212,95	-0,16	-0,32	0,36	243,01
6,00	804,00	-0,30	0,44	0,53	124,94	0,11	-0,14	0,18	309,68
6,50	803,50	-0,16	0,42	0,45	110,60	0,42	-0,57	0,71	306,14
7,00	803,00	-0,06	0,16	0,17	111,01	0,58	-1,00	1,15	300,10
7,50	802,50	-0,06	-0,04	0,08	215,56	0,64	-1,16	1,32	298,94
8,00	802,00	-0,07	-0,07	0,10	225,96	0,70	-1,11	1,31	302,22
8,50	801,50	0,09	0,03	0,10	15,00	0,77	-1,04	1,29	306,66
9,00	801,00	0,19	0,10	0,22	26,77	0,68	-1,06	1,26	302,55
9,50	800,50	0,18	0,09	0,20	26,31	0,48	-1,16	1,26	292,67
10,00	800,00	0,13	0,04	0,13	18,81	0,30	-1,25	1,29	283,62
10,50	799,50	0,04	-0,03	0,05	330,00	0,18	-1,29	1,31	277,80
11,00	799,00	-0,06	-0,11	0,13	242,86	0,13	-1,27	1,28	276,03
11,50	798,50	0,01	-0,15	0,15	274,99	0,19	-1,16	1,17	279,38
12,00	798,00	0,03	-0,24	0,24	276,57	0,18	-1,00	1,02	280,03
12,50	797,50	-0,07	-0,25	0,26	254,04	0,15	-0,77	0,78	281,10
13,00	797,00	-0,10	-0,20	0,23	243,18	0,22	-0,52	0,56	293,13
13,50	796,50	-0,10	-0,16	0,19	238,09	0,32	-0,32	0,45	315,58
14,00	796,00	-0,14	-0,13	0,20	223,30	0,42	-0,16	0,45	339,59
14,50	795,50	0,02	0,01	0,02	26,31	0,56	-0,02	0,56	357,70
15,00	795,00	0,18	0,14	0,23	37,62	0,54	-0,03	0,55	356,57
15,50	794,50	0,19	0,22	0,29	48,69	0,36	-0,17	0,40	334,47
16,00	794,00	0,12	0,11	0,16	44,36	0,17	-0,39	0,43	293,97
16,50	793,50	0,03	-0,02	0,03	330,00	0,06	-0,50	0,51	276,44
17,00	793,00	-0,04	-0,12	0,13	251,31	0,03	-0,49	0,49	273,49
17,50	792,50	0,02	-0,08	0,08	281,99	0,07	-0,37	0,37	280,91
18,00	792,00	0,19	-0,21	0,28	311,97	0,05	-0,28	0,29	280,60
18,50	791,50	0,04	0,00	0,05	3,69	-0,14	-0,07	0,15	208,24
19,00	791,00	-0,04	0,15	0,16	105,00	-0,18	-0,08	0,20	202,77
19,50	790,50	-0,02	0,09	0,09	105,00	-0,14	-0,23	0,27	238,67
20,00	790,00	-0,02	-0,14	0,14	263,20	-0,12	-0,31	0,34	249,64
20,50	789,50	0,02	-0,17	0,17	276,03	-0,10	-0,17	0,20	240,00
21,00	789,00	-0,03	0,11	0,11	107,29	-0,12	0,00	0,12	182,01
21,50	788,50	-0,05	0,19	0,20	103,73	-0,08	-0,11	0,14	232,23
22,00	788,00	-0,01	0,06	0,06	96,87	-0,04	-0,30	0,31	262,89
22,50	787,50	-0,06	-0,07	0,09	227,91	-0,03	-0,36	0,37	265,25
23,00	787,00	-0,12	-0,11	0,16	222,26	0,03	-0,30	0,30	275,68
23,50	786,50	-0,07	-0,08	0,10	229,38	0,15	-0,19	0,24	308,75
24,00	786,00	0,04	-0,05	0,06	306,04	0,22	-0,11	0,24	332,94
24,50	785,50	0,08	-0,03	0,08	338,75	0,18	-0,06	0,19	341,31
25,00	785,00	0,06	-0,06	0,08	317,01	0,10	-0,03	0,11	343,24
25,50	784,50	0,04	0,03	0,05	30,26	0,04	0,03	0,05	30,26

Misura inclinometrica del 19/10/2010 00:00

Data/Ora: 19/10/2010 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314.

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 16/06/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 19/10/2010 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	809,50	-0,29	0,10	0,31	160,62	-0,55	-16,43	16,44	268,09
1,00	809,00	-0,28	-0,03	0,28	186,87	-0,26	-16,54	16,54	269,10
1,50	808,50	-0,26	-0,60	0,65	246,58	0,02	-16,50	16,50	270,07
2,00	808,00	0,00	-2,02	2,02	270,05	0,28	-15,90	15,90	271,01
2,50	807,50	0,67	-4,50	4,55	278,48	0,28	-13,88	13,88	271,15
3,00	807,00	-0,24	-1,13	1,16	258,24	-0,39	-9,38	9,39	267,61
3,50	806,50	-0,45	-0,91	1,01	243,53	-0,16	-8,25	8,25	268,92
4,00	806,00	-0,15	-2,33	2,33	266,43	0,30	-7,34	7,34	272,31
4,50	805,50	0,26	-2,59	2,61	275,63	0,44	-5,01	5,03	275,03
5,00	805,00	-0,01	-1,53	1,53	269,80	0,19	-2,42	2,42	274,39
5,50	804,50	-0,24	-0,30	0,39	230,69	0,19	-0,88	0,90	282,19
6,00	804,00	-0,32	0,40	0,52	128,71	0,44	-0,58	0,73	306,74
6,50	803,50	-0,19	0,44	0,48	113,43	0,76	-0,99	1,24	307,56
7,00	803,00	-0,13	0,20	0,23	122,74	0,95	-1,43	1,72	303,62
7,50	802,50	-0,08	0,01	0,08	174,44	1,08	-1,62	1,95	303,52
8,00	802,00	-0,10	-0,03	0,11	195,00	1,15	-1,63	2,00	305,20
8,50	801,50	0,05	0,02	0,05	24,46	1,25	-1,60	2,04	308,00
9,00	801,00	0,75	-0,22	0,78	343,48	1,20	-1,63	2,02	306,52
9,50	800,50	0,18	0,09	0,20	26,31	0,46	-1,41	1,48	288,08
10,00	800,00	0,16	0,03	0,17	11,99	0,28	-1,50	1,52	280,50
10,50	799,50	0,07	-0,05	0,09	321,87	0,11	-1,53	1,53	274,21
11,00	799,00	-0,05	-0,15	0,15	251,77	0,04	-1,48	1,48	271,67
11,50	798,50	-0,02	-0,22	0,22	263,63	0,09	-1,33	1,33	273,91
12,00	798,00	0,00	-0,27	0,27	269,58	0,12	-1,11	1,12	275,91
12,50	797,50	-0,09	-0,28	0,29	252,26	0,12	-0,85	0,86	277,87
13,00	797,00	-0,12	-0,23	0,26	242,73	0,21	-0,57	0,60	290,04
13,50	796,50	-0,14	-0,21	0,25	235,71	0,33	-0,33	0,47	314,48
14,00	796,00	-0,13	-0,14	0,19	226,87	0,47	-0,13	0,49	344,93
14,50	795,50	0,12	-0,05	0,13	338,53	0,60	0,01	0,60	1,37
15,00	795,00	0,19	0,16	0,25	39,78	0,48	0,06	0,49	7,16
15,50	794,50	0,20	0,25	0,32	52,18	0,29	-0,10	0,31	340,62
16,00	794,00	0,12	0,15	0,20	50,84	0,09	-0,36	0,37	284,31
16,50	793,50	-0,02	0,00	0,02	183,69	-0,03	-0,51	0,51	266,25
17,00	793,00	-0,06	-0,14	0,15	244,76	-0,01	-0,51	0,51	268,78
17,50	792,50	0,01	-0,19	0,19	273,18	0,05	-0,37	0,37	278,21
18,00	792,00	0,21	-0,25	0,33	309,83	0,04	-0,18	0,18	283,60
18,50	791,50	-0,04	0,06	0,07	119,04	-0,17	0,07	0,18	155,91
19,00	791,00	-0,05	0,19	0,19	105,00	-0,13	0,01	0,13	175,35
19,50	790,50	-0,01	0,12	0,12	96,87	-0,08	-0,18	0,19	245,53
20,00	790,00	0,01	-0,12	0,12	276,25	-0,07	-0,30	0,31	257,70
20,50	789,50	0,00	-0,12	0,12	272,01	-0,08	-0,19	0,20	247,13
21,00	789,00	-0,04	0,11	0,12	111,34	-0,08	-0,07	0,11	219,44
21,50	788,50	-0,05	0,22	0,23	101,63	-0,04	-0,18	0,18	257,82
22,00	788,00	-0,01	0,08	0,08	98,66	0,01	-0,40	0,40	270,96
22,50	787,50	-0,07	-0,06	0,09	220,35	0,02	-0,48	0,48	272,24
23,00	787,00	-0,10	-0,12	0,16	230,91	0,09	-0,42	0,43	282,05
23,50	786,50	-0,08	-0,11	0,14	232,23	0,19	-0,30	0,35	302,53
24,00	786,00	0,01	-0,08	0,08	274,99	0,27	-0,19	0,33	325,68
24,50	785,50	0,07	-0,07	0,10	315,07	0,27	-0,11	0,29	337,43
25,00	785,00	0,15	-0,08	0,17	332,12	0,20	-0,04	0,20	347,88
25,50	784,50	0,05	0,04	0,06	36,04	0,05	0,04	0,06	36,04

Misura inclinometrica del 10/06/2011 00:00

Data/Ora: 10/06/2011 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314.

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 16/06/2009 00:00

Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Elaborazione dati - misura del 10/06/2011 00:00						
			Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	809,50	-0,28	0,12	0,30	155,95	-0,18	-19,10	19,10	269,46
1,00	809,00	-0,27	-0,01	0,27	182,57	0,10	-19,22	19,22	270,28
1,50	808,50	-0,26	-0,67	0,72	248,97	0,36	-19,21	19,21	271,08
2,00	808,00	0,05	-2,34	2,34	271,23	0,62	-18,54	18,55	271,92
2,50	807,50	0,74	-5,22	5,28	278,12	0,57	-16,20	16,21	272,02
3,00	807,00	-0,25	-1,40	1,42	260,03	-0,17	-10,98	10,98	269,09
3,50	806,50	-0,52	-1,16	1,27	245,65	0,07	-9,58	9,58	270,43
4,00	806,00	-0,20	-2,84	2,85	266,00	0,60	-8,42	8,44	274,04
4,50	805,50	0,26	-3,03	3,04	274,96	0,79	-5,58	5,63	278,10
5,00	805,00	0,05	-1,78	1,78	271,69	0,53	-2,54	2,60	281,78
5,50	804,50	-0,20	-0,35	0,41	240,00	0,48	-0,76	0,90	302,19
6,00	804,00	-0,30	0,46	0,55	123,15	0,68	-0,41	0,79	329,10
6,50	803,50	-0,19	0,50	0,53	110,71	0,98	-0,87	1,31	318,48
7,00	803,00	-0,10	0,22	0,24	113,43	1,17	-1,37	1,80	310,56
7,50	802,50	-0,04	0,06	0,08	125,56	1,27	-1,59	2,03	308,56
8,00	802,00	-0,05	0,06	0,08	131,57	1,31	-1,65	2,11	308,45
8,50	801,50	0,12	0,04	0,12	19,09	1,36	-1,71	2,19	308,56
9,00	801,00	0,29	0,10	0,31	18,27	1,25	-1,75	2,15	305,45
9,50	800,50	0,26	0,06	0,27	12,18	0,95	-1,85	2,08	297,26
10,00	800,00	0,20	-0,01	0,20	356,57	0,69	-1,91	2,03	289,88
10,50	799,50	0,08	-0,12	0,14	303,43	0,49	-1,89	1,96	284,61
11,00	799,00	-0,08	-0,23	0,24	250,44	0,42	-1,78	1,83	283,20
11,50	798,50	-0,02	-0,28	0,28	266,57	0,50	-1,55	1,63	287,80
12,00	798,00	0,05	-0,33	0,33	278,83	0,51	-1,27	1,37	292,03
12,50	797,50	-0,04	-0,32	0,32	262,62	0,46	-0,95	1,05	296,12
13,00	797,00	-0,07	-0,28	0,29	255,26	0,51	-0,62	0,80	309,03
13,50	796,50	-0,10	-0,24	0,26	246,79	0,58	-0,35	0,68	328,94
14,00	796,00	-0,15	-0,19	0,24	232,50	0,68	-0,11	0,69	351,22
14,50	795,50	0,04	-0,01	0,04	339,46	0,83	0,08	0,83	5,84
15,00	795,00	0,20	0,23	0,31	48,23	0,79	0,10	0,80	7,05
15,50	794,50	0,21	0,30	0,37	55,16	0,59	-0,13	0,60	347,50
16,00	794,00	0,14	0,16	0,21	48,02	0,38	-0,43	0,58	310,97
16,50	793,50	0,04	-0,05	0,06	306,04	0,24	-0,59	0,64	291,78
17,00	793,00	-0,11	-0,18	0,21	240,00	0,20	-0,54	0,58	290,27
17,50	792,50	0,00	-0,24	0,24	269,20	0,31	-0,36	0,47	310,60
18,00	792,00	0,21	-0,27	0,34	308,59	0,31	-0,11	0,33	339,82
18,50	791,50	0,09	0,03	0,10	20,19	0,10	0,15	0,18	58,03
19,00	791,00	0,00	0,20	0,20	89,74	0,00	0,12	0,12	87,90
19,50	790,50	-0,01	0,12	0,12	96,87	0,00	-0,08	0,08	272,47
20,00	790,00	0,01	-0,09	0,09	279,29	0,02	-0,21	0,21	275,13
20,50	789,50	0,00	-0,10	0,10	269,74	0,00	-0,12	0,12	272,01
21,00	789,00	-0,02	0,14	0,15	99,81	0,00	-0,02	0,02	285,00
21,50	788,50	-0,04	0,28	0,28	98,66	0,03	-0,16	0,16	280,36
22,00	788,00	-0,01	0,09	0,09	93,69	0,07	-0,44	0,44	279,29
22,50	787,50	-0,07	-0,12	0,14	237,40	0,08	-0,53	0,53	278,35
23,00	787,00	-0,06	-0,16	0,17	248,43	0,15	-0,41	0,44	290,19
23,50	786,50	-0,09	-0,14	0,16	237,80	0,21	-0,25	0,33	310,20
24,00	786,00	0,02	-0,08	0,08	281,99	0,30	-0,12	0,32	338,91
24,50	785,50	0,09	-0,06	0,11	323,29	0,28	-0,03	0,29	353,20
25,00	785,00	0,09	-0,03	0,10	341,31	0,20	0,03	0,20	8,66
25,50	784,50	0,11	0,06	0,12	29,53	0,11	0,06	0,12	29,53

Misura inclinometrica del 21/12/2011 00:00

Data/Ora: 21/12/2011 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314.

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 16/06/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 21/12/2011 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	809,50	-0,31	0,07	0,31	167,35	-1,54	-19,28	19,34	265,43
1,00	809,00	-0,29	-0,01	0,29	182,01	-1,23	-19,35	19,39	266,35
1,50	808,50	-0,29	-0,67	0,73	246,88	-0,94	-19,34	19,36	267,22
2,00	808,00	0,05	-2,39	2,39	271,12	-0,65	-18,67	18,68	268,00
2,50	807,50	0,73	-5,27	5,32	277,89	-0,70	-16,27	16,29	267,54
3,00	807,00	-0,29	-1,45	1,48	258,74	-1,43	-11,00	11,10	262,59
3,50	806,50	-0,56	-1,22	1,34	245,34	-1,14	-9,55	9,62	263,18
4,00	806,00	-0,19	-2,86	2,87	266,12	-0,58	-8,33	8,35	266,01
4,50	805,50	0,24	-3,05	3,06	274,50	-0,39	-5,47	5,48	265,95
5,00	805,00	0,04	-1,81	1,81	271,27	-0,63	-2,42	2,50	255,49
5,50	804,50	-0,26	-0,38	0,46	235,30	-0,67	-0,62	0,91	222,81
6,00	804,00	-0,31	0,51	0,59	121,00	-0,41	-0,24	0,47	210,72
6,50	803,50	-0,23	0,52	0,57	113,88	-0,10	-0,75	0,76	262,33
7,00	803,00	-0,15	0,27	0,31	119,83	0,13	-1,27	1,28	275,86
7,50	802,50	-0,09	0,15	0,18	122,53	0,29	-1,54	1,57	280,48
8,00	802,00	-0,12	0,12	0,17	132,90	0,38	-1,69	1,73	282,66
8,50	801,50	0,13	0,08	0,15	32,35	0,50	-1,82	1,88	285,27
9,00	801,00	0,29	0,13	0,31	24,73	0,37	-1,90	1,93	281,06
9,50	800,50	0,24	0,07	0,25	16,01	0,09	-2,03	2,03	272,42
10,00	800,00	0,18	-0,01	0,18	358,30	-0,16	-2,10	2,10	265,73
10,50	799,50	0,04	-0,14	0,14	285,00	-0,34	-2,09	2,12	260,73
11,00	799,00	-0,13	-0,24	0,28	241,30	-0,38	-1,95	1,99	259,06
11,50	798,50	-0,05	-0,31	0,31	261,37	-0,25	-1,71	1,73	261,84
12,00	798,00	0,07	-0,31	0,32	283,41	-0,20	-1,41	1,42	261,94
12,50	797,50	-0,04	-0,35	0,35	262,93	-0,27	-1,10	1,13	256,03
13,00	797,00	-0,15	-0,29	0,33	242,20	-0,23	-0,75	0,78	252,93
13,50	796,50	-0,20	-0,26	0,33	232,33	-0,08	-0,46	0,47	260,38
14,00	796,00	-0,21	-0,21	0,30	224,22	0,12	-0,20	0,23	301,39
14,50	795,50	0,05	-0,01	0,05	350,56	0,34	0,01	0,34	1,33
15,00	795,00	0,26	0,24	0,35	43,50	0,28	0,02	0,28	3,34
15,50	794,50	0,24	0,33	0,41	53,85	0,03	-0,23	0,23	277,18
16,00	794,00	0,13	0,16	0,21	51,38	-0,21	-0,56	0,59	249,07
16,50	793,50	-0,02	-0,05	0,05	247,13	-0,34	-0,72	0,80	244,50
17,00	793,00	-0,16	-0,20	0,25	231,47	-0,32	-0,67	0,75	244,33
17,50	792,50	-0,07	-0,28	0,29	256,46	-0,17	-0,47	0,50	250,75
18,00	792,00	0,16	-0,28	0,32	299,98	-0,10	-0,20	0,22	243,27
18,50	791,50	0,09	0,03	0,10	20,19	-0,26	0,09	0,27	161,82
19,00	791,00	0,00	0,22	0,22	90,96	-0,35	0,05	0,36	171,61
19,50	790,50	-0,03	0,13	0,13	101,19	-0,35	-0,17	0,39	205,54
20,00	790,00	-0,03	-0,11	0,11	256,39	-0,32	-0,30	0,44	222,60
20,50	789,50	-0,01	-0,11	0,11	266,57	-0,30	-0,19	0,35	212,53
21,00	789,00	-0,05	0,17	0,18	106,40	-0,29	-0,08	0,30	195,00
21,50	788,50	-0,09	0,32	0,33	105,76	-0,24	-0,25	0,35	226,46
22,00	788,00	-0,04	0,10	0,11	114,46	-0,15	-0,57	0,59	255,36
22,50	787,50	-0,17	-0,15	0,22	222,07	-0,10	-0,67	0,68	261,11
23,00	787,00	0,04	-0,28	0,28	278,66	0,06	-0,52	0,52	276,73
23,50	786,50	-0,14	-0,15	0,20	227,66	0,02	-0,24	0,24	274,51
24,00	786,00	-0,03	-0,09	0,09	252,09	0,16	-0,09	0,18	330,00
24,50	785,50	0,04	-0,04	0,06	317,47	0,18	-0,01	0,18	358,30
25,00	785,00	0,06	-0,03	0,07	335,19	0,14	0,03	0,15	13,26
25,50	784,50	0,08	0,06	0,10	38,20	0,08	0,06	0,10	38,20

Misura inclinometrica del 21/09/2012 00:00

Data/Ora: 21/09/2012 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314.

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 16/06/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 21/09/2012 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	809,50	-0,28	0,20	0,34	144,71	-1,49	-20,55	20,60	265,84
1,00	809,00	-0,32	-0,03	0,32	184,62	-1,22	-20,75	20,78	266,64
1,50	808,50	-0,33	-0,75	0,82	246,15	-0,90	-20,72	20,74	267,51
2,00	808,00	-0,02	-2,51	2,51	269,50	-0,57	-19,97	19,98	268,37
2,50	807,50	0,67	-5,53	5,57	276,92	-0,55	-17,46	17,47	268,21
3,00	807,00	-0,32	-1,59	1,62	258,43	-1,22	-11,93	12,00	264,17
3,50	806,50	-0,62	-1,29	1,43	244,51	-0,89	-10,35	10,38	265,07
4,00	806,00	-0,27	-2,97	2,99	264,74	-0,28	-9,06	9,06	268,24
4,50	805,50	0,17	-3,19	3,20	273,04	0,00	-6,08	6,08	269,96
5,00	805,00	-0,01	-1,91	1,91	269,84	-0,17	-2,89	2,89	266,57
5,50	804,50	-0,24	-0,43	0,49	241,45	-0,17	-0,98	0,99	260,26
6,00	804,00	-0,34	0,48	0,59	124,80	0,07	-0,54	0,55	277,13
6,50	803,50	-0,23	0,53	0,58	112,88	0,40	-1,03	1,10	291,44
7,00	803,00	-0,15	0,27	0,31	119,83	0,63	-1,56	1,68	291,94
7,50	802,50	-0,15	0,15	0,21	134,74	0,78	-1,83	1,99	293,17
8,00	802,00	-0,17	0,16	0,23	137,47	0,93	-1,98	2,19	295,22
8,50	801,50	0,09	0,09	0,12	45,26	1,10	-2,14	2,41	297,30
9,00	801,00	0,31	0,13	0,34	22,50	1,02	-2,23	2,45	294,56
9,50	800,50	0,27	0,08	0,28	17,73	0,70	-2,36	2,46	286,65
10,00	800,00	0,19	-0,04	0,20	348,43	0,44	-2,44	2,48	280,19
10,50	799,50	0,07	-0,16	0,17	293,97	0,25	-2,40	2,41	275,83
11,00	799,00	-0,14	-0,28	0,31	243,43	0,18	-2,25	2,25	274,48
11,50	798,50	-0,04	-0,35	0,35	262,93	0,32	-1,97	1,99	279,14
12,00	798,00	0,10	-0,34	0,35	286,43	0,36	-1,61	1,65	282,55
12,50	797,50	-0,04	-0,35	0,35	262,93	0,26	-1,28	1,30	281,50
13,00	797,00	-0,15	-0,32	0,35	244,09	0,30	-0,93	0,97	288,12
13,50	796,50	-0,19	-0,31	0,36	239,01	0,46	-0,61	0,76	306,80
14,00	796,00	-0,20	-0,21	0,30	226,55	0,64	-0,30	0,71	335,06
14,50	795,50	0,08	0,01	0,08	4,99	0,85	-0,08	0,85	354,30
15,00	795,00	0,29	0,28	0,40	43,81	0,77	-0,09	0,78	353,26
15,50	794,50	0,26	0,36	0,45	54,37	0,48	-0,37	0,61	322,29
16,00	794,00	0,15	0,18	0,24	49,29	0,22	-0,73	0,76	286,66
16,50	793,50	0,00	-0,06	0,06	272,01	0,07	-0,91	0,91	274,12
17,00	793,00	-0,15	-0,21	0,26	234,56	0,06	-0,85	0,85	274,27
17,50	792,50	-0,08	-0,32	0,33	256,70	0,22	-0,64	0,67	288,76
18,00	792,00	0,17	-0,29	0,34	301,05	0,29	-0,32	0,43	312,35
18,50	791,50	0,15	0,06	0,16	21,34	0,12	-0,03	0,12	344,74
19,00	791,00	0,05	0,20	0,21	77,35	-0,03	-0,09	0,10	251,31
19,50	790,50	0,00	0,12	0,12	92,01	-0,08	-0,30	0,30	255,46
20,00	790,00	0,12	-0,18	0,22	304,18	-0,07	-0,41	0,42	260,06
20,50	789,50	0,00	-0,10	0,10	269,74	-0,19	-0,23	0,30	230,54
21,00	789,00	-0,04	0,15	0,15	103,36	-0,19	-0,13	0,23	214,80
21,50	788,50	-0,05	0,31	0,32	99,37	-0,16	-0,28	0,33	241,10
22,00	788,00	-0,04	0,08	0,09	116,31	-0,11	-0,60	0,60	259,93
22,50	787,50	-0,16	-0,12	0,20	216,57	-0,07	-0,68	0,68	264,44
23,00	787,00	-0,06	-0,25	0,26	257,10	0,10	-0,55	0,56	280,05
23,50	786,50	-0,11	-0,17	0,20	238,21	0,16	-0,31	0,34	296,89
24,00	786,00	-0,02	-0,09	0,09	259,65	0,26	-0,14	0,29	332,44
24,50	785,50	0,06	-0,05	0,08	321,25	0,28	-0,04	0,28	350,85
25,00	785,00	0,08	-0,04	0,09	333,81	0,21	0,01	0,21	1,83
25,50	784,50	0,13	0,05	0,14	20,53	0,13	0,05	0,14	20,53

Misura inclinometrica del 12/11/2013 00:00

Data/Ora: 12/11/2013 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314.

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 16/06/2009 00:00

Letture									
Elaborazione dati - misura del 12/11/2013 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	809,50	-0,14	-0,02	0,15	189,81	-0,01	-25,75	25,75	269,98
1,00	809,00	-0,30	-0,07	0,31	192,51	0,14	-25,73	25,73	270,30
1,50	808,50	-0,29	-0,95	0,99	253,16	0,43	-25,66	25,66	270,97
2,00	808,00	0,17	-3,26	3,26	272,96	0,72	-24,72	24,73	271,67
2,50	807,50	1,10	-6,99	7,07	278,94	0,55	-21,46	21,46	271,47
3,00	807,00	-0,34	-1,94	1,97	260,05	-0,55	-14,47	14,48	267,84
3,50	806,50	-0,70	-1,57	1,72	245,83	-0,21	-12,53	12,53	269,06
4,00	806,00	-0,20	-3,74	3,75	266,99	0,50	-10,96	10,97	272,60
4,50	805,50	0,36	-3,89	3,91	275,24	0,70	-7,22	7,25	275,50
5,00	805,00	0,12	-2,22	2,23	272,98	0,34	-3,33	3,34	275,80
5,50	804,50	-0,24	-0,49	0,55	243,95	0,22	-1,10	1,12	281,40
6,00	804,00	-0,39	0,56	0,68	125,08	0,46	-0,61	0,77	306,99
6,50	803,50	-0,27	0,60	0,66	114,21	0,85	-1,17	1,45	306,09
7,00	803,00	-0,14	0,25	0,28	119,47	1,13	-1,78	2,10	302,37
7,50	802,50	-0,12	0,12	0,17	135,47	1,26	-2,02	2,38	302,02
8,00	802,00	-0,15	0,12	0,19	142,41	1,39	-2,14	2,55	302,93
8,50	801,50	0,23	-0,01	0,23	357,26	1,54	-2,26	2,73	304,26
9,00	801,00	0,43	0,06	0,44	8,02	1,31	-2,25	2,60	300,17
9,50	800,50	0,37	0,01	0,37	1,80	0,88	-2,31	2,47	290,75
10,00	800,00	0,26	-0,08	0,27	343,39	0,51	-2,32	2,38	282,33
10,50	799,50	0,06	-0,22	0,23	285,00	0,25	-2,24	2,26	276,33
11,00	799,00	-0,16	-0,37	0,40	246,24	0,19	-2,02	2,03	275,35
11,50	798,50	-0,01	-0,41	0,41	268,89	0,35	-1,65	1,69	282,00
12,00	798,00	0,14	-0,39	0,42	289,86	0,36	-1,24	1,29	286,18
12,50	797,50	-0,01	-0,42	0,42	268,07	0,22	-0,85	0,88	284,42
13,00	797,00	-0,16	-0,37	0,40	247,13	0,23	-0,42	0,48	298,78
13,50	796,50	-0,19	-0,29	0,35	236,93	0,39	-0,05	0,39	352,48
14,00	796,00	-0,22	-0,22	0,31	224,85	0,58	0,24	0,63	22,67
14,50	795,50	0,06	0,03	0,07	26,31	0,80	0,46	0,92	29,97
15,00	795,00	0,33	0,25	0,42	37,25	0,74	0,43	0,86	30,26
15,50	794,50	0,33	0,43	0,54	52,63	0,41	0,18	0,44	23,62
16,00	794,00	0,17	0,20	0,26	50,31	0,08	-0,25	0,26	287,91
16,50	793,50	-0,02	-0,05	0,05	247,13	-0,09	-0,45	0,46	259,18
17,00	793,00	-0,16	-0,20	0,25	231,47	-0,07	-0,40	0,41	260,66
17,50	792,50	-0,07	-0,29	0,30	255,78	0,09	-0,20	0,22	294,09
18,00	792,00	0,20	-0,26	0,33	307,80	0,16	0,09	0,19	27,38
18,50	791,50	0,15	0,06	0,16	21,34	-0,04	0,35	0,35	96,25
19,00	791,00	0,06	0,18	0,19	71,31	-0,19	0,29	0,34	122,97
19,50	790,50	0,00	0,12	0,12	92,01	-0,25	0,11	0,27	156,63
20,00	790,00	-0,02	-0,08	0,08	252,99	-0,24	-0,01	0,24	182,47
20,50	789,50	0,00	-0,07	0,07	270,96	-0,22	0,07	0,23	162,53
21,00	789,00	-0,02	0,25	0,25	95,71	-0,22	0,14	0,26	147,27
21,50	788,50	-0,06	0,37	0,38	98,96	-0,20	-0,10	0,22	207,65
22,00	788,00	-0,03	0,10	0,11	105,00	-0,14	-0,48	0,50	253,86
22,50	787,50	-0,10	-0,20	0,23	244,76	-0,11	-0,58	0,59	259,20
23,00	787,00	-0,11	-0,23	0,26	245,57	-0,01	-0,37	0,37	267,85
23,50	786,50	-0,15	-0,15	0,21	224,29	0,09	-0,14	0,17	303,43
24,00	786,00	-0,01	-0,04	0,04	249,46	0,24	0,01	0,24	1,22
24,50	785,50	0,04	-0,01	0,05	345,95	0,25	0,04	0,26	9,09
25,00	785,00	0,08	-0,01	0,08	354,44	0,21	0,05	0,22	13,83
25,50	784,50	0,14	0,06	0,15	23,62	0,14	0,06	0,15	23,62

Misura inclinometrica del 20/11/2014 00:00

Data/Ora: 20/11/2014 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314.

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 16/06/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 20/11/2014 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	809,50	-0,61	0,19	0,64	162,95	-1,61	-38,40	38,43	267,60
1,00	809,00	-0,57	-0,14	0,59	193,71	-0,99	-38,58	38,60	268,52
1,50	808,50	-0,56	-1,62	1,72	250,90	-0,42	-38,45	38,45	269,37
2,00	808,00	0,17	-5,73	5,73	271,71	0,14	-36,82	36,82	270,22
2,50	807,50	1,33	-10,51	10,59	277,21	-0,03	-31,09	31,09	269,94
3,00	807,00	-0,59	-2,87	2,93	258,43	-1,36	-20,58	20,63	266,22
3,50	806,50	-1,01	-2,07	2,31	244,04	-0,78	-17,72	17,73	267,50
4,00	806,00	-0,39	-5,20	5,22	265,71	0,23	-15,64	15,65	270,86
4,50	805,50	0,37	-5,47	5,49	273,85	0,62	-10,44	10,46	273,42
5,00	805,00	0,16	-3,13	3,13	272,87	0,26	-4,97	4,98	272,95
5,50	804,50	-0,21	-0,62	0,66	250,99	0,10	-1,84	1,84	273,10
6,00	804,00	-0,49	0,86	0,99	119,72	0,31	-1,22	1,26	284,40
6,50	803,50	-0,45	0,78	0,90	119,86	0,80	-2,08	2,23	291,14
7,00	803,00	-0,29	0,39	0,48	126,41	1,25	-2,86	3,12	293,64
7,50	802,50	-0,11	0,26	0,28	112,35	1,54	-3,25	3,59	295,34
8,00	802,00	0,25	0,49	0,55	62,60	1,64	-3,50	3,87	295,13
8,50	801,50	0,38	0,10	0,40	15,00	1,39	-3,99	4,23	289,20
9,00	801,00	0,08	-0,52	0,52	279,19	1,01	-4,10	4,22	283,80
9,50	800,50	0,30	-0,33	0,44	312,84	0,92	-3,58	3,69	284,45
10,00	800,00	0,34	-0,28	0,44	320,27	0,62	-3,25	3,31	280,79
10,50	799,50	0,20	-0,33	0,39	300,95	0,28	-2,97	2,98	275,36
11,00	799,00	-0,08	-0,42	0,43	259,77	0,08	-2,64	2,64	271,73
11,50	798,50	-0,01	-0,44	0,44	268,74	0,16	-2,22	2,22	274,00
12,00	798,00	0,09	-0,48	0,49	280,84	0,16	-1,78	1,78	275,30
12,50	797,50	-0,08	-0,43	0,44	259,98	0,07	-1,30	1,30	273,23
13,00	797,00	-0,15	-0,33	0,36	245,91	0,15	-0,87	0,88	279,81
13,50	796,50	-0,18	-0,24	0,30	234,05	0,30	-0,53	0,61	299,24
14,00	796,00	-0,20	-0,18	0,26	222,00	0,48	-0,29	0,56	328,71
14,50	795,50	0,10	-0,02	0,10	347,35	0,67	-0,11	0,68	350,43
15,00	795,00	0,36	0,12	0,38	18,99	0,57	-0,09	0,58	350,99
15,50	794,50	0,20	0,28	0,35	54,81	0,21	-0,21	0,30	314,22
16,00	794,00	0,16	0,14	0,22	41,57	0,01	-0,50	0,50	271,09
16,50	793,50	-0,08	0,02	0,09	167,10	-0,15	-0,64	0,66	256,54
17,00	793,00	-0,14	-0,18	0,23	230,54	-0,07	-0,66	0,66	263,91
17,50	792,50	-0,03	-0,31	0,32	264,54	0,07	-0,48	0,49	278,77
18,00	792,00	0,18	-0,30	0,35	300,26	0,10	-0,17	0,20	301,82
18,50	791,50	0,09	-0,01	0,10	353,20	-0,07	0,14	0,15	118,24
19,00	791,00	0,02	0,16	0,16	82,62	-0,17	0,15	0,22	138,69
19,50	790,50	0,02	0,12	0,12	78,43	-0,19	-0,01	0,19	184,22
20,00	790,00	0,02	-0,08	0,08	285,00	-0,21	-0,13	0,25	211,50
20,50	789,50	0,02	-0,07	0,07	285,00	-0,23	-0,05	0,24	192,88
21,00	789,00	-0,05	0,26	0,26	100,16	-0,25	0,02	0,25	176,57
21,50	788,50	-0,04	0,38	0,38	96,30	-0,20	-0,24	0,32	229,80
22,00	788,00	-0,04	0,10	0,11	114,46	-0,16	-0,62	0,64	255,26
22,50	787,50	-0,11	-0,21	0,24	241,51	-0,12	-0,72	0,73	260,61
23,00	787,00	-0,14	-0,30	0,33	244,32	-0,01	-0,51	0,51	269,40
23,50	786,50	-0,11	-0,15	0,19	234,29	0,14	-0,21	0,25	303,43
24,00	786,00	-0,01	-0,05	0,05	260,56	0,25	-0,06	0,26	347,10
24,50	785,50	0,06	-0,03	0,07	330,00	0,26	0,00	0,26	359,05
25,00	785,00	0,06	-0,03	0,07	335,19	0,20	0,03	0,20	8,66
25,50	784,50	0,14	0,06	0,15	23,62	0,14	0,06	0,15	23,62

Misura inclinometrica del 24/11/2015 00:00

Data/Ora: 24/11/2015 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314.

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 16/06/2009 00:00

Letture									
Elaborazione dati - misura del 24/11/2015 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	809,50	-0,77	0,21	0,80	164,90	-3,92	-39,05	39,25	264,27
1,00	809,00	-0,71	-0,16	0,73	192,57	-3,15	-39,26	39,39	265,42
1,50	808,50	-0,67	-1,74	1,86	248,89	-2,43	-39,10	39,18	266,44
2,00	808,00	0,09	-5,92	5,93	270,84	-1,76	-37,37	37,41	267,30
2,50	807,50	1,20	-10,59	10,66	276,44	-1,85	-31,44	31,50	266,63
3,00	807,00	-0,70	-2,96	3,04	256,72	-3,05	-20,85	21,07	261,69
3,50	806,50	-1,11	-2,19	2,45	243,21	-2,35	-17,89	18,05	262,52
4,00	806,00	-0,54	-5,29	5,32	264,15	-1,24	-15,70	15,75	265,48
4,50	805,50	0,25	-5,52	5,53	272,63	-0,70	-10,41	10,44	266,15
5,00	805,00	0,08	-3,23	3,23	271,48	-0,95	-4,89	4,98	258,96
5,50	804,50	-0,25	-0,70	0,74	250,65	-1,04	-1,66	1,96	237,99
6,00	804,00	-0,54	0,83	0,99	122,95	-0,79	-0,96	1,24	230,44
6,50	803,50	-0,56	0,83	1,00	124,08	-0,25	-1,79	1,81	261,95
7,00	803,00	-0,37	0,47	0,60	128,53	0,31	-2,62	2,64	276,71
7,50	802,50	-0,20	0,32	0,38	121,31	0,68	-3,08	3,16	282,43
8,00	802,00	0,16	0,55	0,57	74,04	0,88	-3,41	3,52	284,42
8,50	801,50	0,35	0,15	0,38	22,94	0,72	-3,95	4,02	280,33
9,00	801,00	0,07	-0,54	0,54	277,53	0,37	-4,10	4,12	275,11
9,50	800,50	0,31	-0,33	0,46	313,30	0,30	-3,56	3,57	274,75
10,00	800,00	0,33	-0,28	0,43	319,99	-0,02	-3,23	3,23	269,69
10,50	799,50	0,11	-0,34	0,35	287,86	-0,35	-2,95	2,97	263,28
11,00	799,00	-0,19	-0,44	0,48	246,75	-0,46	-2,62	2,66	260,10
11,50	798,50	-0,04	-0,45	0,45	264,44	-0,27	-2,18	2,19	262,98
12,00	798,00	0,11	-0,46	0,48	283,94	-0,22	-1,73	1,74	262,60
12,50	797,50	-0,07	-0,48	0,48	261,25	-0,34	-1,26	1,31	254,97
13,00	797,00	-0,20	-0,40	0,45	243,18	-0,27	-0,78	0,83	251,31
13,50	796,50	-0,22	-0,24	0,32	227,59	-0,06	-0,38	0,39	260,77
14,00	796,00	-0,20	-0,14	0,25	214,72	0,15	-0,15	0,21	316,37
14,50	795,50	0,10	0,02	0,10	12,51	0,36	0,00	0,36	359,25
15,00	795,00	0,36	0,18	0,41	26,31	0,26	-0,03	0,26	354,10
15,50	794,50	0,30	0,28	0,41	43,22	-0,10	-0,21	0,23	243,09
16,00	794,00	0,12	0,20	0,23	58,45	-0,40	-0,49	0,63	230,35
16,50	793,50	-0,07	0,01	0,07	169,98	-0,53	-0,69	0,86	232,51
17,00	793,00	-0,21	-0,18	0,28	221,57	-0,45	-0,70	0,83	236,99
17,50	792,50	-0,08	-0,33	0,34	256,09	-0,25	-0,51	0,57	244,40
18,00	792,00	0,18	-0,30	0,35	300,26	-0,17	-0,19	0,25	228,41
18,50	791,50	0,10	0,03	0,11	15,00	-0,34	0,12	0,36	160,92
19,00	791,00	0,03	0,17	0,17	81,04	-0,45	0,09	0,45	168,43
19,50	790,50	0,00	0,10	0,10	89,74	-0,47	-0,08	0,48	189,71
20,00	790,00	0,00	-0,09	0,09	268,30	-0,47	-0,18	0,51	201,01
20,50	789,50	-0,01	-0,08	0,08	266,57	-0,47	-0,09	0,48	190,76
21,00	789,00	-0,06	0,25	0,26	104,03	-0,47	-0,01	0,47	180,70
21,50	788,50	-0,06	0,40	0,41	98,11	-0,40	-0,26	0,48	212,76
22,00	788,00	-0,05	0,09	0,10	120,26	-0,34	-0,66	0,74	242,41
22,50	787,50	-0,13	-0,23	0,26	241,36	-0,29	-0,75	0,80	248,51
23,00	787,00	-0,18	-0,31	0,36	240,00	-0,17	-0,52	0,54	251,96
23,50	786,50	-0,15	-0,17	0,23	229,00	0,01	-0,21	0,21	272,74
24,00	786,00	-0,03	-0,07	0,08	244,76	0,16	-0,03	0,16	347,74
24,50	785,50	0,03	-0,02	0,03	330,00	0,19	0,03	0,20	9,81
25,00	785,00	0,05	-0,02	0,06	336,34	0,17	0,05	0,17	16,47
25,50	784,50	0,11	0,07	0,13	32,24	0,11	0,07	0,13	32,24

Misura inclinometrica del 06/09/2016 00:00

Data/Ora: 06/09/2016 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314.

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 16/06/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 06/09/2016 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	809,50	-0,73	0,14	0,74	169,20	-3,30	-40,03	40,17	265,29
1,00	809,00	-0,92	-0,04	0,92	182,50	-2,57	-40,17	40,25	266,33
1,50	808,50	-0,68	-1,77	1,90	249,09	-1,66	-40,13	40,16	267,64
2,00	808,00	0,07	-6,05	6,05	270,70	-0,98	-38,36	38,37	268,54
2,50	807,50	1,20	-10,87	10,93	276,28	-1,05	-32,31	32,33	268,14
3,00	807,00	-0,72	-3,08	3,16	256,79	-2,25	-21,44	21,56	264,02
3,50	806,50	-1,14	-2,26	2,53	243,12	-1,53	-18,37	18,43	265,25
4,00	806,00	-0,58	-5,45	5,48	263,94	-0,38	-16,11	16,12	268,64
4,50	805,50	0,24	-5,69	5,70	272,45	0,20	-10,66	10,66	271,06
5,00	805,00	0,10	-3,31	3,31	271,65	-0,05	-4,97	4,97	269,47
5,50	804,50	-0,25	-0,70	0,74	250,65	-0,14	-1,66	1,66	265,12
6,00	804,00	-0,53	0,85	1,00	121,68	0,11	-0,96	0,96	276,27
6,50	803,50	-0,52	0,88	1,02	120,60	0,63	-1,81	1,91	289,24
7,00	803,00	-0,37	0,50	0,62	126,80	1,15	-2,68	2,92	293,18
7,50	802,50	-0,22	0,35	0,42	122,28	1,52	-3,18	3,52	295,55
8,00	802,00	0,15	0,56	0,58	74,93	1,74	-3,53	3,94	296,26
8,50	801,50	0,36	0,14	0,39	21,48	1,59	-4,09	4,39	291,24
9,00	801,00	0,11	-0,56	0,58	281,48	1,23	-4,24	4,41	286,15
9,50	800,50	0,37	-0,36	0,52	315,29	1,11	-3,67	3,84	286,85
10,00	800,00	0,36	-0,31	0,47	319,29	0,74	-3,31	3,39	282,69
10,50	799,50	0,11	-0,36	0,38	286,33	0,39	-3,00	3,03	277,37
11,00	799,00	-0,23	-0,49	0,54	244,65	0,28	-2,64	2,65	276,09
11,50	798,50	-0,05	-0,49	0,49	263,96	0,51	-2,15	2,21	283,40
12,00	798,00	0,19	-0,48	0,52	291,88	0,56	-1,66	1,75	288,76
12,50	797,50	-0,05	-0,52	0,52	264,10	0,37	-1,18	1,24	287,45
13,00	797,00	-0,20	-0,46	0,50	247,13	0,42	-0,66	0,79	302,62
13,50	796,50	-0,23	-0,26	0,34	228,49	0,62	-0,20	0,65	342,17
14,00	796,00	-0,19	-0,15	0,24	217,38	0,85	0,06	0,85	3,92
14,50	795,50	0,12	0,01	0,12	4,51	1,04	0,21	1,06	11,19
15,00	795,00	0,40	0,20	0,45	26,31	0,92	0,20	0,94	12,04
15,50	794,50	0,32	0,31	0,45	44,60	0,52	0,00	0,52	359,66
16,00	794,00	0,16	0,19	0,25	49,82	0,20	-0,32	0,37	302,15
16,50	793,50	-0,04	0,02	0,04	150,00	0,04	-0,51	0,51	274,47
17,00	793,00	-0,19	-0,16	0,25	219,78	0,08	-0,53	0,53	278,35
17,50	792,50	-0,07	-0,33	0,34	258,10	0,27	-0,37	0,46	306,60
18,00	792,00	0,21	-0,32	0,39	303,02	0,34	-0,03	0,34	354,70
18,50	791,50	0,14	0,06	0,15	25,01	0,13	0,29	0,32	65,60
19,00	791,00	0,06	0,21	0,22	73,24	-0,01	0,23	0,23	91,50
19,50	790,50	0,01	0,12	0,12	83,96	-0,07	0,02	0,07	165,26
20,00	790,00	0,03	-0,07	0,07	292,13	-0,08	-0,10	0,13	231,87
20,50	789,50	0,02	-0,09	0,09	285,00	-0,11	-0,04	0,12	199,40
21,00	789,00	-0,03	0,26	0,26	96,33	-0,13	0,05	0,14	160,30
21,50	788,50	-0,03	0,44	0,45	94,14	-0,10	-0,22	0,24	244,51
22,00	788,00	-0,01	0,11	0,11	95,54	-0,07	-0,66	0,66	263,91
22,50	787,50	-0,09	-0,25	0,27	249,46	-0,06	-0,77	0,77	265,52
23,00	787,00	-0,15	-0,31	0,34	244,16	0,03	-0,52	0,52	273,69
23,50	786,50	-0,14	-0,18	0,23	232,09	0,18	-0,21	0,28	311,57
24,00	786,00	0,00	-0,07	0,07	266,57	0,32	-0,03	0,32	355,08
24,50	785,50	0,06	-0,01	0,06	353,96	0,33	0,04	0,33	7,30
25,00	785,00	0,10	-0,01	0,10	355,02	0,27	0,05	0,27	10,31
25,50	784,50	0,16	0,06	0,17	19,40	0,16	0,06	0,17	19,40

Misura inclinometrica del 19/09/2017 00:00

Data/Ora: 19/09/2017 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314.

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 16/06/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 19/09/2017 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	809,50	-0,82	0,09	0,82	173,83	-3,81	-40,91	41,08	264,68
1,00	809,00	-0,75	-0,15	0,77	191,36	-2,99	-41,00	41,11	265,82
1,50	808,50	-0,71	-1,78	1,92	248,24	-2,24	-40,85	40,91	266,86
2,00	808,00	0,09	-6,12	6,12	270,86	-1,53	-39,06	39,09	267,76
2,50	807,50	1,22	-10,95	11,02	276,35	-1,62	-32,95	32,99	267,18
3,00	807,00	-0,74	-3,14	3,22	256,68	-2,84	-22,00	22,18	262,64
3,50	806,50	-1,19	-2,33	2,62	243,01	-2,10	-18,86	18,98	263,65
4,00	806,00	-0,58	-5,55	5,58	264,04	-0,91	-16,53	16,55	266,85
4,50	805,50	0,26	-5,77	5,78	272,54	-0,33	-10,97	10,98	268,27
5,00	805,00	0,09	-3,34	3,34	271,61	-0,59	-5,20	5,24	263,57
5,50	804,50	-0,26	-0,70	0,74	249,70	-0,68	-1,87	1,99	249,97
6,00	804,00	-0,55	0,85	1,02	122,96	-0,42	-1,17	1,24	250,12
6,50	803,50	-0,55	0,88	1,03	121,89	0,13	-2,02	2,03	273,69
7,00	803,00	-0,41	0,52	0,67	128,50	0,68	-2,90	2,98	283,13
7,50	802,50	-0,26	0,36	0,44	125,96	1,09	-3,42	3,59	287,68
8,00	802,00	0,10	0,57	0,57	80,41	1,35	-3,78	4,02	289,67
8,50	801,50	0,36	0,14	0,39	21,48	1,26	-4,35	4,53	286,12
9,00	801,00	0,14	-0,57	0,58	284,13	0,89	-4,49	4,58	281,24
9,50	800,50	0,40	-0,37	0,54	317,25	0,75	-3,93	4,00	280,82
10,00	800,00	0,40	-0,31	0,51	321,47	0,35	-3,56	3,58	275,69
10,50	799,50	0,09	-0,39	0,40	283,73	-0,04	-3,25	3,25	269,28
11,00	799,00	-0,26	-0,54	0,60	244,17	-0,14	-2,86	2,86	267,29
11,50	798,50	-0,03	-0,52	0,52	267,18	0,13	-2,32	2,32	273,13
12,00	798,00	0,19	-0,48	0,52	291,88	0,15	-1,80	1,80	274,85
12,50	797,50	-0,08	-0,53	0,54	261,80	-0,04	-1,32	1,32	268,26
13,00	797,00	-0,27	-0,44	0,51	238,60	0,04	-0,79	0,79	272,68
13,50	796,50	-0,26	-0,29	0,40	228,16	0,30	-0,35	0,46	311,08
14,00	796,00	-0,21	-0,15	0,26	215,90	0,57	-0,05	0,57	354,60
14,50	795,50	0,13	-0,01	0,13	356,57	0,78	0,10	0,79	7,23
15,00	795,00	0,43	0,20	0,48	24,64	0,65	0,11	0,66	9,25
15,50	794,50	0,33	0,31	0,45	43,07	0,22	-0,09	0,24	337,50
16,00	794,00	0,14	0,21	0,26	55,82	-0,11	-0,40	0,41	254,88
16,50	793,50	-0,05	0,05	0,07	139,70	-0,25	-0,61	0,66	247,59
17,00	793,00	-0,22	-0,19	0,29	220,02	-0,20	-0,66	0,69	253,15
17,50	792,50	-0,09	-0,34	0,35	255,52	0,03	-0,47	0,47	273,06
18,00	792,00	0,22	-0,37	0,44	300,87	0,11	-0,13	0,17	310,91
18,50	791,50	0,15	0,03	0,15	11,63	-0,11	0,24	0,27	114,46
19,00	791,00	0,04	0,21	0,21	80,56	-0,26	0,21	0,34	140,36
19,50	790,50	-0,01	0,12	0,12	96,87	-0,29	0,00	0,29	179,29
20,00	790,00	-0,01	-0,06	0,06	258,43	-0,28	-0,12	0,30	203,37
20,50	789,50	0,02	-0,10	0,10	279,81	-0,27	-0,06	0,27	193,15
21,00	789,00	-0,04	0,30	0,30	97,35	-0,28	0,03	0,29	173,20
21,50	788,50	-0,04	0,49	0,49	94,09	-0,25	-0,26	0,36	226,93
22,00	788,00	-0,02	0,11	0,12	100,60	-0,21	-0,75	0,78	254,37
22,50	787,50	-0,11	-0,28	0,30	248,30	-0,19	-0,87	0,89	257,67
23,00	787,00	-0,17	-0,33	0,37	241,94	-0,08	-0,58	0,59	262,48
23,50	786,50	-0,15	-0,16	0,22	225,17	0,10	-0,26	0,28	290,53
24,00	786,00	-0,02	-0,05	0,05	247,13	0,25	-0,10	0,27	337,94
24,50	785,50	0,06	-0,01	0,06	353,96	0,27	-0,06	0,28	348,43
25,00	785,00	0,10	0,01	0,10	4,70	0,21	-0,05	0,22	346,86
25,50	784,50	0,11	-0,06	0,13	332,86	0,11	-0,06	0,13	332,86

Misura inclinometrica del 25/09/2018 00:00

Data/Ora: 25/09/2018 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314.

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 16/06/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 25/09/2018 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	809,50	-0,85	0,18	0,87	168,04	-4,57	-44,50	44,73	264,14
1,00	809,00	-0,84	-0,18	0,86	192,36	-3,72	-44,68	44,83	265,24
1,50	808,50	-0,63	-1,94	2,04	252,00	-2,87	-44,49	44,58	266,30
2,00	808,00	0,04	-6,45	6,45	270,39	-2,24	-42,55	42,61	266,98
2,50	807,50	1,22	-11,80	11,87	275,89	-2,29	-36,10	36,17	266,37
3,00	807,00	-0,70	-3,69	3,76	259,22	-3,51	-24,30	24,55	261,79
3,50	806,50	-1,29	-2,36	2,69	241,33	-2,80	-20,60	20,79	262,26
4,00	806,00	-0,69	-5,94	5,98	263,40	-1,51	-18,24	18,31	265,26
4,50	805,50	0,24	-6,37	6,37	272,18	-0,83	-12,30	12,33	266,16
5,00	805,00	0,13	-3,72	3,72	272,04	-1,07	-5,94	6,03	259,81
5,50	804,50	-0,18	-0,93	0,95	259,27	-1,20	-2,22	2,52	241,56
6,00	804,00	-0,55	0,85	1,02	122,96	-1,02	-1,29	1,64	231,47
6,50	803,50	-0,65	0,98	1,17	123,43	-0,47	-2,14	2,19	257,61
7,00	803,00	-0,50	0,57	0,76	131,27	0,18	-3,12	3,12	273,24
7,50	802,50	-0,29	0,32	0,43	132,10	0,68	-3,69	3,75	280,40
8,00	802,00	0,14	0,44	0,46	72,53	0,96	-4,01	4,12	283,52
8,50	801,50	0,36	0,10	0,37	16,36	0,83	-4,45	4,52	280,52
9,00	801,00	0,12	-0,55	0,57	282,32	0,47	-4,55	4,57	275,88
9,50	800,50	0,39	-0,35	0,52	318,29	0,35	-4,00	4,01	274,98
10,00	800,00	0,39	-0,28	0,48	323,99	-0,04	-3,65	3,65	269,33
10,50	799,50	0,08	-0,39	0,40	281,19	-0,43	-3,37	3,40	262,74
11,00	799,00	-0,30	-0,56	0,64	241,68	-0,51	-2,98	3,02	260,35
11,50	798,50	-0,08	-0,57	0,58	261,57	-0,20	-2,42	2,42	265,18
12,00	798,00	0,25	-0,48	0,54	297,23	-0,12	-1,84	1,85	266,31
12,50	797,50	-0,06	-0,57	0,58	264,34	-0,37	-1,36	1,41	254,90
13,00	797,00	-0,30	-0,47	0,56	237,46	-0,31	-0,79	0,85	248,49
13,50	796,50	-0,27	-0,29	0,40	226,40	-0,01	-0,31	0,31	268,61
14,00	796,00	-0,22	-0,15	0,27	213,43	0,27	-0,02	0,27	354,78
14,50	795,50	0,15	-0,09	0,18	327,95	0,49	0,12	0,50	13,99
15,00	795,00	0,46	0,17	0,49	20,19	0,34	0,21	0,40	32,24
15,50	794,50	0,34	0,35	0,48	45,78	-0,12	0,05	0,13	158,53
16,00	794,00	0,14	0,25	0,28	61,27	-0,45	-0,30	0,55	213,43
16,50	793,50	-0,06	0,08	0,10	128,20	-0,59	-0,55	0,80	222,83
17,00	793,00	-0,25	-0,13	0,28	207,72	-0,53	-0,63	0,82	229,89
17,50	792,50	-0,15	-0,43	0,46	250,23	-0,28	-0,50	0,57	240,63
18,00	792,00	0,20	-0,39	0,44	297,22	-0,12	-0,07	0,14	207,72
18,50	791,50	0,16	0,01	0,16	2,47	-0,32	0,32	0,46	135,02
19,00	791,00	0,04	0,21	0,21	80,56	-0,49	0,32	0,58	146,92
19,50	790,50	-0,03	0,16	0,17	101,99	-0,52	0,11	0,53	168,43
20,00	790,00	0,00	-0,02	0,02	258,43	-0,49	-0,06	0,49	186,72
20,50	789,50	-0,02	-0,06	0,06	251,31	-0,48	-0,04	0,49	184,51
21,00	789,00	-0,04	0,29	0,29	98,85	-0,46	0,02	0,46	177,26
21,50	788,50	-0,01	0,49	0,49	90,84	-0,42	-0,26	0,49	212,14
22,00	788,00	-0,05	0,14	0,15	108,37	-0,41	-0,75	0,86	241,25
22,50	787,50	-0,16	-0,27	0,31	238,85	-0,36	-0,89	0,97	247,82
23,00	787,00	-0,24	-0,33	0,41	234,73	-0,20	-0,63	0,66	252,06
23,50	786,50	-0,20	-0,24	0,32	229,80	0,03	-0,29	0,30	276,38
24,00	786,00	-0,02	-0,09	0,09	259,65	0,24	-0,05	0,24	347,97
24,50	785,50	0,06	-0,01	0,06	353,96	0,25	0,04	0,26	9,09
25,00	785,00	0,09	0,01	0,09	9,29	0,19	0,05	0,20	13,73
25,50	784,50	0,11	0,03	0,11	17,29	0,11	0,03	0,11	17,29

Misura inclinometrica del 24/09/2019 00:00

Data/Ora: 24/09/2019 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314.

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 16/06/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 24/09/2019 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	809,50	-0,67	0,16	0,69	166,30	-4,17	-44,41	44,60	264,64
1,00	809,00	-0,82	-0,10	0,83	186,70	-3,50	-44,57	44,71	265,51
1,50	808,50	-0,80	-1,78	1,95	245,89	-2,68	-44,48	44,56	266,55
2,00	808,00	0,03	-6,44	6,44	270,30	-1,88	-42,70	42,74	267,48
2,50	807,50	1,17	-11,91	11,96	275,62	-1,92	-36,26	36,31	266,98
3,00	807,00	-0,69	-3,90	3,96	259,92	-3,09	-24,35	24,54	262,77
3,50	806,50	-1,34	-2,42	2,76	241,04	-2,40	-20,45	20,59	263,32
4,00	806,00	-0,75	-6,05	6,09	262,94	-1,06	-18,03	18,06	266,64
4,50	805,50	0,23	-6,46	6,47	272,05	-0,31	-11,98	11,99	268,53
5,00	805,00	0,17	-3,81	3,82	272,49	-0,54	-5,52	5,55	264,43
5,50	804,50	-0,12	-0,96	0,97	262,76	-0,70	-1,71	1,85	247,58
6,00	804,00	-0,52	0,89	1,03	120,17	-0,58	-0,75	0,95	232,03
6,50	803,50	-0,65	1,01	1,20	122,63	-0,06	-1,64	1,64	267,74
7,00	803,00	-0,50	0,62	0,80	129,29	0,58	-2,64	2,71	282,38
7,50	802,50	-0,29	0,28	0,40	136,61	1,08	-3,26	3,44	288,39
8,00	802,00	0,12	0,42	0,44	74,83	1,38	-3,54	3,80	291,28
8,50	801,50	0,36	0,12	0,38	17,66	1,26	-3,96	4,16	287,68
9,00	801,00	0,14	-0,55	0,57	284,10	0,90	-4,08	4,18	282,45
9,50	800,50	0,42	-0,32	0,53	322,54	0,76	-3,53	3,61	282,19
10,00	800,00	0,40	-0,28	0,49	325,60	0,34	-3,21	3,23	276,09
10,50	799,50	0,09	-0,39	0,40	283,73	-0,06	-2,93	2,93	268,81
11,00	799,00	-0,32	-0,57	0,65	240,55	-0,16	-2,54	2,55	266,50
11,50	798,50	-0,07	-0,60	0,60	263,36	0,16	-1,98	1,99	274,74
12,00	798,00	0,29	-0,48	0,56	301,44	0,23	-1,38	1,40	279,58
12,50	797,50	-0,05	-0,61	0,61	265,51	-0,06	-0,90	0,91	266,21
13,00	797,00	-0,35	-0,46	0,58	232,57	-0,01	-0,30	0,30	267,65
13,50	796,50	-0,31	-0,30	0,43	223,94	0,34	0,16	0,38	25,78
14,00	796,00	-0,20	-0,14	0,25	214,72	0,65	0,46	0,80	35,44
14,50	795,50	0,22	-0,09	0,24	337,50	0,85	0,60	1,05	35,27
15,00	795,00	0,54	0,15	0,56	15,91	0,63	0,70	0,94	47,72
15,50	794,50	0,36	0,36	0,51	45,11	0,10	0,54	0,55	79,87
16,00	794,00	0,14	0,29	0,32	63,37	-0,26	0,18	0,32	145,52
16,50	793,50	-0,05	0,12	0,13	114,78	-0,41	-0,10	0,42	194,40
17,00	793,00	-0,27	-0,09	0,28	198,58	-0,35	-0,22	0,42	212,28
17,50	792,50	-0,15	-0,45	0,47	251,46	-0,08	-0,13	0,16	237,71
18,00	792,00	0,23	-0,42	0,48	298,39	0,07	0,32	0,32	78,08
18,50	791,50	0,17	-0,04	0,17	347,10	-0,16	0,73	0,75	102,31
19,00	791,00	0,05	0,26	0,26	79,29	-0,33	0,77	0,84	112,87
19,50	790,50	-0,03	0,23	0,23	96,25	-0,38	0,51	0,64	126,21
20,00	790,00	-0,02	0,00	0,02	168,43	-0,35	0,28	0,45	141,19
20,50	789,50	-0,03	-0,05	0,06	240,00	-0,33	0,28	0,43	139,99
21,00	789,00	-0,04	0,30	0,30	97,35	-0,30	0,33	0,45	132,07
21,50	788,50	-0,01	0,61	0,61	91,07	-0,26	0,04	0,26	172,31
22,00	788,00	0,00	0,20	0,20	89,74	-0,25	-0,57	0,62	246,34
22,50	787,50	-0,18	-0,26	0,31	234,29	-0,25	-0,77	0,81	252,00
23,00	787,00	-0,25	-0,34	0,42	233,19	-0,07	-0,52	0,52	262,57
23,50	786,50	-0,23	-0,26	0,34	228,49	0,19	-0,18	0,26	315,96
24,00	786,00	0,03	-0,03	0,05	314,05	0,41	0,08	0,42	10,79
24,50	785,50	0,11	0,05	0,12	25,49	0,38	0,11	0,40	16,27
25,00	785,00	0,11	0,03	0,11	15,00	0,27	0,06	0,28	12,27
25,50	784,50	0,16	0,03	0,16	10,36	0,16	0,03	0,16	10,36

Misura inclinometrica del 18/08/2020 00:00

Data/Ora: 18/08/2020 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314.

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 16/06/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 18/08/2020 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	809,50	-0,98	0,30	1,03	163,02	-4,57	-49,52	49,73	264,73
1,00	809,00	-0,91	-0,13	0,92	188,11	-3,58	-49,82	49,95	265,89
1,50	808,50	-0,89	-2,07	2,25	246,69	-2,67	-49,69	49,76	266,92
2,00	808,00	0,08	-7,29	7,29	270,61	-1,78	-47,62	47,65	267,86
2,50	807,50	1,29	-13,06	13,12	275,64	-1,86	-40,33	40,37	267,36
3,00	807,00	-0,82	-4,25	4,32	259,06	-3,15	-27,27	27,46	263,42
3,50	806,50	-1,47	-2,70	3,08	241,40	-2,33	-23,03	23,15	264,23
4,00	806,00	-0,80	-6,64	6,69	263,11	-0,85	-20,33	20,35	267,60
4,50	805,50	0,25	-7,11	7,11	272,00	-0,05	-13,69	13,69	269,78
5,00	805,00	0,20	-4,15	4,16	272,78	-0,30	-6,58	6,59	267,39
5,50	804,50	-0,10	-1,02	1,02	264,53	-0,50	-2,43	2,48	258,34
6,00	804,00	-0,53	0,97	1,11	118,65	-0,40	-1,41	1,47	254,04
6,50	803,50	-0,71	1,06	1,28	123,94	0,13	-2,38	2,39	273,02
7,00	803,00	-0,55	0,61	0,82	131,84	0,84	-3,44	3,55	283,71
7,50	802,50	-0,32	0,21	0,38	147,18	1,39	-4,06	4,29	288,90
8,00	802,00	0,16	0,27	0,31	60,00	1,71	-4,26	4,59	291,85
8,50	801,50	0,41	0,06	0,42	7,72	1,55	-4,53	4,79	288,91
9,00	801,00	0,19	-0,55	0,59	289,33	1,14	-4,59	4,73	283,93
9,50	800,50	0,46	-0,26	0,53	330,68	0,94	-4,04	4,15	283,17
10,00	800,00	0,39	-0,24	0,46	328,45	0,49	-3,78	3,81	277,34
10,50	799,50	0,03	-0,39	0,40	274,70	0,09	-3,54	3,54	271,50
11,00	799,00	-0,42	-0,64	0,76	236,72	0,06	-3,15	3,15	271,10
11,50	798,50	-0,09	-0,63	0,63	262,01	0,48	-2,51	2,55	280,83
12,00	798,00	0,36	-0,52	0,63	304,71	0,57	-1,88	1,96	286,81
12,50	797,50	-0,01	-0,64	0,64	269,05	0,21	-1,36	1,38	278,74
13,00	797,00	-0,37	-0,54	0,65	235,60	0,22	-0,72	0,75	287,02
13,50	796,50	-0,24	-0,31	0,39	231,74	0,59	-0,18	0,62	342,91
14,00	796,00	-0,22	-0,12	0,25	208,30	0,83	0,13	0,84	8,66
14,50	795,50	0,18	-0,06	0,19	343,13	1,05	0,24	1,08	13,12
15,00	795,00	0,50	0,04	0,50	4,88	0,87	0,30	0,92	19,14
15,50	794,50	0,35	0,32	0,48	42,51	0,37	0,26	0,45	35,22
16,00	794,00	0,12	0,29	0,31	68,13	0,01	-0,07	0,07	281,19
16,50	793,50	-0,02	0,16	0,16	96,87	-0,10	-0,35	0,37	253,80
17,00	793,00	-0,26	-0,08	0,27	196,85	-0,08	-0,51	0,51	260,64
17,50	792,50	-0,13	-0,43	0,45	253,65	0,18	-0,43	0,46	292,67
18,00	792,00	0,24	-0,44	0,50	298,67	0,31	0,00	0,31	0,76
18,50	791,50	0,20	-0,06	0,21	344,04	0,06	0,45	0,45	81,95
19,00	791,00	0,11	0,19	0,23	60,00	-0,13	0,50	0,52	105,00
19,50	790,50	0,01	0,18	0,18	88,30	-0,25	0,31	0,40	128,70
20,00	790,00	-0,03	-0,02	0,04	209,04	-0,25	0,12	0,28	153,81
20,50	789,50	-0,04	-0,08	0,09	240,00	-0,22	0,14	0,26	147,27
21,00	789,00	-0,03	0,22	0,22	96,87	-0,18	0,22	0,28	129,15
21,50	788,50	-0,03	0,47	0,47	93,69	-0,15	0,00	0,15	179,74
22,00	788,00	0,01	0,24	0,24	87,90	-0,12	-0,47	0,49	255,64
22,50	787,50	-0,16	-0,14	0,21	221,03	-0,13	-0,71	0,72	259,69
23,00	787,00	-0,28	-0,35	0,45	231,98	0,03	-0,57	0,57	273,00
23,50	786,50	-0,24	-0,30	0,38	231,47	0,31	-0,22	0,38	324,29
24,00	786,00	0,03	-0,06	0,07	296,31	0,54	0,08	0,55	8,05
24,50	785,50	0,14	0,03	0,15	13,26	0,51	0,14	0,53	15,00
25,00	785,00	0,16	0,04	0,17	15,00	0,37	0,10	0,38	15,66
25,50	784,50	0,21	0,06	0,22	16,17	0,21	0,06	0,22	16,17

Misura inclinometrica del 03/06/2021 00:00

Data/Ora: 03/06/2021 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314.

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 16/06/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 03/06/2021 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	809,50	-0,97	0,15	0,98	171,33	-5,03	-51,68	51,92	264,44
1,00	809,00	-1,00	-0,16	1,02	189,26	-4,06	-51,82	51,98	265,52
1,50	808,50	-0,94	-2,33	2,51	248,01	-3,06	-51,66	51,75	266,61
2,00	808,00	0,15	-7,98	7,99	271,10	-2,12	-49,33	49,38	267,54
2,50	807,50	1,38	-13,76	13,82	275,71	-2,27	-41,35	41,41	266,86
3,00	807,00	-0,97	-4,26	4,37	257,14	-3,65	-27,59	27,83	262,47
3,50	806,50	-1,56	-2,98	3,37	242,34	-2,67	-23,33	23,49	263,46
4,00	806,00	-0,86	-7,24	7,29	263,22	-1,11	-20,35	20,38	266,87
4,50	805,50	0,25	-7,66	7,66	271,86	-0,25	-13,11	13,11	268,90
5,00	805,00	0,22	-4,32	4,33	272,91	-0,50	-5,46	5,48	264,75
5,50	804,50	-0,12	-0,91	0,91	262,53	-0,72	-1,14	1,34	237,60
6,00	804,00	-0,56	1,07	1,21	117,46	-0,60	-0,23	0,64	200,91
6,50	803,50	-0,74	1,09	1,32	124,16	-0,04	-1,30	1,30	268,04
7,00	803,00	-0,60	0,62	0,86	134,45	0,70	-2,39	2,49	286,22
7,50	802,50	-0,29	0,12	0,31	158,13	1,30	-3,01	3,28	293,37
8,00	802,00	0,22	0,15	0,26	34,65	1,59	-3,13	3,51	296,93
8,50	801,50	0,47	0,00	0,47	359,65	1,37	-3,27	3,55	292,73
9,00	801,00	0,23	-0,54	0,59	292,77	0,90	-3,27	3,39	285,45
9,50	800,50	0,45	-0,25	0,51	330,70	0,68	-2,73	2,81	283,92
10,00	800,00	0,37	-0,17	0,40	335,36	0,23	-2,48	2,49	275,29
10,50	799,50	-0,04	-0,37	0,37	263,96	-0,14	-2,31	2,31	266,63
11,00	799,00	-0,47	-0,64	0,79	233,21	-0,10	-1,94	1,95	267,14
11,50	798,50	-0,03	-0,62	0,62	267,60	0,38	-1,31	1,36	286,12
12,00	798,00	0,37	-0,54	0,66	304,65	0,40	-0,69	0,80	300,42
12,50	797,50	-0,06	-0,67	0,68	265,14	0,03	-0,15	0,15	281,63
13,00	797,00	-0,43	-0,56	0,71	232,87	0,09	0,53	0,53	80,56
13,50	796,50	-0,30	-0,26	0,40	220,71	0,51	1,09	1,20	64,76
14,00	796,00	-0,16	-0,04	0,16	193,45	0,81	1,35	1,58	58,86
14,50	795,50	0,26	0,00	0,26	0,26	0,97	1,39	1,69	54,92
15,00	795,00	0,61	0,20	0,64	18,18	0,71	1,39	1,56	62,76
15,50	794,50	0,35	0,40	0,53	48,42	0,11	1,19	1,19	84,82
16,00	794,00	0,11	0,36	0,38	72,43	-0,24	0,79	0,83	107,14
16,50	793,50	-0,08	0,18	0,19	114,25	-0,36	0,43	0,56	129,74
17,00	793,00	-0,28	-0,04	0,29	187,87	-0,28	0,25	0,38	137,57
17,50	792,50	-0,12	-0,38	0,40	251,84	0,00	0,29	0,29	89,29
18,00	792,00	0,24	-0,43	0,49	299,16	0,13	0,67	0,68	79,27
18,50	791,50	0,21	-0,01	0,21	358,07	-0,11	1,10	1,10	95,76
19,00	791,00	-0,01	0,26	0,26	91,43	-0,32	1,10	1,15	106,32
19,50	790,50	-0,02	0,20	0,20	94,70	-0,32	0,84	0,90	110,65
20,00	790,00	-0,06	0,01	0,06	168,43	-0,30	0,64	0,71	115,05
20,50	789,50	0,01	-0,08	0,08	278,66	-0,24	0,63	0,68	111,01
21,00	789,00	-0,10	0,33	0,35	107,17	-0,25	0,71	0,75	109,71
21,50	788,50	-0,04	0,46	0,46	94,55	-0,15	0,38	0,41	111,89
22,00	788,00	-0,02	0,30	0,30	93,02	-0,11	-0,09	0,14	216,80
22,50	787,50	-0,20	-0,09	0,22	203,13	-0,10	-0,38	0,40	255,57
23,00	787,00	-0,28	-0,26	0,39	223,03	0,10	-0,30	0,31	289,03
23,50	786,50	-0,23	-0,19	0,29	218,88	0,38	-0,03	0,39	354,90
24,00	786,00	0,14	-0,04	0,15	344,62	0,61	0,15	0,63	13,80
24,50	785,50	0,10	0,14	0,18	53,88	0,47	0,19	0,51	22,00
25,00	785,00	0,18	0,00	0,18	0,96	0,37	0,05	0,37	7,45
25,50	784,50	0,18	0,04	0,19	13,67	0,18	0,04	0,19	13,67

Misura inclinometrica del 29/06/2022 00:00

Data/Ora: 29/06/2022 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314.

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 16/06/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 29/06/2022 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	809,50	-1,04	0,28	1,07	165,17	-5,43	-52,96	53,24	264,15
1,00	809,00	-1,06	-0,18	1,07	189,55	-4,39	-53,24	53,42	265,29
1,50	808,50	-0,97	-2,21	2,41	246,24	-3,33	-53,06	53,17	266,41
2,00	808,00	0,08	-7,81	7,81	270,59	-2,36	-50,85	50,91	267,34
2,50	807,50	1,27	-13,91	13,97	275,22	-2,44	-43,04	43,11	266,75
3,00	807,00	-0,94	-4,65	4,75	258,58	-3,71	-29,13	29,36	262,74
3,50	806,50	-1,64	-2,91	3,34	240,64	-2,77	-24,47	24,63	263,54
4,00	806,00	-0,94	-7,13	7,20	262,47	-1,13	-21,57	21,60	266,99
4,50	805,50	0,19	-7,73	7,73	271,44	-0,19	-14,43	14,43	269,24
5,00	805,00	0,21	-4,53	4,54	272,68	-0,39	-6,71	6,72	266,71
5,50	804,50	-0,10	-1,09	1,10	264,96	-0,60	-2,17	2,25	254,61
6,00	804,00	-0,58	1,03	1,18	119,50	-0,50	-1,08	1,19	245,11
6,50	803,50	-0,78	1,14	1,39	124,36	0,08	-2,11	2,11	272,19
7,00	803,00	-0,58	0,63	0,86	132,62	0,86	-3,26	3,37	284,85
7,50	802,50	-0,29	0,13	0,32	155,60	1,44	-3,89	4,15	290,38
8,00	802,00	0,17	0,15	0,23	40,56	1,74	-4,02	4,38	293,36
8,50	801,50	0,45	0,01	0,45	1,24	1,56	-4,17	4,45	290,59
9,00	801,00	0,23	-0,56	0,61	292,54	1,12	-4,17	4,32	285,00
9,50	800,50	0,47	-0,26	0,54	330,67	0,89	-3,61	3,72	283,78
10,00	800,00	0,37	-0,24	0,44	326,73	0,42	-3,35	3,38	277,10
10,50	799,50	-0,04	-0,40	0,40	264,15	0,05	-3,11	3,11	270,94
11,00	799,00	-0,51	-0,64	0,82	231,68	0,09	-2,72	2,72	271,94
11,50	798,50	-0,09	-0,66	0,66	262,20	0,60	-2,07	2,16	286,17
12,00	798,00	0,42	-0,48	0,64	311,21	0,69	-1,42	1,58	295,99
12,50	797,50	-0,05	-0,69	0,69	265,64	0,27	-0,93	0,97	286,04
13,00	797,00	-0,43	-0,60	0,74	234,19	0,32	-0,24	0,40	322,87
13,50	796,50	-0,30	-0,29	0,42	223,47	0,76	0,36	0,84	25,36
14,00	796,00	-0,18	-0,08	0,20	203,84	1,06	0,64	1,24	31,37
14,50	795,50	0,28	-0,08	0,30	343,45	1,24	0,73	1,44	30,32
15,00	795,00	0,61	0,11	0,62	10,10	0,96	0,81	1,26	40,21
15,50	794,50	0,35	0,37	0,51	46,48	0,35	0,70	0,78	63,66
16,00	794,00	0,09	0,34	0,36	75,26	0,00	0,33	0,33	90,41
16,50	793,50	-0,07	0,20	0,21	108,65	-0,09	-0,01	0,09	186,87
17,00	793,00	-0,29	0,00	0,29	180,96	-0,03	-0,21	0,21	262,75
17,50	792,50	-0,16	-0,47	0,50	250,89	0,26	-0,20	0,33	322,48
18,00	792,00	0,22	-0,48	0,53	295,18	0,43	0,27	0,50	31,84
18,50	791,50	0,22	-0,05	0,22	346,39	0,20	0,74	0,77	74,60
19,00	791,00	0,11	0,21	0,24	63,01	-0,01	0,79	0,79	90,81
19,50	790,50	0,00	0,20	0,20	89,74	-0,12	0,58	0,59	101,58
20,00	790,00	-0,03	-0,01	0,03	195,00	-0,12	0,38	0,40	107,54
20,50	789,50	-0,02	-0,03	0,04	240,00	-0,09	0,39	0,40	103,73
21,00	789,00	-0,06	0,18	0,19	108,99	-0,08	0,42	0,43	100,24
21,50	788,50	-0,03	0,42	0,42	94,64	-0,01	0,24	0,24	93,27
22,00	788,00	0,02	0,29	0,29	85,46	0,02	-0,18	0,18	276,47
22,50	787,50	-0,14	-0,03	0,15	193,26	0,00	-0,47	0,47	269,65
23,00	787,00	-0,26	-0,28	0,38	226,65	0,14	-0,43	0,46	287,78
23,50	786,50	-0,26	-0,26	0,36	225,00	0,40	-0,16	0,43	338,37
24,00	786,00	0,08	-0,03	0,08	338,75	0,66	0,10	0,66	8,49
24,50	785,50	0,19	0,06	0,20	18,81	0,58	0,13	0,59	12,44
25,00	785,00	0,16	0,04	0,17	15,00	0,39	0,06	0,40	9,23
25,50	784,50	0,23	0,02	0,23	4,99	0,23	0,02	0,23	4,99

Misura inclinometrica del 21/08/2023 00:00

Data/Ora: 21/08/2023 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S060314.

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,5

Intervallo letture [m]: 0,5

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 16/06/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 21/08/2023 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	809,50	-1,17	0,32	1,21	164,61	-1,36	-56,51	56,53	268,63
1,00	809,00	-1,13	-0,09	1,14	184,48	-0,19	-56,83	56,83	269,81
1,50	808,50	-1,03	-2,18	2,41	244,76	0,95	-56,75	56,75	270,96
2,00	808,00	0,17	-7,88	7,88	271,24	1,97	-54,57	54,60	272,07
2,50	807,50	1,61	-14,17	14,26	276,50	1,80	-46,69	46,72	272,21
3,00	807,00	-0,85	-4,79	4,87	259,97	0,19	-32,52	32,52	270,33
3,50	806,50	-1,61	-2,94	3,35	241,28	1,04	-27,73	27,75	272,14
4,00	806,00	-0,78	-7,23	7,27	263,83	2,65	-24,79	24,93	276,10
4,50	805,50	0,42	-7,83	7,84	273,09	3,43	-17,56	17,89	281,05
5,00	805,00	0,32	-4,67	4,68	273,94	3,01	-9,73	10,19	287,16
5,50	804,50	-0,11	-1,16	1,16	264,78	2,68	-5,06	5,73	297,92
6,00	804,00	-0,66	1,06	1,25	122,03	2,79	-3,91	4,80	305,54
6,50	803,50	-0,88	1,18	1,47	126,48	3,45	-4,97	6,05	304,81
7,00	803,00	-0,66	0,65	0,92	135,49	4,33	-6,15	7,52	305,14
7,50	802,50	-0,32	0,13	0,35	157,25	4,99	-6,80	8,43	306,27
8,00	802,00	0,18	0,16	0,24	41,57	5,31	-6,93	8,73	307,44
8,50	801,50	0,47	0,00	0,47	359,65	5,13	-7,09	8,75	305,89
9,00	801,00	0,28	-0,58	0,65	295,23	4,66	-7,09	8,48	303,34
9,50	800,50	0,52	-0,29	0,60	330,60	4,39	-6,50	7,84	304,01
10,00	800,00	0,42	-0,25	0,49	328,53	3,86	-6,21	7,31	301,90
10,50	799,50	-0,16	-0,35	0,39	245,53	3,45	-5,95	6,88	300,08
11,00	799,00	-0,48	-0,70	0,85	235,38	3,61	-5,60	6,66	302,81
11,50	798,50	-0,03	-0,73	0,73	267,44	4,09	-4,90	6,38	309,90
12,00	798,00	0,51	-0,58	0,77	311,57	4,13	-4,17	5,86	314,73
12,50	797,50	0,04	-0,79	0,79	272,68	3,62	-3,59	5,09	315,21
13,00	797,00	-0,34	-0,69	0,76	243,75	3,58	-2,80	4,54	321,94
13,50	796,50	-0,24	-0,35	0,43	235,79	3,92	-2,12	4,45	331,61
14,00	796,00	-0,09	-0,08	0,12	218,75	4,16	-1,76	4,51	337,00
14,50	795,50	0,35	-0,09	0,36	345,00	4,25	-1,69	4,57	338,33
15,00	795,00	0,66	0,04	0,66	3,39	3,90	-1,59	4,21	337,76
15,50	794,50	0,39	0,29	0,48	36,41	3,24	-1,63	3,63	333,26
16,00	794,00	0,17	0,30	0,34	61,04	2,85	-1,92	3,44	326,04
16,50	793,50	0,02	0,18	0,18	82,93	2,69	-2,22	3,49	320,40
17,00	793,00	-0,20	-0,02	0,20	184,70	2,66	-2,40	3,58	318,02
17,50	792,50	-0,07	-0,55	0,56	263,11	2,86	-2,38	3,72	320,24
18,00	792,00	0,33	-0,58	0,67	299,86	2,93	-1,83	3,45	328,03
18,50	791,50	0,33	-0,16	0,36	333,95	2,59	-1,24	2,88	334,36
19,00	791,00	0,19	0,15	0,24	38,75	2,27	-1,09	2,51	334,42
19,50	790,50	0,14	0,17	0,22	49,99	2,08	-1,24	2,42	329,26
20,00	790,00	0,09	-0,06	0,11	326,63	1,94	-1,40	2,39	324,16
20,50	789,50	0,08	-0,18	0,20	295,30	1,85	-1,34	2,29	324,04
21,00	789,00	0,07	0,03	0,08	25,01	1,77	-1,16	2,12	326,61
21,50	788,50	0,14	0,32	0,35	66,23	1,70	-1,20	2,08	324,82
22,00	788,00	0,26	0,17	0,31	33,43	1,56	-1,51	2,17	315,84
22,50	787,50	0,02	-0,10	0,10	282,51	1,30	-1,68	2,13	307,73
23,00	787,00	0,00	-0,38	0,38	269,51	1,28	-1,58	2,04	308,95
23,50	786,50	0,03	-0,59	0,59	272,52	1,28	-1,20	1,76	316,85
24,00	786,00	0,13	-0,22	0,25	300,26	1,26	-0,61	1,40	334,10
24,50	785,50	0,40	-0,16	0,44	338,25	1,13	-0,39	1,20	340,84
25,00	785,00	0,32	-0,09	0,33	344,30	0,73	-0,23	0,76	342,32
25,50	784,50	0,41	-0,14	0,43	340,82	0,41	-0,14	0,43	340,82

Misura inclinometrica del 11/12/2023 14:51

Data/Ora: 11/12/2023 14:51:03

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S222643

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 16/06/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 11/12/2023 14:51									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	809,50	-2,10	0,04	2,10	178,89	-4,13	-89,50	89,59	267,36
1,00	809,00	-1,97	-0,73	2,10	200,22	-2,03	-89,54	89,56	268,70
1,50	808,50	-1,55	-4,23	4,50	249,85	-0,06	-88,81	88,81	269,96
2,00	808,00	0,59	-15,49	15,50	272,20	1,49	-84,59	84,60	271,01
2,50	807,50	2,15	-23,86	23,96	275,16	0,89	-69,09	69,10	270,74
3,00	807,00	-1,59	-7,44	7,61	257,94	-1,26	-45,23	45,25	268,41
3,50	806,50	-2,45	-4,40	5,04	240,85	0,33	-37,79	37,79	270,50
4,00	806,00	-1,47	-11,05	11,14	262,41	2,79	-33,39	33,51	274,77
4,50	805,50	0,18	-11,40	11,41	270,88	4,26	-22,35	22,75	280,79
5,00	805,00	0,10	-6,41	6,41	270,86	4,08	-10,94	11,68	290,46
5,50	804,50	-0,26	-1,33	1,36	258,94	3,98	-4,53	6,04	311,31
6,00	804,00	-0,66	1,64	1,77	111,88	4,25	-3,20	5,32	322,98
6,50	803,50	-0,70	1,60	1,75	113,73	4,90	-4,84	6,89	315,36
7,00	803,00	-0,58	0,67	0,88	130,73	5,61	-6,44	8,54	311,04
7,50	802,50	-0,33	0,02	0,34	176,01	6,18	-7,11	9,42	311,01
8,00	802,00	0,22	0,05	0,22	13,24	6,52	-7,13	9,66	312,42
8,50	801,50	0,64	-0,05	0,64	355,67	6,30	-7,18	9,55	311,24
9,00	801,00	0,49	-0,62	0,79	308,02	5,66	-7,14	9,11	308,43
9,50	800,50	0,69	-0,30	0,76	336,39	5,18	-6,51	8,32	308,47
10,00	800,00	0,47	-0,26	0,53	331,16	4,48	-6,21	7,66	305,82
10,50	799,50	-0,27	-0,45	0,52	238,98	4,02	-5,95	7,18	304,00
11,00	799,00	-0,68	-0,89	1,12	232,29	4,29	-5,51	6,98	307,89
11,50	798,50	-0,05	-0,79	0,80	266,07	4,97	-4,62	6,79	317,08
12,00	798,00	0,65	-0,55	0,85	319,59	5,02	-3,83	6,32	322,70
12,50	797,50	0,10	-0,84	0,84	277,15	4,38	-3,28	5,47	323,18
13,00	797,00	-0,31	-0,77	0,83	248,03	4,27	-2,44	4,92	330,26
13,50	796,50	-0,22	-0,38	0,44	239,39	4,59	-1,67	4,88	340,01
14,00	796,00	-0,06	-0,02	0,07	198,04	4,81	-1,29	4,98	345,00
14,50	795,50	0,45	-0,05	0,46	354,23	4,87	-1,27	5,04	345,41
15,00	795,00	0,71	0,08	0,72	6,09	4,42	-1,22	4,59	344,54
15,50	794,50	0,46	0,53	0,70	49,33	3,71	-1,30	3,93	340,70
16,00	794,00	0,17	0,38	0,42	66,67	3,25	-1,83	3,73	330,65
16,50	793,50	0,06	0,19	0,20	73,85	3,09	-2,21	3,80	324,35
17,00	793,00	-0,21	-0,01	0,21	183,59	3,03	-2,41	3,87	321,55
17,50	792,50	-0,10	-0,56	0,57	260,26	3,24	-2,39	4,03	323,53
18,00	792,00	0,39	-0,68	0,78	299,83	3,33	-1,83	3,80	331,22
18,50	791,50	0,34	-0,18	0,38	331,78	2,95	-1,15	3,16	338,60
19,00	791,00	0,20	0,22	0,30	48,20	2,61	-0,97	2,78	339,54
19,50	790,50	0,12	0,26	0,29	65,23	2,41	-1,20	2,69	333,58
20,00	790,00	0,06	-0,06	0,09	316,32	2,29	-1,46	2,71	327,43
20,50	789,50	0,12	-0,27	0,30	292,87	2,22	-1,40	2,63	327,79
21,00	789,00	0,09	-0,04	0,09	336,03	2,11	-1,13	2,39	331,88
21,50	788,50	0,16	0,26	0,31	59,38	2,02	-1,09	2,30	331,71
22,00	788,00	0,33	0,20	0,39	31,58	1,87	-1,35	2,30	324,06
22,50	787,50	0,08	-0,03	0,09	341,52	1,54	-1,56	2,19	314,61
23,00	787,00	-0,01	-0,37	0,37	268,45	1,45	-1,53	2,11	313,54
23,50	786,50	0,03	-0,57	0,57	272,65	1,46	-1,15	1,86	321,71
24,00	786,00	0,19	-0,20	0,28	312,80	1,44	-0,58	1,55	337,97
24,50	785,50	0,46	-0,16	0,49	341,32	1,25	-0,38	1,30	343,17
25,00	785,00	0,35	-0,10	0,36	344,64	0,78	-0,22	0,82	344,28
25,50	784,50	0,44	-0,12	0,45	343,99	0,44	-0,12	0,45	343,99

Misura inclinometrica del 05/08/2024 13:58

Data/Ora: 05/08/2024 13:58:34

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S222643

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1




Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50




Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 16/06/2009 00:00

Elaborazione dati - misura del 05/08/2024 13:58									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	809,50	-2,13	0,18	2,14	175,13	-5,74	-91,30	91,48	266,40
1,00	809,00	-2,04	-0,66	2,14	198,06	-3,61	-91,48	91,56	267,74
1,50	808,50	-1,62	-4,35	4,64	249,52	-1,58	-90,82	90,84	269,01
2,00	808,00	0,54	-15,81	15,82	271,94	0,05	-86,48	86,48	270,03
2,50	807,50	2,10	-24,29	24,38	274,94	-0,49	-70,66	70,66	269,60
3,00	807,00	-1,76	-7,62	7,82	256,98	-2,59	-46,37	46,44	266,80
3,50	806,50	-2,63	-4,62	5,31	240,30	-0,83	-38,75	38,76	268,78
4,00	806,00	-1,64	-11,29	11,41	261,74	1,81	-34,13	34,18	273,03
4,50	805,50	0,01	-11,47	11,47	270,07	3,45	-22,84	23,10	278,58
5,00	805,00	0,05	-6,47	6,47	270,46	3,43	-11,37	11,88	286,79
5,50	804,50	-0,24	-1,43	1,45	260,40	3,38	-4,90	5,95	304,60
6,00	804,00	-0,63	1,59	1,71	111,71	3,62	-3,47	5,02	316,25
6,50	803,50	-0,72	1,60	1,75	114,18	4,25	-5,06	6,61	310,08
7,00	803,00	-0,63	0,74	0,97	130,55	4,97	-6,65	8,31	306,77
7,50	802,50	-0,44	0,07	0,44	170,72	5,60	-7,39	9,27	307,16
8,00	802,00	0,13	0,13	0,18	43,97	6,04	-7,46	9,60	308,99
8,50	801,50	0,60	0,01	0,60	1,12	5,91	-7,59	9,62	307,89
9,00	801,00	0,51	-0,59	0,78	310,90	5,31	-7,60	9,27	304,92
9,50	800,50	0,75	-0,32	0,82	336,84	4,80	-7,01	8,49	304,37
10,00	800,00	0,51	-0,35	0,62	325,70	4,04	-6,69	7,81	301,14
10,50	799,50	-0,24	-0,54	0,59	246,15	3,53	-6,34	7,25	299,10
11,00	799,00	-0,71	-0,99	1,22	234,52	3,77	-5,79	6,91	303,03
11,50	798,50	-0,08	-0,83	0,83	264,65	4,47	-4,80	6,56	312,97
12,00	798,00	0,63	-0,56	0,84	318,55	4,55	-3,97	6,04	318,89
12,50	797,50	0,09	-0,88	0,88	275,63	3,92	-3,42	5,20	318,94
13,00	797,00	-0,31	-0,83	0,89	249,83	3,84	-2,54	4,60	326,52
13,50	796,50	-0,20	-0,36	0,41	241,51	4,14	-1,70	4,48	337,65
14,00	796,00	-0,04	0,04	0,06	137,61	4,34	-1,34	4,54	342,85
14,50	795,50	0,45	-0,02	0,45	357,31	4,38	-1,38	4,59	342,55
15,00	795,00	0,69	0,03	0,70	2,76	3,93	-1,36	4,16	340,97
15,50	794,50	0,40	0,53	0,66	52,75	3,24	-1,39	3,52	336,77
16,00	794,00	0,13	0,41	0,44	72,25	2,84	-1,92	3,42	325,97
16,50	793,50	0,06	0,22	0,22	75,62	2,71	-2,33	3,57	319,24
17,00	793,00	-0,21	0,00	0,21	179,25	2,65	-2,55	3,68	316,10
17,50	792,50	-0,14	-0,60	0,62	256,66	2,86	-2,55	3,83	318,26
18,00	792,00	0,37	-0,71	0,80	297,12	3,00	-1,95	3,58	326,98
18,50	791,50	0,38	-0,23	0,44	329,15	2,64	-1,24	2,91	334,87
19,00	791,00	0,19	0,25	0,31	52,57	2,26	-1,01	2,47	335,89
19,50	790,50	0,05	0,28	0,28	78,95	2,07	-1,26	2,42	328,71
20,00	790,00	-0,01	-0,05	0,05	262,49	2,01	-1,53	2,53	322,68
20,50	789,50	0,05	-0,31	0,31	278,63	2,02	-1,48	2,50	323,76
21,00	789,00	0,05	-0,13	0,14	288,74	1,97	-1,17	2,29	329,27
21,50	788,50	0,14	0,14	0,20	44,75	1,93	-1,04	2,19	331,68
22,00	788,00	0,30	0,16	0,34	28,66	1,78	-1,18	2,14	326,52
22,50	787,50	0,10	0,04	0,11	19,81	1,49	-1,34	2,00	317,97
23,00	787,00	0,03	-0,19	0,19	278,74	1,39	-1,38	1,96	315,19
23,50	786,50	-0,03	-0,51	0,51	266,77	1,36	-1,19	1,80	318,84
24,00	786,00	0,19	-0,19	0,27	314,61	1,39	-0,68	1,54	333,92
24,50	785,50	0,36	-0,14	0,38	338,19	1,20	-0,49	1,29	337,87
25,00	785,00	0,40	-0,19	0,44	334,79	0,84	-0,34	0,91	337,73
25,50	784,50	0,44	-0,16	0,47	340,47	0,44	-0,16	0,47	340,47

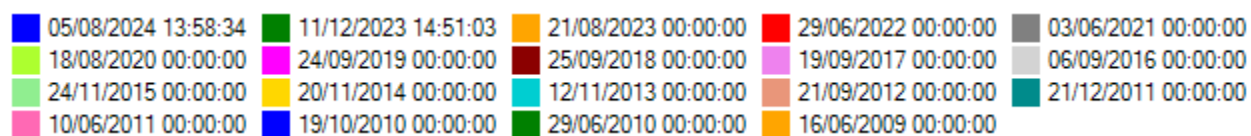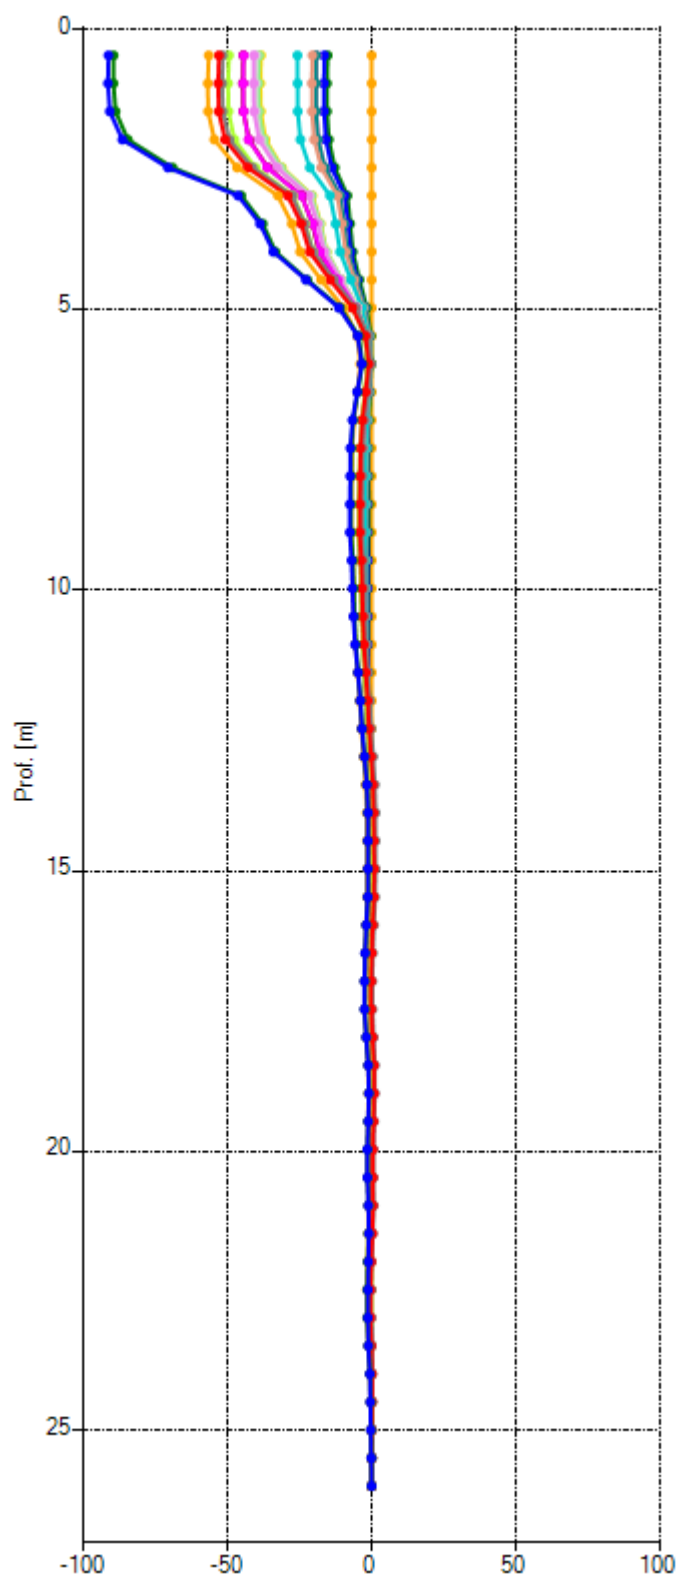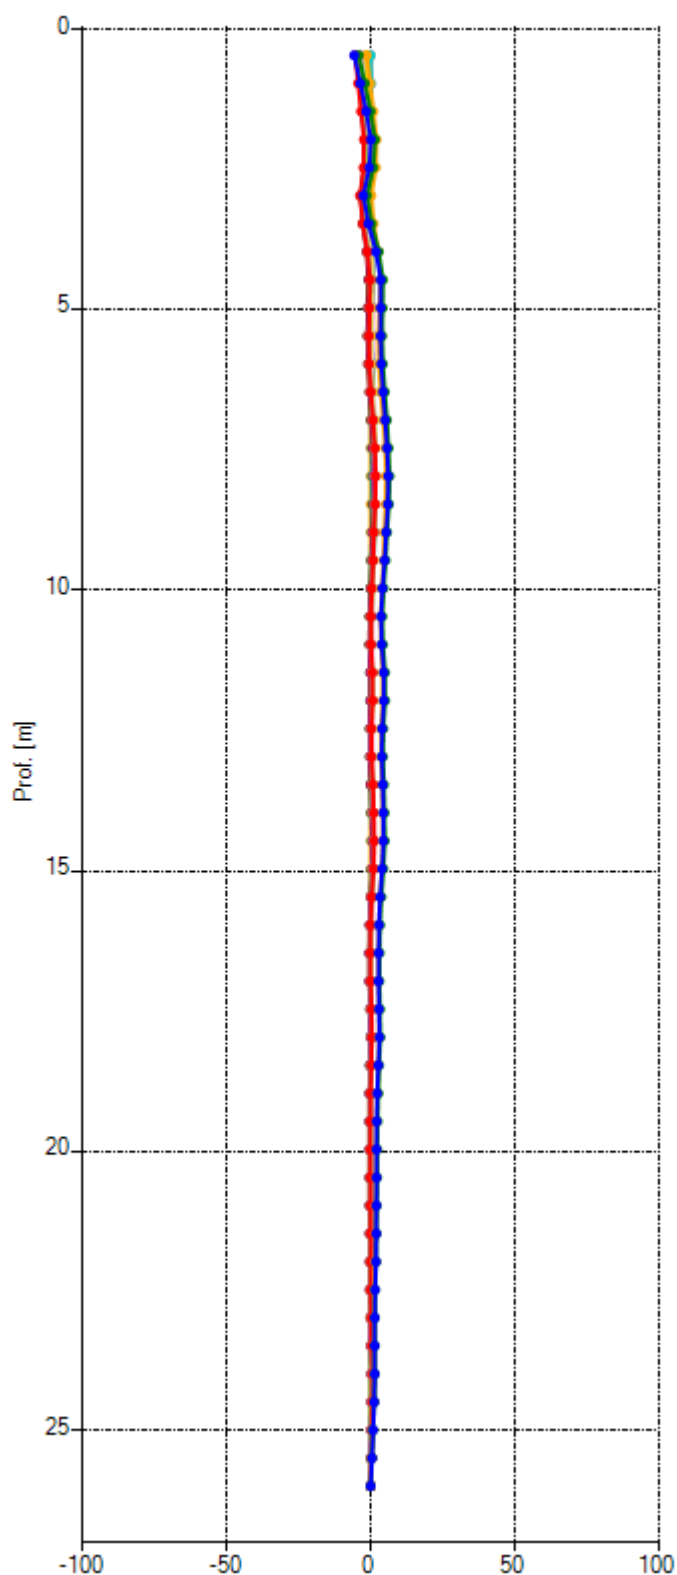


Misura inclinometrica di riferimento 16/06/2009 00:00

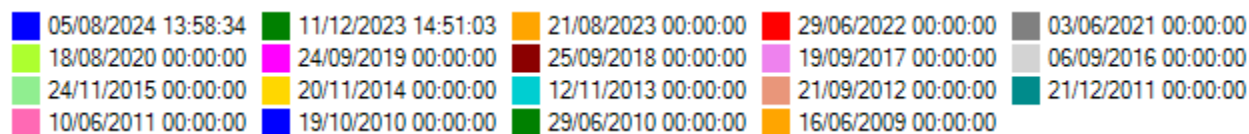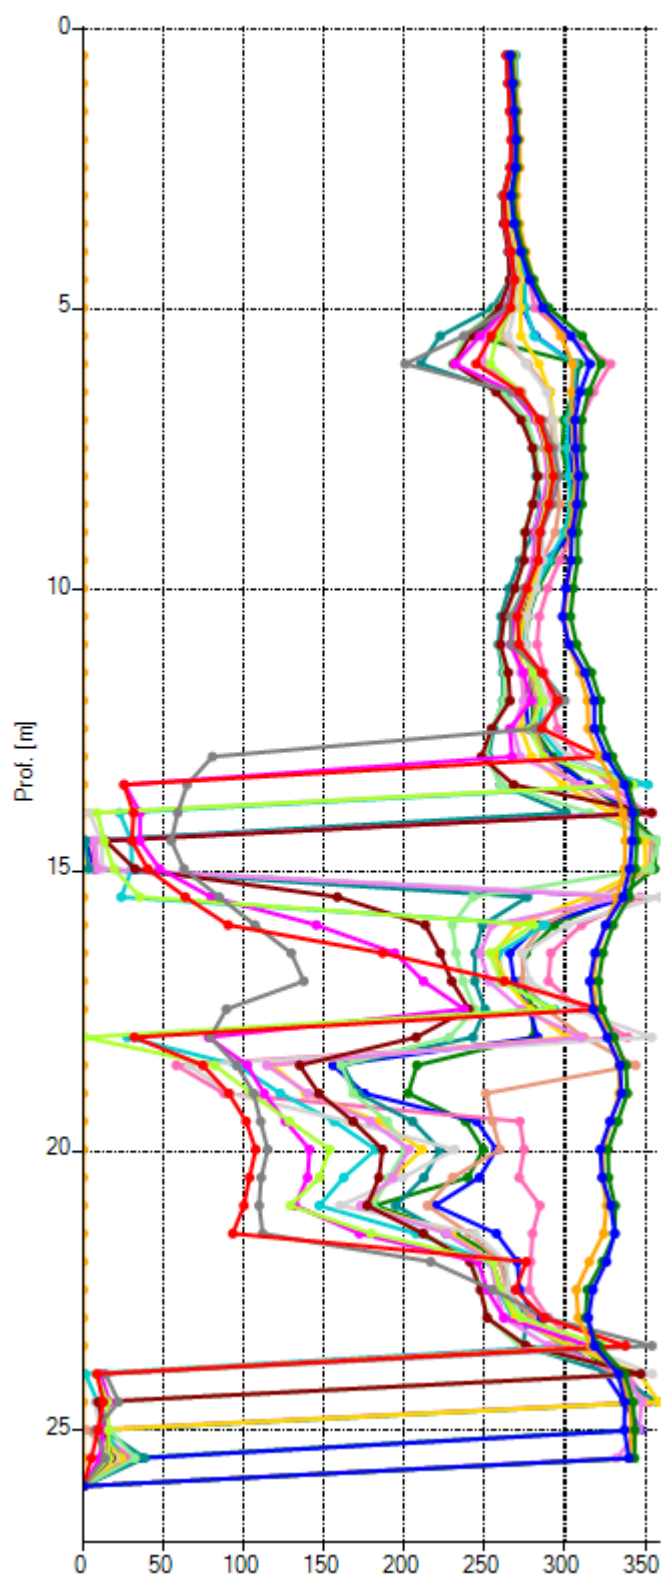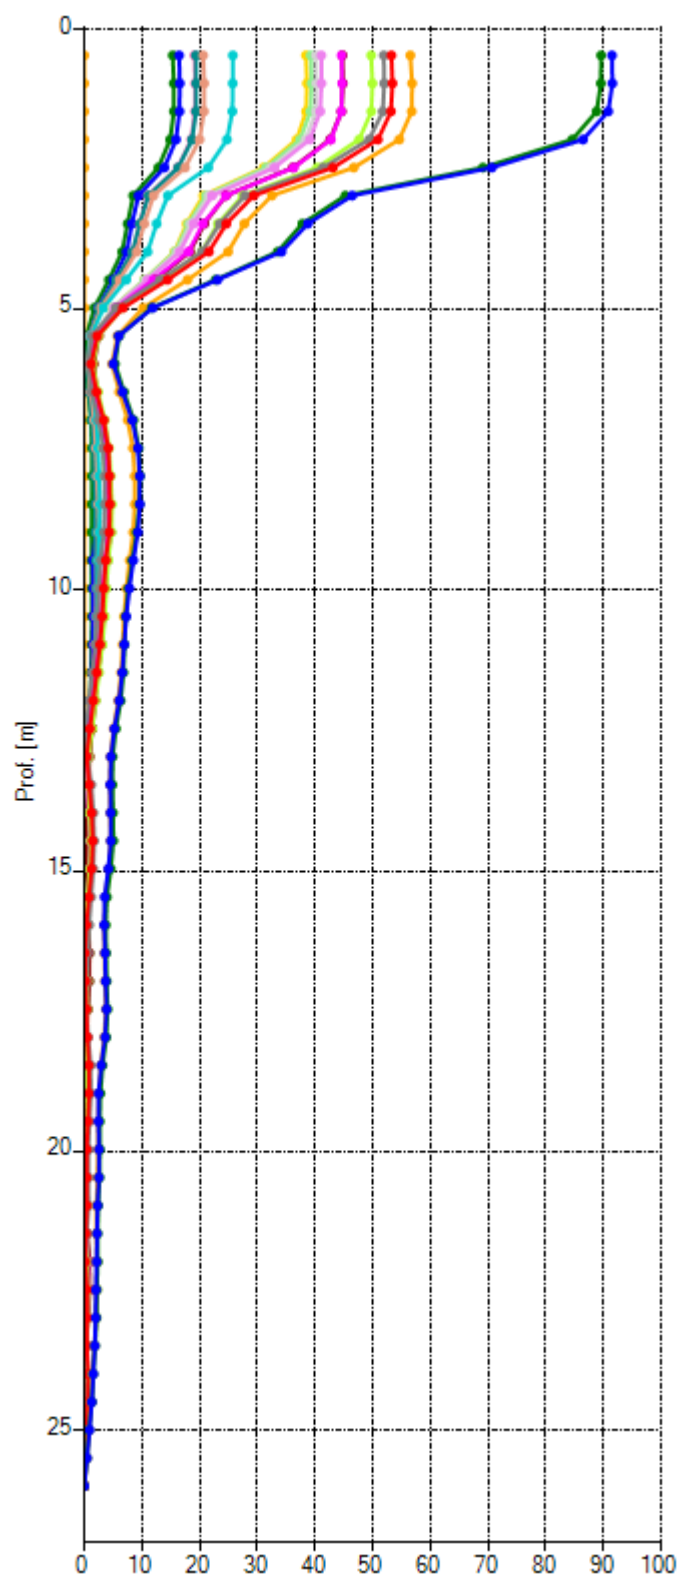


Misura inclinometrica di riferimento 16/06/2009 00:00:00

Deformazione nel tempo


Nord

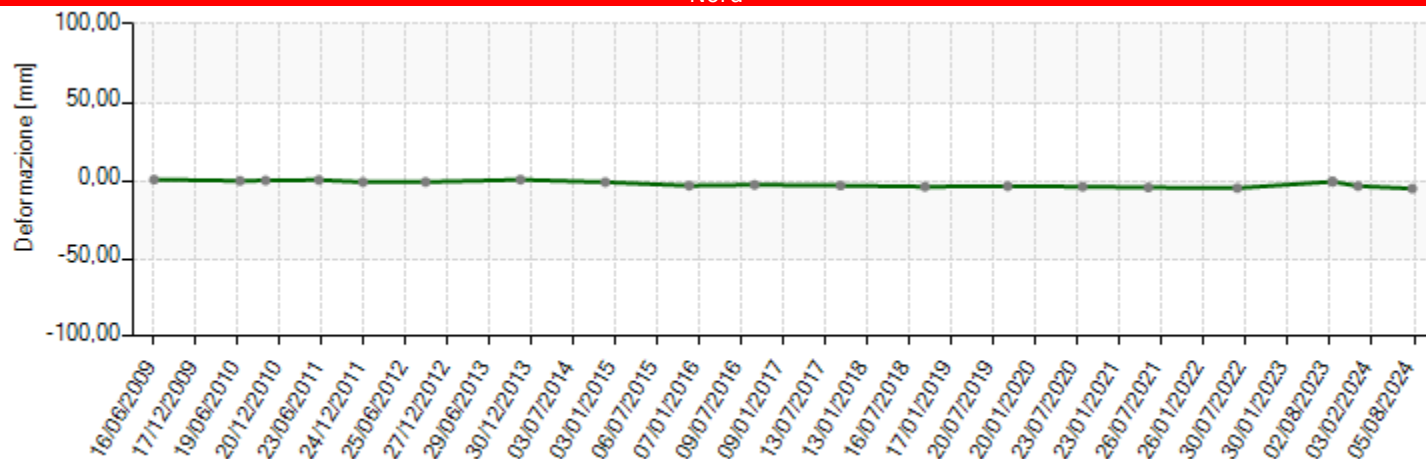

Est

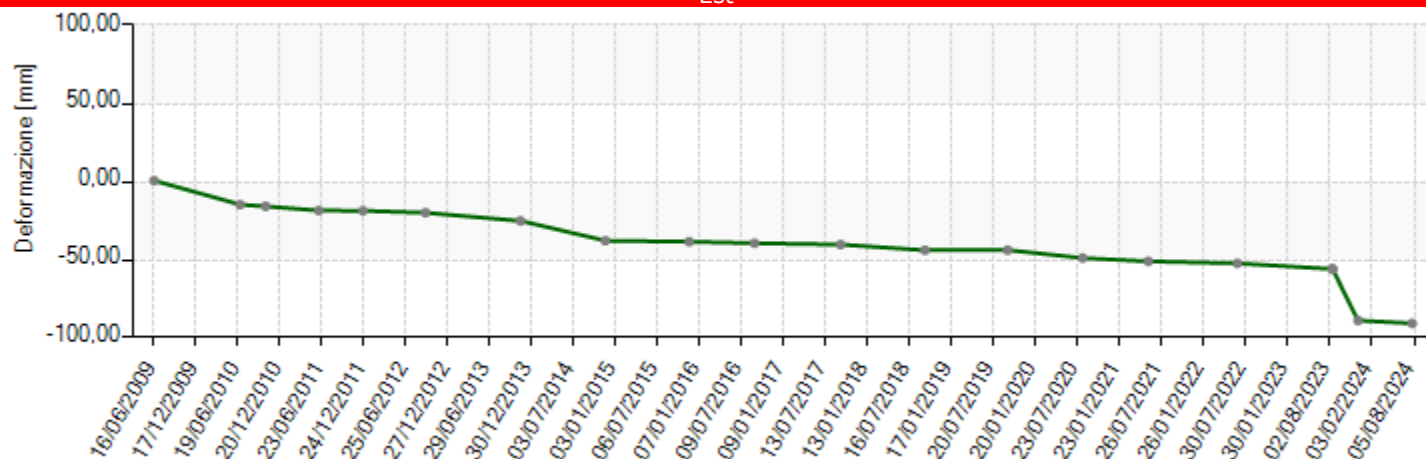

Risultante

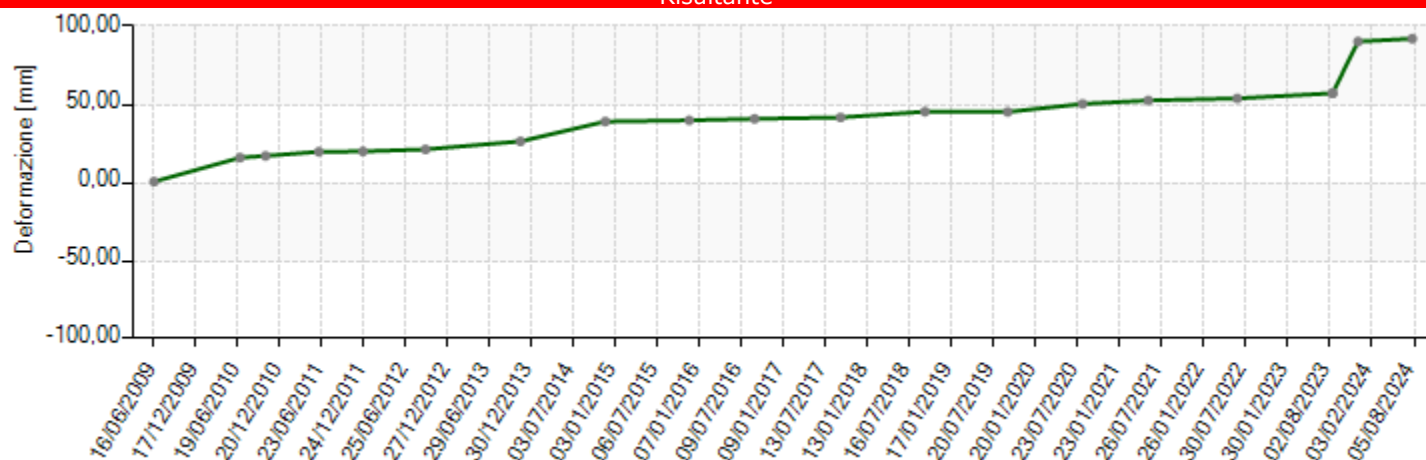

Prof.: ■ 0,50 (809,50) [m]