



KLION Report

Proprietà Sito

Sito: Biscaccia

Attuatore: Comune di Mele (GE)

Proprietà Tubo

Nome: RM510_S1

Azimuth [°]: 350,00

Latitudine: 44,457060

Altitudine [m s.l.m.]: 134


Orientamento: VERTICALE

Longitudine: 8,750002

Sporgenza dal Suolo [m]: 0

Posizione

Orientamento

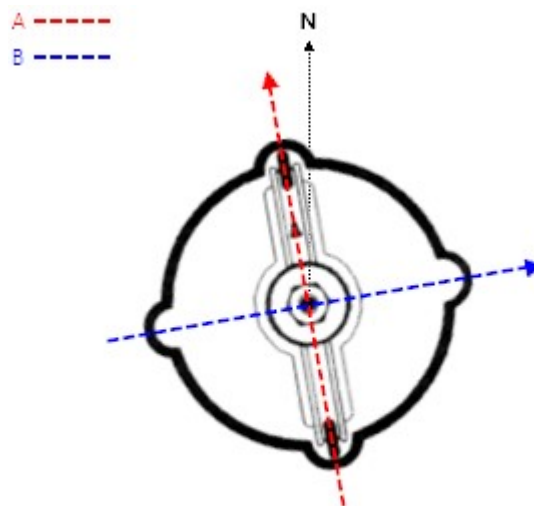

Azimuth [°]: 350,00

Opzioni di elaborazione inclinometrica

Riferimento al fondo: Sì

Relativo - variazione dalla misura di riferimento

Correzione Bias Shift: No

Compensazione spiralometrica: No

Curva cumulata

Misura inclinometrica del 10/06/2015 00:00

Data/Ora: 10/06/2015 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3A2A4B2B4

ID Sonda (serial number): S091260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: 10/06/2015 00:00

Spostamenti rispetto alla verticale

Prof [m]	Nord [mm]	Est [mm]
0,50	-3,95	-1,70
1,00	-4,81	-2,85
1,50	-3,27	-2,72
2,00	-3,06	-2,60
2,50	-3,30	-2,71
3,00	-2,89	-3,02
3,50	-2,96	-3,26
4,00	-2,95	-3,52
4,50	-3,15	-1,26
5,00	-2,66	-1,19
5,50	-2,34	-1,64
6,00	-1,90	-1,76
6,50	-1,59	-2,02
7,00	-1,69	-1,04
7,50	-2,25	0,17
8,00	-1,93	-0,38
8,50	-0,92	-1,28
9,00	-0,48	-2,21
9,50	-0,74	-2,36
10,00	-1,11	-1,58
10,50	-0,73	-0,77
11,00	-0,45	-1,27
11,50	-0,21	-2,17
12,00	-0,05	-2,09
12,50	0,02	-2,00
13,00	0,51	-1,51
13,50	-1,11	-0,63
14,00	-1,67	-0,80
14,50	-1,88	-0,92
15,00	-1,67	-1,17
15,50	-0,98	-1,83
16,00	0,07	-2,35
16,50	0,30	-1,23
17,00	-0,05	-0,87
17,50	-0,41	-0,52
18,00	-0,81	-0,51
18,50	-1,65	-0,25
19,00	-2,19	-0,24
19,50	-0,25	0,03
20,00	-0,14	0,25
20,50	-0,30	0,52
21,00	-0,40	0,67
21,50	-0,52	1,18
22,00	-0,81	1,17
22,50	-1,02	2,04
23,00	-1,17	2,67
23,50	-1,29	2,51
24,00	-1,47	2,42
24,50	-1,82	2,27

Misura inclinometrica del 15/09/2015 00:00

Data/Ora: 15/09/2015 00:00:00	Sequenza Letture: A1A3B1B3
ID Sonda (serial number): S091260	Sensibilità sonda [sin α]: 20000
Ch A convenzione: -1	Ch B convenzione: -1
Profondità 1.a lettura [m]: 0,50	Intervallo letture [m]: 0,50
Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 10/06/2015 00:00	

Elaborazione dati - misura del 15/09/2015 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	133,50	-0,02	-0,14	0,14	262,60	0,13	-0,32	0,34	293,11
1,00	133,00	0,27	0,13	0,30	25,68	0,15	-0,18	0,24	310,39
1,50	132,50	0,07	0,02	0,08	14,44	-0,12	-0,31	0,33	249,11
2,00	132,00	0,06	0,00	0,06	355,71	-0,19	-0,33	0,38	239,78
2,50	131,50	0,06	-0,01	0,06	350,00	-0,25	-0,32	0,41	231,88
3,00	131,00	0,01	0,00	0,01	350,00	-0,31	-0,31	0,44	225,41
3,50	130,50	0,04	0,02	0,05	23,69	-0,32	-0,31	0,44	224,74
4,00	130,00	-0,06	-0,12	0,13	240,71	-0,36	-0,33	0,49	222,84
4,50	129,50	0,01	0,01	0,01	53,43	-0,29	-0,22	0,36	216,40
5,00	129,00	-0,08	0,03	0,09	157,91	-0,30	-0,23	0,38	217,02
5,50	128,50	-0,02	0,00	0,02	170,00	-0,22	-0,26	0,34	230,12
6,00	128,00	0,01	0,01	0,01	53,43	-0,20	-0,26	0,33	232,95
6,50	127,50	0,01	0,00	0,01	350,00	-0,21	-0,27	0,34	232,97
7,00	127,00	0,06	0,08	0,10	54,98	-0,21	-0,27	0,35	232,05
7,50	126,50	-0,02	-0,05	0,05	245,96	-0,27	-0,36	0,45	232,72
8,00	126,00	0,01	-0,07	0,07	279,98	-0,25	-0,31	0,40	231,03
8,50	125,50	0,03	-0,02	0,04	323,43	-0,26	-0,24	0,36	222,13
9,00	125,00	0,03	-0,02	0,04	331,57	-0,30	-0,21	0,37	215,69
9,50	124,50	0,01	-0,01	0,01	305,00	-0,33	-0,20	0,39	210,40
10,00	124,00	0,06	-0,10	0,12	302,88	-0,34	-0,19	0,39	209,09
10,50	123,50	0,01	0,00	0,01	350,00	-0,40	-0,09	0,41	192,29
11,00	123,00	0,00	0,01	0,01	80,00	-0,41	-0,09	0,42	191,96
11,50	122,50	-0,04	-0,03	0,05	215,00	-0,41	-0,09	0,42	192,75
12,00	122,00	0,00	0,02	0,02	80,00	-0,37	-0,06	0,37	189,65
12,50	121,50	0,03	-0,03	0,04	311,34	-0,37	-0,08	0,38	192,33
13,00	121,00	-0,09	0,03	0,09	162,41	-0,40	-0,05	0,40	187,30
13,50	120,50	0,00	-0,02	0,03	260,00	-0,31	-0,08	0,32	194,54
14,00	120,00	0,03	0,04	0,05	56,80	-0,30	-0,05	0,31	190,28
14,50	119,50	0,03	0,00	0,03	4,04	-0,33	-0,09	0,34	196,10
15,00	119,00	0,04	-0,01	0,04	340,54	-0,35	-0,10	0,37	195,25
15,50	118,50	0,03	0,01	0,03	11,80	-0,39	-0,08	0,40	192,14
16,00	118,00	0,01	-0,10	0,10	277,35	-0,42	-0,09	0,43	192,11
16,50	117,50	0,00	0,05	0,05	94,04	-0,44	0,01	0,44	178,25
17,00	117,00	-0,04	0,00	0,04	179,46	-0,43	-0,04	0,43	185,04
17,50	116,50	0,00	0,02	0,02	80,00	-0,39	-0,04	0,40	185,57
18,00	116,00	-0,03	0,02	0,04	143,43	-0,40	-0,06	0,40	188,15
18,50	115,50	-0,04	0,00	0,04	178,13	-0,36	-0,08	0,37	192,69
19,00	115,00	0,00	-0,01	0,01	286,57	-0,32	-0,08	0,33	194,62
19,50	114,50	-0,01	0,13	0,13	94,04	-0,32	-0,07	0,33	192,20
20,00	114,00	-0,02	0,01	0,02	151,57	-0,31	-0,20	0,37	212,27
20,50	113,50	-0,03	-0,01	0,03	196,57	-0,30	-0,21	0,36	215,00
21,00	113,00	-0,02	-0,02	0,03	223,13	-0,27	-0,20	0,34	216,51
21,50	112,50	-0,03	0,00	0,03	184,04	-0,25	-0,18	0,30	215,83
22,00	112,00	-0,02	-0,05	0,05	245,96	-0,22	-0,18	0,28	218,58
22,50	111,50	-0,05	0,00	0,05	177,13	-0,20	-0,13	0,24	212,88
23,00	111,00	-0,01	-0,01	0,01	233,43	-0,15	-0,13	0,20	221,34
23,50	110,50	-0,06	-0,07	0,09	229,74	-0,14	-0,12	0,19	220,44
24,00	110,00	-0,03	-0,04	0,06	233,43	-0,09	-0,05	0,10	212,51
24,50	109,50	-0,05	-0,01	0,05	190,56	-0,05	-0,01	0,05	190,56

Misura inclinometrica del 11/04/2016 00:00

Data/Ora: 11/04/2016 00:00:00 Sequenza Letture: A1A3B1B3
 ID Sonda (serial number): S091260 Sensibilità sonda [sin α]: 20000
 Ch A convenzione: -1 Ch B convenzione: -1
 Profondità 1.a lettura [m]: 0,50 Intervallo letture [m]: 0,50
 Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 10/06/2015 00:00

Elaborazione dati - misura del 11/04/2016 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	133,50	0,09	0,16	0,18	62,18	-0,09	-0,67	0,68	262,12
1,00	133,00	0,26	0,23	0,35	41,50	-0,18	-0,83	0,85	257,89
1,50	132,50	0,05	0,04	0,06	35,00	-0,44	-1,06	1,15	247,47
2,00	132,00	0,03	-0,04	0,05	310,19	-0,49	-1,10	1,21	245,89
2,50	131,50	0,03	-0,03	0,04	311,34	-0,52	-1,06	1,18	243,76
3,00	131,00	-0,01	0,00	0,01	170,00	-0,55	-1,03	1,17	241,95
3,50	130,50	0,03	0,02	0,04	35,00	-0,54	-1,03	1,17	242,24
4,00	130,00	-0,14	-0,19	0,24	233,43	-0,57	-1,05	1,20	241,47
4,50	129,50	-0,03	-0,01	0,03	191,80	-0,43	-0,86	0,97	243,44
5,00	129,00	-0,01	0,03	0,03	101,80	-0,40	-0,86	0,94	245,04
5,50	128,50	-0,06	-0,03	0,07	203,69	-0,39	-0,89	0,97	246,23
6,00	128,00	-0,01	-0,02	0,03	245,96	-0,33	-0,86	0,92	249,07
6,50	127,50	0,05	0,00	0,05	5,95	-0,32	-0,84	0,90	249,16
7,00	127,00	0,03	0,09	0,10	68,69	-0,36	-0,84	0,92	246,63
7,50	126,50	-0,03	-0,03	0,05	226,31	-0,40	-0,93	1,01	246,82
8,00	126,00	0,01	-0,03	0,03	281,80	-0,37	-0,90	0,97	247,75
8,50	125,50	-0,03	0,06	0,07	113,69	-0,37	-0,87	0,94	246,61
9,00	125,00	0,02	0,02	0,03	53,43	-0,35	-0,93	0,99	249,47
9,50	124,50	0,02	-0,05	0,05	295,54	-0,36	-0,95	1,02	249,03
10,00	124,00	0,09	-0,13	0,15	303,36	-0,39	-0,90	0,98	246,76
10,50	123,50	-0,03	0,02	0,03	148,20	-0,47	-0,77	0,91	238,57
11,00	123,00	0,00	0,02	0,02	80,00	-0,44	-0,79	0,91	240,69
11,50	122,50	-0,04	-0,02	0,05	203,69	-0,45	-0,81	0,93	241,08
12,00	122,00	-0,02	-0,04	0,05	244,05	-0,41	-0,79	0,89	242,84
12,50	121,50	0,01	-0,03	0,03	296,87	-0,39	-0,75	0,84	242,77
13,00	121,00	-0,08	0,00	0,08	178,75	-0,40	-0,72	0,83	241,02
13,50	120,50	0,03	-0,09	0,10	289,74	-0,32	-0,72	0,79	246,29
14,00	120,00	0,04	0,06	0,08	55,56	-0,35	-0,63	0,72	240,78
14,50	119,50	0,02	-0,02	0,03	313,13	-0,39	-0,69	0,80	240,29
15,00	119,00	0,00	-0,06	0,06	272,53	-0,42	-0,67	0,79	238,11
15,50	118,50	0,00	0,01	0,01	106,57	-0,42	-0,61	0,74	235,60
16,00	118,00	0,02	-0,14	0,14	277,65	-0,41	-0,62	0,75	236,43
16,50	117,50	0,00	0,02	0,02	80,00	-0,43	-0,48	0,65	227,99
17,00	117,00	-0,03	-0,04	0,05	230,26	-0,44	-0,51	0,67	229,13
17,50	116,50	0,05	0,00	0,05	357,13	-0,41	-0,47	0,62	229,04
18,00	116,00	-0,03	-0,05	0,06	236,04	-0,46	-0,47	0,65	225,55
18,50	115,50	0,00	-0,03	0,03	271,31	-0,42	-0,41	0,59	224,46
19,00	115,00	-0,07	0,13	0,15	119,81	-0,42	-0,38	0,57	222,13
19,50	114,50	-0,01	0,03	0,03	116,87	-0,35	-0,51	0,62	235,51
20,00	114,00	-0,01	-0,01	0,01	215,00	-0,34	-0,54	0,63	237,99
20,50	113,50	-0,02	-0,03	0,04	241,57	-0,33	-0,53	0,63	238,30
21,00	113,00	-0,02	-0,03	0,04	233,43	-0,31	-0,50	0,59	238,09
21,50	112,50	-0,04	-0,04	0,06	219,40	-0,28	-0,46	0,54	238,44
22,00	112,00	-0,06	-0,26	0,26	257,27	-0,24	-0,43	0,49	240,64
22,50	111,50	-0,03	-0,04	0,05	230,26	-0,18	-0,17	0,25	223,13
23,00	111,00	-0,06	0,01	0,06	170,00	-0,15	-0,13	0,20	221,34
23,50	110,50	-0,05	-0,05	0,08	225,01	-0,09	-0,14	0,17	236,25
24,00	110,00	-0,04	-0,06	0,07	238,20	-0,04	-0,09	0,10	245,07
24,50	109,50	-0,01	-0,03	0,03	260,00	-0,01	-0,03	0,03	260,00

Misura inclinometrica del 08/09/2016 00:00

Data/Ora: 08/09/2016 00:00:00	Sequenza Letture: A1A3B1B3
ID Sonda (serial number): S091260	Sensibilità sonda [sin α]: 20000
Ch A convenzione: -1	Ch B convenzione: -1
Profondità 1.a lettura [m]: 0,50	Intervallo letture [m]: 0,50
Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 10/06/2015 00:00	

Elaborazione dati - misura del 08/09/2016 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	133,50	0,03	-0,25	0,25	276,14	-0,17	-1,19	1,20	261,79
1,00	133,00	0,16	0,00	0,16	359,09	-0,20	-0,94	0,96	258,14
1,50	132,50	0,01	-0,03	0,04	290,96	-0,36	-0,94	1,01	249,25
2,00	132,00	0,05	-0,03	0,05	329,44	-0,37	-0,91	0,98	247,83
2,50	131,50	-0,01	-0,14	0,14	267,77	-0,42	-0,88	0,97	244,71
3,00	131,00	-0,02	-0,01	0,02	203,69	-0,41	-0,74	0,85	241,03
3,50	130,50	0,00	0,01	0,01	80,00	-0,39	-0,73	0,83	241,98
4,00	130,00	-0,14	-0,17	0,22	230,46	-0,39	-0,74	0,84	242,24
4,50	129,50	-0,03	-0,01	0,03	191,80	-0,25	-0,58	0,63	246,24
5,00	129,00	0,03	0,03	0,04	41,34	-0,22	-0,57	0,61	248,80
5,50	128,50	-0,03	-0,07	0,08	245,96	-0,25	-0,60	0,65	247,17
6,00	128,00	0,02	-0,02	0,02	316,31	-0,22	-0,53	0,57	247,33
6,50	127,50	0,02	0,00	0,02	350,00	-0,24	-0,51	0,56	245,19
7,00	127,00	-0,15	0,15	0,21	134,87	-0,25	-0,51	0,57	243,36
7,50	126,50	-0,04	-0,07	0,08	241,57	-0,11	-0,65	0,66	260,54
8,00	126,00	0,03	-0,02	0,04	323,43	-0,07	-0,58	0,59	263,04
8,50	125,50	-0,03	0,00	0,03	184,04	-0,10	-0,56	0,57	259,37
9,00	125,00	0,03	0,01	0,03	16,57	-0,08	-0,56	0,56	261,91
9,50	124,50	0,00	-0,03	0,03	271,31	-0,11	-0,57	0,58	259,38
10,00	124,00	0,09	-0,09	0,13	314,78	-0,11	-0,53	0,54	258,68
10,50	123,50	0,03	-0,07	0,08	294,99	-0,20	-0,44	0,48	245,78
11,00	123,00	-0,01	0,02	0,02	113,69	-0,23	-0,37	0,44	238,20
11,50	122,50	-0,04	-0,03	0,05	215,00	-0,22	-0,39	0,45	240,56
12,00	122,00	0,01	-0,03	0,03	281,80	-0,18	-0,36	0,40	243,81
12,50	121,50	0,01	-0,03	0,03	296,87	-0,18	-0,33	0,38	240,67
13,00	121,00	-0,07	0,08	0,10	132,43	-0,20	-0,30	0,36	236,54
13,50	120,50	0,01	0,01	0,02	35,00	-0,13	-0,38	0,40	250,98
14,00	120,00	0,04	0,07	0,09	58,96	-0,14	-0,39	0,41	249,54
14,50	119,50	0,03	0,03	0,04	41,34	-0,19	-0,46	0,50	247,70
15,00	119,00	0,03	-0,13	0,13	282,83	-0,22	-0,49	0,54	245,80
15,50	118,50	0,02	-0,04	0,05	299,81	-0,25	-0,36	0,44	235,62
16,00	118,00	0,02	-0,14	0,14	277,65	-0,27	-0,32	0,42	229,62
16,50	117,50	-0,01	0,01	0,02	125,00	-0,29	-0,18	0,34	211,28
17,00	117,00	-0,03	-0,03	0,04	221,34	-0,28	-0,19	0,34	214,26
17,50	116,50	0,02	-0,01	0,03	335,96	-0,25	-0,17	0,30	213,32
18,00	116,00	-0,03	0,00	0,03	184,04	-0,27	-0,15	0,32	209,37
18,50	115,50	-0,04	-0,04	0,05	224,46	-0,25	-0,15	0,29	211,53
19,00	115,00	0,02	-0,04	0,05	299,81	-0,21	-0,12	0,24	208,66
19,50	114,50	0,01	0,15	0,15	87,13	-0,23	-0,07	0,25	197,22
20,00	114,00	0,01	0,01	0,01	35,00	-0,24	-0,22	0,33	222,70
20,50	113,50	-0,05	0,06	0,08	131,34	-0,25	-0,23	0,34	222,50
21,00	113,00	-0,01	-0,05	0,05	252,87	-0,20	-0,29	0,35	235,73
21,50	112,50	-0,01	0,00	0,01	196,57	-0,18	-0,24	0,30	232,90
22,00	112,00	-0,02	-0,05	0,05	245,96	-0,17	-0,24	0,29	234,54
22,50	111,50	-0,06	-0,03	0,07	211,19	-0,15	-0,19	0,24	232,10
23,00	111,00	0,02	-0,02	0,02	316,31	-0,09	-0,16	0,18	239,68
23,50	110,50	-0,03	-0,08	0,09	247,91	-0,11	-0,14	0,18	232,53
24,00	110,00	-0,02	-0,05	0,05	245,96	-0,07	-0,06	0,09	217,73
24,50	109,50	-0,05	-0,01	0,05	190,56	-0,05	-0,01	0,05	190,56

Misura inclinometrica del 08/06/2017 00:00

Data/Ora: 08/06/2017 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S091260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 10/06/2015 00:00

Elaborazione dati - misura del 08/06/2017 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	133,50	-0,11	-0,37	0,39	253,56	-0,17	-0,91	0,93	259,23
1,00	133,00	0,17	0,14	0,22	38,50	-0,06	-0,53	0,54	263,33
1,50	132,50	-0,02	0,00	0,02	188,43	-0,23	-0,67	0,71	250,87
2,00	132,00	0,07	-0,03	0,08	335,96	-0,21	-0,67	0,70	252,30
2,50	131,50	-0,02	0,02	0,02	136,31	-0,28	-0,64	0,70	245,96
3,00	131,00	-0,01	-0,04	0,04	250,54	-0,27	-0,65	0,70	247,69
3,50	130,50	0,01	-0,01	0,02	305,00	-0,25	-0,62	0,67	247,53
4,00	130,00	-0,15	-0,18	0,23	229,30	-0,26	-0,60	0,66	246,23
4,50	129,50	-0,01	-0,01	0,01	233,43	-0,11	-0,42	0,44	255,10
5,00	129,00	-0,01	0,00	0,01	196,57	-0,10	-0,41	0,43	255,79
5,50	128,50	-0,05	-0,05	0,08	225,01	-0,09	-0,41	0,42	257,44
6,00	128,00	0,03	-0,03	0,04	311,34	-0,04	-0,36	0,36	264,01
6,50	127,50	0,01	-0,03	0,03	296,87	-0,06	-0,33	0,33	258,92
7,00	127,00	0,03	0,09	0,10	68,69	-0,08	-0,30	0,31	255,33
7,50	126,50	-0,05	-0,02	0,06	196,57	-0,11	-0,39	0,40	253,76
8,00	126,00	0,01	-0,07	0,07	279,98	-0,06	-0,37	0,38	260,95
8,50	125,50	-0,02	0,01	0,03	155,96	-0,07	-0,30	0,31	256,50
9,00	125,00	0,03	0,03	0,05	46,31	-0,05	-0,31	0,31	261,15
9,50	124,50	-0,03	0,00	0,03	181,31	-0,08	-0,34	0,35	256,93
10,00	124,00	0,08	-0,09	0,12	311,34	-0,05	-0,34	0,34	262,08
10,50	123,50	-0,02	-0,03	0,04	233,43	-0,13	-0,25	0,28	243,18
11,00	123,00	0,02	0,02	0,02	46,31	-0,10	-0,22	0,24	244,88
11,50	122,50	-0,04	-0,02	0,05	203,69	-0,12	-0,23	0,26	243,30
12,00	122,00	-0,01	0,00	0,01	196,57	-0,08	-0,22	0,23	250,54
12,50	121,50	0,03	-0,02	0,03	328,20	-0,06	-0,21	0,22	253,48
13,00	121,00	-0,06	-0,01	0,06	193,96	-0,09	-0,19	0,21	244,74
13,50	120,50	0,03	0,01	0,03	16,57	-0,03	-0,18	0,18	260,00
14,00	120,00	0,06	0,02	0,06	19,05	-0,06	-0,19	0,20	252,65
14,50	119,50	0,06	-0,03	0,07	333,30	-0,12	-0,21	0,24	240,14
15,00	119,00	0,04	0,00	0,04	359,46	-0,18	-0,18	0,25	225,12
15,50	118,50	0,01	0,01	0,01	53,43	-0,22	-0,18	0,28	219,54
16,00	118,00	0,01	-0,13	0,13	274,04	-0,22	-0,19	0,29	220,19
16,50	117,50	-0,02	0,05	0,06	106,57	-0,23	-0,06	0,24	194,57
17,00	117,00	-0,03	-0,01	0,03	206,87	-0,22	-0,11	0,25	207,75
17,50	116,50	0,05	-0,07	0,08	308,01	-0,19	-0,10	0,21	207,87
18,00	116,00	-0,04	0,00	0,04	179,46	-0,24	-0,03	0,24	187,97
18,50	115,50	-0,02	0,00	0,02	188,43	-0,20	-0,03	0,21	189,54
19,00	115,00	-0,05	0,05	0,07	136,31	-0,18	-0,03	0,19	189,65
19,50	114,50	0,00	0,10	0,10	90,62	-0,13	-0,08	0,16	210,10
20,00	114,00	-0,01	0,01	0,01	125,00	-0,13	-0,18	0,22	233,43
20,50	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,19	0,23	235,56
21,00	113,00	0,00	-0,01	0,01	286,57	-0,13	-0,19	0,23	235,56
21,50	112,50	0,00	-0,02	0,02	260,00	-0,13	-0,17	0,22	232,70
22,00	112,00	-0,03	-0,02	0,04	215,00	-0,13	-0,15	0,20	230,26
22,50	111,50	-0,06	-0,01	0,07	186,70	-0,10	-0,13	0,17	233,43
23,00	111,00	0,04	-0,02	0,05	334,05	-0,04	-0,13	0,13	254,56
23,50	110,50	-0,04	-0,07	0,08	237,38	-0,08	-0,11	0,13	234,65
24,00	110,00	0,01	-0,03	0,03	286,57	-0,03	-0,04	0,05	230,26
24,50	109,50	-0,04	-0,01	0,04	196,57	-0,04	-0,01	0,04	196,57

Misura inclinometrica del 14/05/2018 00:00

Data/Ora: 14/05/2018 00:00:00	Sequenza Letture: A1A3B1B3
ID Sonda (serial number): S091260	Sensibilità sonda [sin α]: 20000
Ch A convenzione: -1	Ch B convenzione: -1
Profondità 1.a lettura [m]: 0,50	Intervallo letture [m]: 0,50
Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 10/06/2015 00:00	

Elaborazione dati - misura del 14/05/2018 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	133,50	0,07	-0,22	0,23	287,98	-0,15	-0,18	0,23	230,64
1,00	133,00	0,25	0,24	0,34	43,13	-0,22	0,04	0,22	170,00
1,50	132,50	-0,01	0,03	0,04	110,96	-0,47	-0,20	0,51	202,91
2,00	132,00	0,04	-0,08	0,09	296,03	-0,45	-0,23	0,51	207,01
2,50	131,50	0,23	-0,02	0,23	356,17	-0,49	-0,15	0,51	197,50
3,00	131,00	0,03	0,01	0,03	11,80	-0,72	-0,14	0,74	190,90
3,50	130,50	0,03	0,02	0,04	35,00	-0,76	-0,15	0,77	190,94
4,00	130,00	-0,11	-0,15	0,18	233,43	-0,78	-0,17	0,80	191,97
4,50	129,50	-0,01	-0,02	0,03	245,96	-0,68	-0,02	0,68	181,73
5,00	129,00	-0,08	0,03	0,09	157,91	-0,67	0,00	0,67	179,73
5,50	128,50	0,03	-0,02	0,03	328,20	-0,58	-0,03	0,58	182,99
6,00	128,00	0,04	-0,02	0,05	334,05	-0,61	-0,01	0,61	181,20
6,50	127,50	0,01	0,00	0,01	350,00	-0,65	0,01	0,65	179,37
7,00	127,00	0,08	0,12	0,14	56,80	-0,66	0,01	0,66	179,28
7,50	126,50	-0,04	-0,02	0,05	203,69	-0,74	-0,11	0,75	188,59
8,00	126,00	0,00	-0,09	0,09	267,59	-0,70	-0,09	0,70	187,63
8,50	125,50	-0,02	-0,02	0,02	226,31	-0,69	0,00	0,69	179,89
9,00	125,00	-0,01	-0,01	0,02	215,00	-0,68	0,02	0,68	178,50
9,50	124,50	-0,01	-0,03	0,03	248,69	-0,66	0,03	0,66	177,59
10,00	124,00	0,09	-0,10	0,14	310,53	-0,65	0,06	0,65	174,95
10,50	123,50	-0,03	0,01	0,03	170,00	-0,74	0,16	0,76	167,63
11,00	123,00	0,00	0,01	0,01	80,00	-0,71	0,16	0,73	167,53
11,50	122,50	-0,04	-0,03	0,05	215,00	-0,71	0,15	0,73	168,03
12,00	122,00	0,00	-0,02	0,02	260,00	-0,67	0,18	0,69	164,81
12,50	121,50	0,02	-0,05	0,06	292,01	-0,66	0,20	0,69	163,26
13,00	121,00	-0,06	0,04	0,07	150,02	-0,69	0,25	0,73	159,65
13,50	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,62	0,22	0,66	160,72
14,00	120,00	0,05	0,04	0,06	35,00	-0,62	0,22	0,66	160,72
14,50	119,50	0,04	0,02	0,05	29,81	-0,67	0,18	0,70	164,85
15,00	119,00	0,03	0,04	0,05	50,26	-0,71	0,16	0,73	167,55
15,50	118,50	-0,02	0,00	0,02	170,00	-0,75	0,12	0,76	170,95
16,00	118,00	0,01	-0,12	0,12	275,52	-0,73	0,12	0,74	170,97
16,50	117,50	-0,05	0,07	0,09	125,00	-0,74	0,23	0,78	162,59
17,00	117,00	-0,03	0,02	0,04	143,43	-0,69	0,16	0,71	166,96
17,50	116,50	0,01	-0,02	0,02	293,69	-0,66	0,13	0,67	168,39
18,00	116,00	-0,05	-0,01	0,05	190,56	-0,66	0,16	0,68	166,85
18,50	115,50	-0,01	-0,03	0,03	248,69	-0,61	0,17	0,63	164,91
19,00	115,00	-0,07	0,02	0,07	159,70	-0,60	0,19	0,63	162,03
19,50	114,50	-0,13	0,25	0,28	116,87	-0,53	0,17	0,56	162,32
20,00	114,00	-0,02	0,02	0,03	125,00	-0,41	-0,08	0,42	191,16
20,50	113,50	-0,03	0,03	0,05	136,31	-0,39	-0,10	0,41	194,59
21,00	113,00	-0,01	-0,02	0,03	245,96	-0,36	-0,13	0,38	200,32
21,50	112,50	-0,02	0,01	0,03	155,96	-0,35	-0,11	0,37	197,44
22,00	112,00	-0,03	-0,04	0,06	233,43	-0,33	-0,12	0,35	200,26
22,50	111,50	-0,06	0,00	0,06	175,71	-0,29	-0,08	0,30	194,44
23,00	111,00	0,00	0,01	0,01	106,57	-0,23	-0,08	0,24	199,20
23,50	110,50	-0,02	-0,02	0,03	223,13	-0,23	-0,09	0,24	202,47
24,00	110,00	-0,03	-0,08	0,09	251,87	-0,20	-0,07	0,22	199,54
24,50	109,50	-0,18	0,01	0,18	176,12	-0,18	0,01	0,18	176,12

Misura inclinometrica del 05/06/2019 00:00

Data/Ora: 05/06/2019 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S091260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 10/06/2015 00:00

Elaborazione dati - misura del 05/06/2019 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	133,50	-0,06	-0,29	0,30	258,81	0,08	1,90	1,90	87,54
1,00	133,00	0,08	0,14	0,16	59,44	0,14	2,20	2,20	86,36
1,50	132,50	-0,05	0,04	0,06	140,95	0,06	2,06	2,06	88,38
2,00	132,00	0,04	0,01	0,04	16,57	0,11	2,02	2,02	86,93
2,50	131,50	0,00	0,03	0,03	94,04	0,07	2,01	2,01	88,05
3,00	131,00	0,00	0,04	0,04	89,46	0,07	1,98	1,98	87,98
3,50	130,50	0,02	0,05	0,05	65,96	0,07	1,94	1,94	87,95
4,00	130,00	-0,13	-0,10	0,16	219,64	0,05	1,90	1,90	88,53
4,50	129,50	0,00	0,01	0,01	106,57	0,17	2,00	2,01	85,00
5,00	129,00	0,02	0,04	0,05	64,05	0,18	1,99	1,99	84,85
5,50	128,50	-0,02	-0,01	0,02	203,69	0,16	1,95	1,95	85,33
6,00	128,00	0,03	0,06	0,07	63,30	0,18	1,95	1,96	84,75
6,50	127,50	0,04	0,07	0,08	57,38	0,15	1,90	1,90	85,47
7,00	127,00	0,08	0,13	0,15	58,63	0,11	1,83	1,83	86,66
7,50	126,50	-0,04	0,01	0,04	170,00	0,03	1,70	1,70	89,12
8,00	126,00	0,02	-0,01	0,03	335,96	0,06	1,69	1,69	87,86
8,50	125,50	0,01	0,03	0,03	80,00	0,04	1,70	1,70	88,67
9,00	125,00	0,02	0,03	0,04	61,57	0,03	1,67	1,67	88,83
9,50	124,50	-0,01	0,06	0,06	98,43	0,02	1,63	1,63	89,46
10,00	124,00	0,10	-0,02	0,11	350,00	0,02	1,58	1,58	89,13
10,50	123,50	-0,02	0,04	0,05	119,81	-0,08	1,59	1,60	92,89
11,00	123,00	-0,01	0,06	0,06	103,96	-0,06	1,55	1,55	92,08
11,50	122,50	-0,03	0,03	0,05	136,31	-0,04	1,49	1,49	91,59
12,00	122,00	0,02	0,05	0,06	67,47	-0,01	1,46	1,46	90,35
12,50	121,50	0,04	0,02	0,04	28,66	-0,03	1,41	1,41	91,26
13,00	121,00	-0,06	0,10	0,12	122,88	-0,07	1,39	1,39	92,72
13,50	120,50	0,01	0,04	0,04	80,00	0,00	1,29	1,29	90,06
14,00	120,00	0,07	0,13	0,15	63,07	-0,01	1,25	1,25	90,36
14,50	119,50	0,06	0,12	0,14	64,05	-0,08	1,12	1,12	93,88
15,00	119,00	0,06	0,06	0,09	43,97	-0,14	0,99	1,00	97,76
15,50	118,50	0,03	-0,01	0,03	350,00	-0,20	0,94	0,96	101,87
16,00	118,00	0,03	-0,07	0,08	294,99	-0,23	0,94	0,97	103,59
16,50	117,50	-0,04	0,12	0,13	109,05	-0,26	1,01	1,04	104,42
17,00	117,00	0,00	0,06	0,06	92,53	-0,22	0,89	0,92	103,76
17,50	116,50	0,02	0,05	0,06	67,47	-0,22	0,83	0,86	104,51
18,00	116,00	0,00	0,05	0,05	95,95	-0,24	0,78	0,81	106,96
18,50	115,50	0,00	0,03	0,03	91,31	-0,23	0,73	0,77	107,61
19,00	115,00	-0,04	0,12	0,13	106,57	-0,23	0,70	0,74	108,30
19,50	114,50	-0,09	0,27	0,28	107,70	-0,20	0,58	0,61	108,66
20,00	114,00	0,00	0,04	0,04	88,13	-0,11	0,31	0,33	109,48
20,50	113,50	0,00	0,05	0,05	94,04	-0,11	0,27	0,29	112,66
21,00	113,00	0,02	0,02	0,03	43,13	-0,11	0,22	0,24	116,57
21,50	112,50	0,00	0,06	0,06	92,53	-0,13	0,19	0,23	123,92
22,00	112,00	-0,02	0,02	0,03	143,43	-0,13	0,14	0,19	133,13
22,50	111,50	-0,05	0,03	0,05	149,44	-0,11	0,12	0,16	131,34
23,00	111,00	0,03	0,05	0,05	59,44	-0,06	0,09	0,11	122,71
23,50	110,50	-0,05	0,00	0,05	185,95	-0,09	0,05	0,10	151,57
24,00	110,00	0,00	0,02	0,02	80,00	-0,04	0,05	0,07	128,81
24,50	109,50	-0,05	0,03	0,05	149,44	-0,05	0,03	0,05	149,44

Misura inclinometrica del 15/06/2023 00:00

Data/Ora: 15/06/2023 00:00:00 Sequenza Letture: A1A3B1B3
 ID Sonda (serial number): S091260 Sensibilità sonda [sin α]: 20000
 Ch A convenzione: -1 Ch B convenzione: -1
 Profondità 1.a lettura [m]: 0,50 Intervallo letture [m]: 0,50
 Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 10/06/2015 00:00


Elaborazione dati - misura del 15/06/2023 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	133,50	-0,18	-0,11	0,21	211,35	-1,19	-0,65	1,36	208,66
1,00	133,00	0,16	0,01	0,16	3,50	-1,02	-0,54	1,15	208,17
1,50	132,50	-0,09	-0,03	0,09	198,30	-1,18	-0,55	1,30	205,22
2,00	132,00	-0,08	-0,03	0,09	200,26	-1,09	-0,53	1,21	205,74
2,50	131,50	0,00	-0,05	0,05	267,13	-1,01	-0,50	1,12	206,17
3,00	131,00	0,00	0,06	0,06	85,71	-1,00	-0,44	1,10	203,87
3,50	130,50	0,09	0,06	0,11	35,00	-1,01	-0,51	1,13	206,68
4,00	130,00	-0,13	-0,19	0,23	236,19	-1,10	-0,57	1,24	207,39
4,50	129,50	0,00	-0,05	0,05	267,13	-0,97	-0,38	1,04	201,20
5,00	129,00	0,25	-0,04	0,25	351,43	-0,96	-0,32	1,02	198,61
5,50	128,50	-0,01	-0,10	0,10	263,58	-1,21	-0,29	1,25	193,35
6,00	128,00	-0,01	0,00	0,01	170,00	-1,20	-0,19	1,22	188,90
6,50	127,50	0,03	-0,01	0,03	350,00	-1,19	-0,19	1,21	189,00
7,00	127,00	0,02	0,07	0,07	74,81	-1,23	-0,18	1,24	188,53
7,50	126,50	-0,07	-0,10	0,12	236,04	-1,24	-0,25	1,27	191,38
8,00	126,00	0,03	-0,10	0,11	288,07	-1,17	-0,15	1,18	187,19
8,50	125,50	-0,02	-0,03	0,03	238,20	-1,21	-0,05	1,21	182,24
9,00	125,00	0,02	0,03	0,04	61,57	-1,19	-0,02	1,19	180,90
9,50	124,50	0,01	-0,06	0,06	278,43	-1,21	-0,05	1,21	182,53
10,00	124,00	0,09	-0,10	0,14	310,53	-1,22	0,01	1,22	179,75
10,50	123,50	0,02	0,00	0,02	350,00	-1,31	0,11	1,31	175,19
11,00	123,00	0,03	0,00	0,03	4,04	-1,33	0,11	1,33	175,12
11,50	122,50	-0,03	0,03	0,05	136,31	-1,35	0,11	1,36	175,29
12,00	122,00	0,01	-0,02	0,02	293,69	-1,32	0,08	1,32	176,52
12,50	121,50	0,03	-0,03	0,04	311,34	-1,33	0,10	1,33	175,66
13,00	121,00	-0,87	0,06	0,87	175,75	-1,35	0,13	1,36	174,48
13,50	120,50	0,03	0,08	0,09	71,87	-0,48	0,07	0,49	172,20
14,00	120,00	0,04	-0,05	0,06	305,00	-0,51	-0,02	0,51	182,00
14,50	119,50	0,15	-0,07	0,17	334,93	-0,55	0,03	0,55	176,56
15,00	119,00	0,04	-0,05	0,07	308,81	-0,70	0,10	0,71	171,52
15,50	118,50	0,13	-0,04	0,13	344,56	-0,74	0,16	0,76	168,11
16,00	118,00	-0,04	-0,13	0,14	252,23	-0,87	0,19	0,89	167,58
16,50	117,50	0,11	-0,03	0,11	343,66	-0,83	0,32	0,89	158,61
17,00	117,00	-0,02	0,01	0,03	155,96	-0,93	0,36	1,00	159,18
17,50	116,50	0,04	0,02	0,05	29,81	-0,91	0,34	0,97	159,27
18,00	116,00	-0,17	0,02	0,18	172,05	-0,95	0,32	1,01	161,42
18,50	115,50	-0,01	-0,02	0,02	241,57	-0,78	0,30	0,83	159,20
19,00	115,00	-0,03	0,15	0,15	102,25	-0,77	0,31	0,83	157,85
19,50	114,50	-0,16	0,14	0,21	138,17	-0,74	0,17	0,76	167,16
20,00	114,00	-0,15	0,03	0,16	167,71	-0,58	0,03	0,58	177,43
20,50	113,50	-0,02	0,02	0,03	143,43	-0,43	-0,01	0,43	180,98
21,00	113,00	-0,02	-0,01	0,02	203,69	-0,40	-0,02	0,40	183,39
21,50	112,50	-0,03	-0,03	0,04	221,34	-0,38	-0,01	0,38	182,23
22,00	112,00	-0,07	-0,03	0,07	200,96	-0,35	0,01	0,35	178,13
22,50	111,50	-0,12	-0,09	0,15	216,74	-0,29	0,04	0,29	172,49
23,00	111,00	0,03	-0,03	0,04	311,34	-0,17	0,12	0,21	143,43
23,50	110,50	0,00	0,03	0,03	94,04	-0,19	0,15	0,25	141,50
24,00	110,00	0,01	-0,03	0,03	286,57	-0,19	0,13	0,23	146,19
24,50	109,50	-0,20	0,16	0,25	142,18	-0,20	0,16	0,25	142,18

Misura inclinometrica del 22/07/2024 00:00


Data/Ora: 22/07/2024 00:00:00 Sequenza Letture: A1A3B1B3
 ID Sonda (serial number): S091260 Sensibilità sonda [sin α]: 20000
 Ch A convenzione: -1 Ch B convenzione: -1
 Profondità 1.a lettura [m]: 0,5 Intervallo letture [m]: 0,50
 Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 10/06/2015 00:00

Elaborazione dati - misura del 22/07/2024 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	133,50	-0,06	-0,73	0,73	265,42	-0,52	-2,71	2,76	259,22
1,00	133,00	0,05	-0,14	0,14	288,81	-0,46	-1,99	2,04	257,01
1,50	132,50	-0,11	-0,09	0,14	218,58	-0,50	-1,85	1,92	254,77
2,00	132,00	0,05	-0,09	0,10	297,57	-0,39	-1,76	1,81	257,42
2,50	131,50	-0,02	-0,06	0,06	254,29	-0,44	-1,67	1,73	255,24
3,00	131,00	0,01	-0,04	0,04	286,57	-0,42	-1,61	1,67	255,27
3,50	130,50	0,03	-0,02	0,04	331,57	-0,44	-1,57	1,63	254,51
4,00	130,00	-0,11	-0,18	0,22	237,89	-0,47	-1,55	1,62	253,15
4,50	129,50	-0,01	-0,07	0,08	264,76	-0,36	-1,37	1,42	255,45
5,00	129,00	0,02	-0,02	0,03	313,13	-0,35	-1,30	1,34	254,93
5,50	128,50	0,01	-0,12	0,12	275,52	-0,37	-1,27	1,33	253,78
6,00	128,00	0,05	-0,05	0,07	316,31	-0,38	-1,16	1,22	251,75
6,50	127,50	0,05	-0,05	0,07	316,31	-0,43	-1,11	1,19	248,81
7,00	127,00	0,03	0,06	0,07	64,74	-0,48	-1,06	1,17	245,74
7,50	126,50	-0,03	-0,12	0,13	254,29	-0,51	-1,13	1,24	245,68
8,00	126,00	0,00	-0,13	0,13	270,78	-0,48	-1,01	1,11	244,72
8,50	125,50	-0,01	-0,06	0,06	260,00	-0,48	-0,87	1,00	241,34
9,00	125,00	0,05	0,07	0,08	53,43	-0,47	-0,82	0,94	240,24
9,50	124,50	-0,01	-0,04	0,04	251,87	-0,52	-0,89	1,03	239,69
10,00	124,00	0,08	-0,09	0,12	311,34	-0,50	-0,84	0,98	239,15
10,50	123,50	-0,04	-0,02	0,04	208,66	-0,58	-0,75	0,95	232,26
11,00	123,00	0,05	-0,01	0,05	342,87	-0,55	-0,73	0,92	233,26
11,50	122,50	0,00	-0,01	0,01	260,00	-0,60	-0,72	0,93	230,35
12,00	122,00	0,01	-0,01	0,01	323,43	-0,59	-0,71	0,92	229,97
12,50	121,50	0,03	-0,06	0,07	301,19	-0,61	-0,70	0,93	229,10
13,00	121,00	-0,08	0,04	0,09	152,90	-0,64	-0,64	0,91	225,11
13,50	120,50	0,01	-0,01	0,02	305,00	-0,56	-0,68	0,88	230,36
14,00	120,00	0,06	-0,11	0,12	300,91	-0,57	-0,67	0,88	229,25
14,50	119,50	0,05	-0,10	0,11	293,69	-0,64	-0,56	0,85	221,27
15,00	119,00	0,05	-0,08	0,09	302,27	-0,68	-0,46	0,82	213,77
15,50	118,50	0,07	0,02	0,08	18,61	-0,73	-0,38	0,83	207,30
16,00	118,00	0,03	-0,15	0,15	282,25	-0,81	-0,40	0,90	206,55
16,50	117,50	-0,11	0,11	0,15	135,01	-0,84	-0,26	0,88	197,11
17,00	117,00	-0,03	0,00	0,03	184,04	-0,73	-0,37	0,82	206,61
17,50	116,50	0,01	-0,01	0,01	323,43	-0,71	-0,36	0,79	207,32
18,00	116,00	0,01	-0,03	0,03	281,80	-0,72	-0,36	0,80	206,42
18,50	115,50	0,00	-0,03	0,03	271,31	-0,72	-0,32	0,79	204,07
19,00	115,00	-0,05	0,02	0,06	157,47	-0,72	-0,29	0,78	201,91
19,50	114,50	-0,14	0,20	0,24	123,96	-0,67	-0,31	0,74	205,03
20,00	114,00	-0,03	0,01	0,03	158,69	-0,54	-0,51	0,74	223,90
20,50	113,50	-0,05	0,01	0,05	170,00	-0,51	-0,53	0,73	226,17
21,00	113,00	-0,01	-0,07	0,08	264,76	-0,46	-0,54	0,70	229,56
21,50	112,50	-0,02	-0,04	0,05	244,05	-0,45	-0,46	0,64	225,69
22,00	112,00	-0,04	-0,07	0,08	241,57	-0,43	-0,42	0,60	224,32
22,50	111,50	-0,09	-0,05	0,10	212,51	-0,39	-0,35	0,53	221,77
23,00	111,00	-0,02	-0,03	0,04	233,43	-0,31	-0,30	0,43	223,97
23,50	110,50	-0,06	-0,01	0,06	193,96	-0,28	-0,26	0,38	222,94
24,00	110,00	0,00	-0,08	0,08	269,46	-0,22	-0,25	0,33	228,11
24,50	109,50	-0,22	-0,17	0,28	217,73	-0,22	-0,17	0,28	217,73

Spostamento Nord [mm]


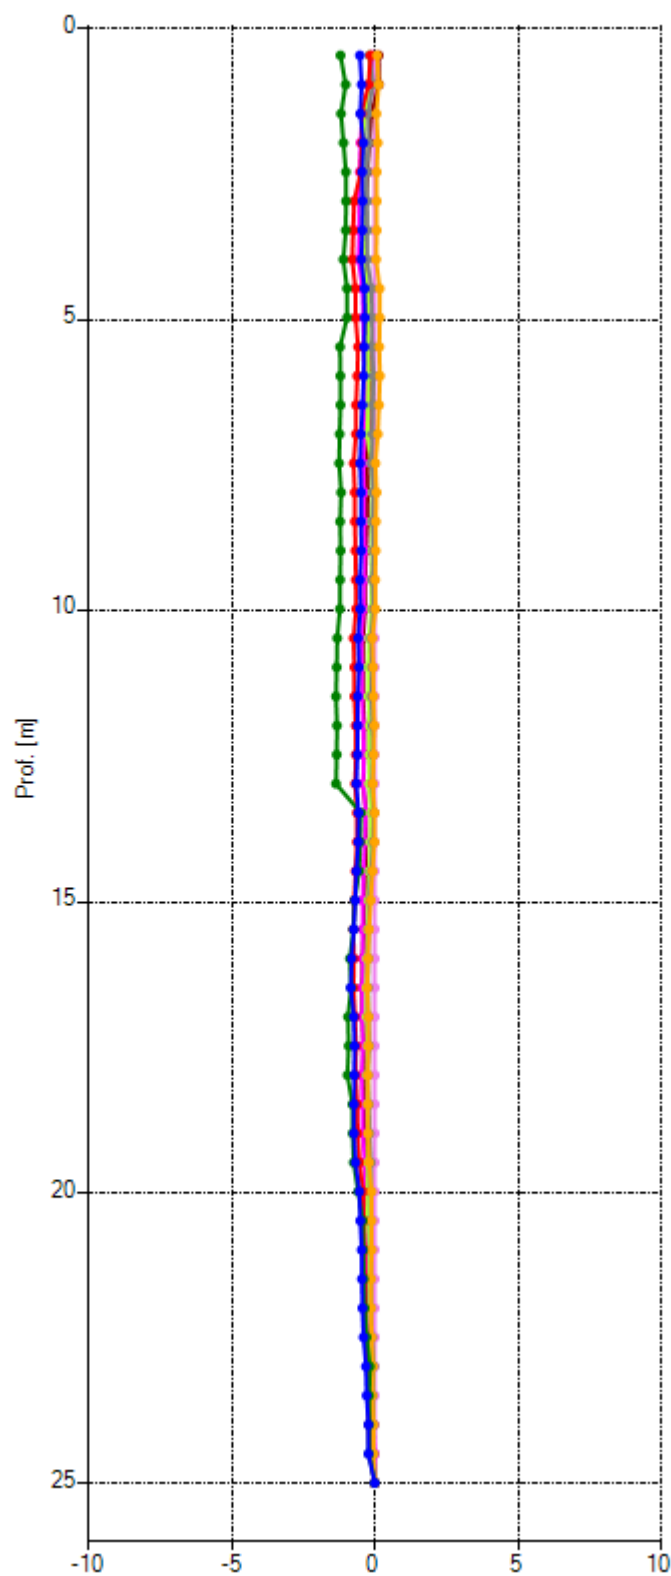


Spostamento Est [mm]

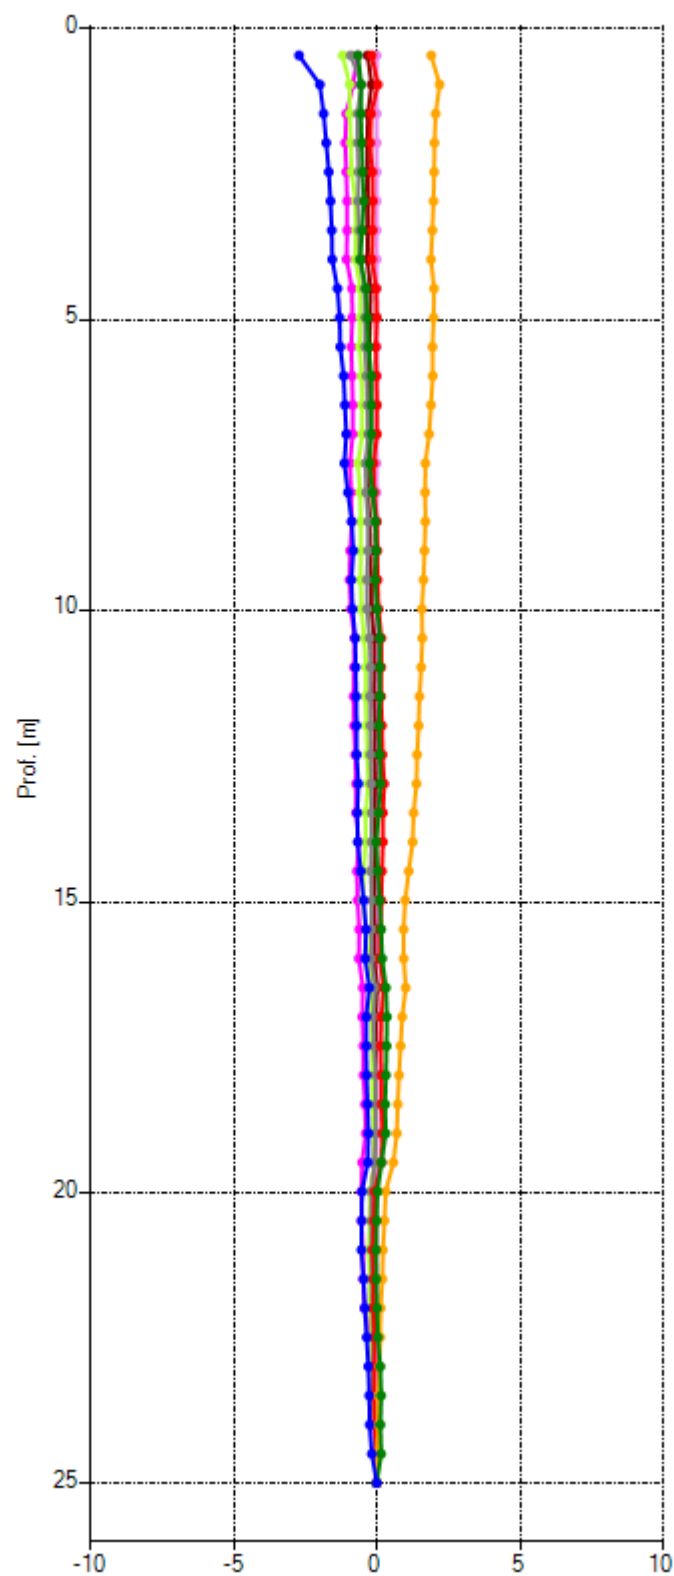

■ 22/07/2024 00:00:00 ■ 15/06/2023 00:00:00 ■ 05/06/2019 00:00:00 ■ 14/05/2018 00:00:00 ■ 08/06/2017 00:00:00
 ■ 08/09/2016 00:00:00 ■ 11/04/2016 00:00:00 ■ 15/09/2015 00:00:00 ■ 10/06/2015 00:00:00

Misura inclinometrica di riferimento 10/06/2015 00:00

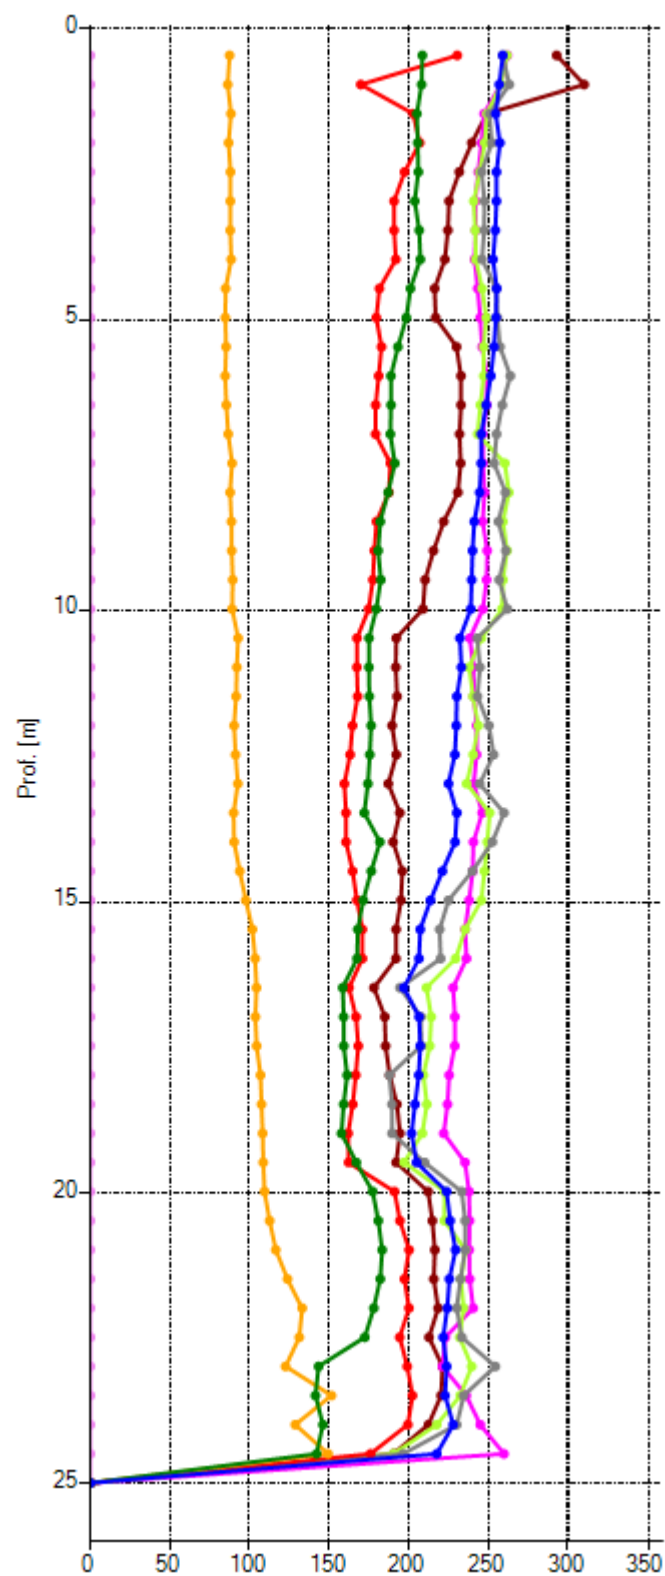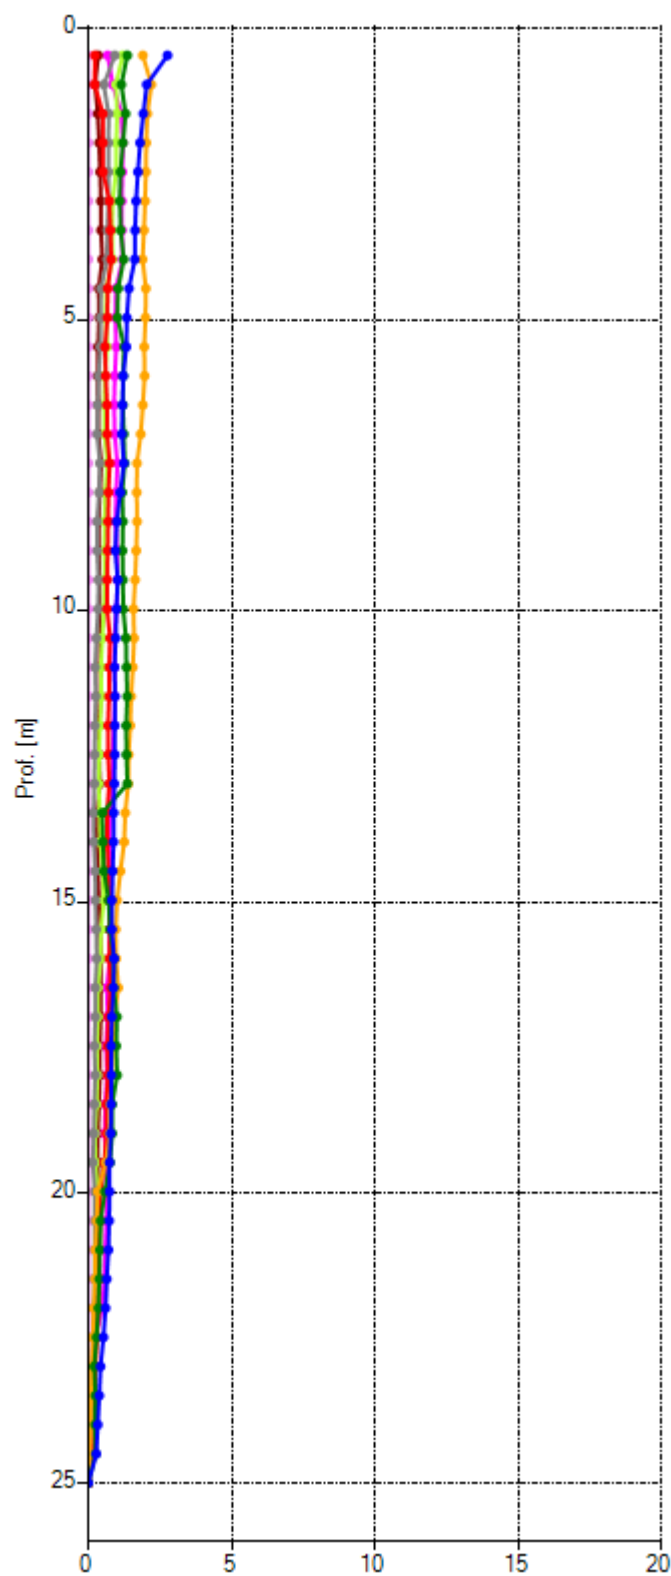


22/07/2024 00:00:00 15/06/2023 00:00:00 05/06/2019 00:00:00 14/05/2018 00:00:00 08/06/2017 00:00:00
 08/09/2016 00:00:00 11/04/2016 00:00:00 15/09/2015 00:00:00 10/06/2015 00:00:00


Misura inclinometrica di riferimento 10/06/2015 00:00

Deformazione nel tempo


Nord

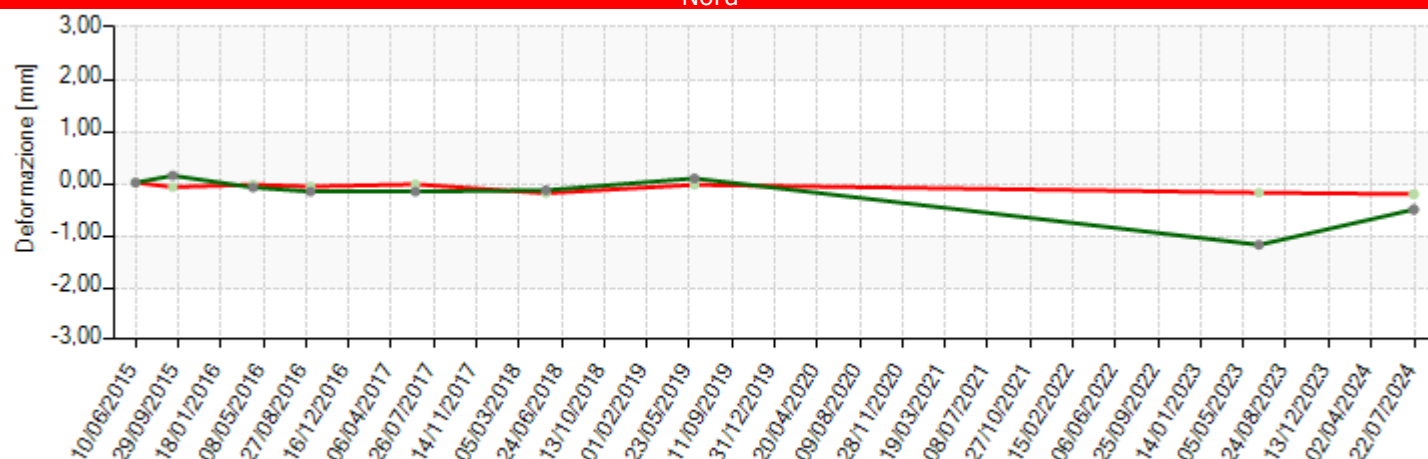

Est

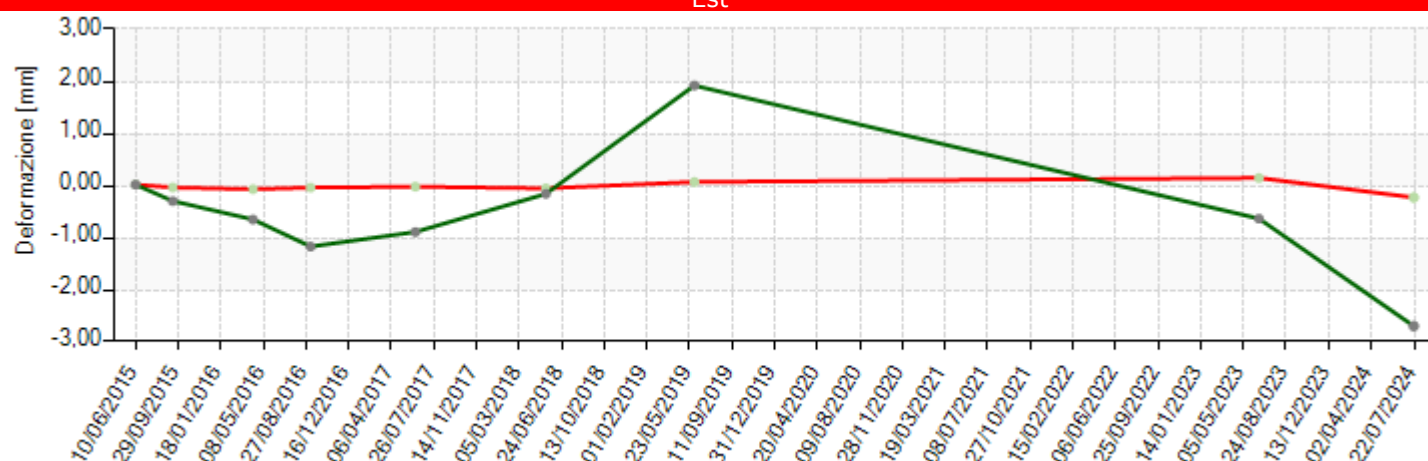

Risultante

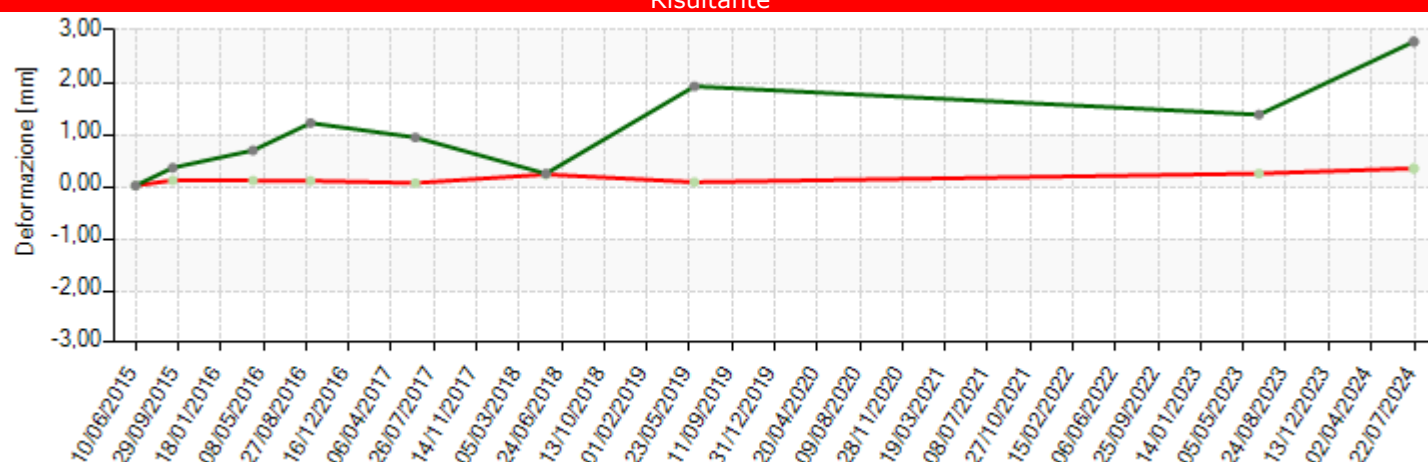

Prof.: ■ 0,50 (133,50) [m] ■ 24,00 (110,00) [m]

