



KLION Report

Proprietà Sito

Sito: GE027_Biscaccia

Attuatore: Comune di Mele

Proprietà Tubo

Nome: RM511_S3

Azimuth [°]: 15,00

Orientamento: VERTICALE

Latitudine: 44,457304


Longitudine: 8,750416

Altitudine [m s.l.m.]: 141

Sporgenza dal Suolo [m]: 0

Posizione

Orientamento

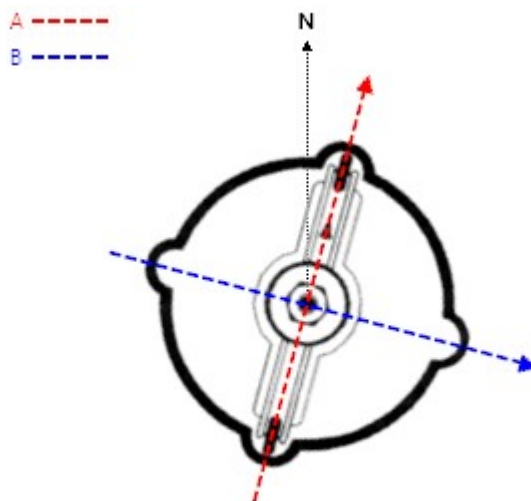

Azimuth [°]: 15,00

Opzioni di elaborazione inclinometrica

Riferimento al fondo: Sì

Compensazione spiralometrica: No

Relativo - variazione dalla misura di riferimento

Curva cumulata

Correzione Bias Shift: No

Misura inclinometrica del 10/06/2015 00:00

Data/Ora: 10/06/2015 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3A2A4B2B4

ID Sonda (serial number): S091260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: 10/06/2015 00:00

Spostamenti rispetto alla verticale

Prof [m]	Nord [mm]	Est [mm]
0,50	-2,94	-2,48
1,00	-4,23	-0,10
1,50	-4,29	-0,54
2,00	-4,14	-0,62
2,50	-4,18	-1,21
3,00	-3,48	-2,15
3,50	-3,52	-2,51
4,00	-3,46	-2,58
4,50	-3,67	-2,28
5,00	-3,72	-2,50
5,50	-3,33	-2,74
6,00	-3,15	-2,73
6,50	-3,46	-2,16
7,00	-3,80	-1,94
7,50	-3,43	-1,22
8,00	-3,63	-0,88
8,50	-3,24	-0,65
9,00	-2,56	-0,22
9,50	-1,73	0,14
10,00	-1,54	0,14
10,50	-2,96	-0,53
11,00	-5,26	-1,40
11,50	-5,10	-1,52
12,00	-5,17	-1,49
12,50	-5,09	-1,25
13,00	-4,85	-0,99
13,50	-4,04	-0,47
14,00	-3,46	-0,19
14,50	-3,57	-0,25
15,00	-3,91	-0,49
15,50	-3,62	-1,37
16,00	-3,70	-2,38
16,50	-3,42	-3,18
17,00	-2,37	-2,93
17,50	-3,36	-2,21
18,00	-4,61	-1,25
18,50	-5,04	-2,06
19,00	-5,63	-1,40
19,50	-6,00	-0,15
20,00	-5,97	-1,20
20,50	-6,13	-0,70
21,00	-3,98	-1,14
21,50	-2,74	-0,60
22,00	-2,21	-0,41
22,50	-1,40	-0,47
23,00	-1,50	0,06
23,50	-1,34	0,24
24,00	-1,22	0,18
24,50	-1,67	0,21
25,00	-1,70	0,70

Misura inclinometrica del 15/09/2015 00:00

Data/Ora: 15/09/2015 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S091260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 10/06/2015 00:00

Elaborazione dati - misura del 15/09/2015 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	140,50	-0,08	0,15	0,17	117,99	-0,41	-0,24	0,48	210,12
1,00	140,00	-0,01	0,02	0,03	105,00	-0,34	-0,39	0,51	229,08
1,50	139,50	-0,02	0,07	0,07	105,00	-0,33	-0,41	0,53	231,33
2,00	139,00	0,00	-0,01	0,01	285,00	-0,31	-0,48	0,58	237,36
2,50	138,50	-0,01	0,17	0,17	92,01	-0,31	-0,47	0,57	236,42
3,00	138,00	-0,03	-0,07	0,08	246,34	-0,31	-0,64	0,71	244,29
3,50	137,50	0,00	-0,13	0,13	268,30	-0,28	-0,57	0,63	244,03
4,00	137,00	-0,04	-0,06	0,07	240,00	-0,27	-0,44	0,51	238,03
4,50	136,50	0,01	-0,05	0,05	285,00	-0,24	-0,37	0,44	237,71
5,00	136,00	-0,03	0,06	0,06	116,31	-0,25	-0,33	0,41	232,57
5,50	135,50	0,01	0,03	0,03	78,43	-0,22	-0,38	0,44	240,00
6,00	135,00	-0,04	-0,05	0,06	231,87	-0,23	-0,41	0,47	241,08
6,50	134,50	-0,03	-0,02	0,04	213,43	-0,19	-0,36	0,41	242,49
7,00	134,00	-0,02	-0,20	0,20	263,20	-0,15	-0,34	0,37	245,44
7,50	133,50	-0,11	0,01	0,11	174,44	-0,13	-0,14	0,19	226,61
8,00	133,00	0,01	-0,04	0,04	285,00	-0,02	-0,15	0,15	260,56
8,50	132,50	-0,01	-0,07	0,07	263,20	-0,03	-0,11	0,12	252,99
9,00	132,00	0,00	-0,05	0,05	270,96	-0,03	-0,05	0,05	240,00
9,50	131,50	-0,05	-0,05	0,07	225,96	-0,03	0,01	0,03	168,43
10,00	131,00	0,03	-0,03	0,05	318,69	0,02	0,06	0,06	68,13
10,50	130,50	0,03	0,02	0,04	33,43	-0,01	0,09	0,09	96,87
11,00	130,00	0,03	-0,01	0,03	348,43	-0,04	0,07	0,08	123,43
11,50	129,50	-0,01	0,00	0,01	195,00	-0,07	0,07	0,10	134,74
12,00	129,00	0,02	-0,07	0,07	285,00	-0,06	0,07	0,10	128,20
12,50	128,50	-0,01	0,00	0,01	195,00	-0,08	0,15	0,17	117,99
13,00	128,00	0,05	0,01	0,05	15,00	-0,07	0,15	0,16	113,75
13,50	127,50	-0,03	0,02	0,04	150,00	-0,11	0,14	0,18	129,78
14,00	127,00	0,01	-0,02	0,03	285,00	-0,08	0,12	0,15	124,98
14,50	126,50	-0,06	0,02	0,06	158,13	-0,09	0,14	0,17	122,10
15,00	126,00	-0,01	-0,02	0,02	240,00	-0,03	0,12	0,12	105,00
15,50	125,50	-0,02	0,02	0,03	131,57	-0,02	0,14	0,14	99,81
16,00	125,00	-0,12	-0,07	0,14	210,26	0,00	0,12	0,12	92,47
16,50	124,50	-0,05	0,08	0,09	120,95	0,12	0,19	0,22	57,71
17,00	124,00	0,02	0,03	0,04	60,00	0,16	0,11	0,20	33,43
17,50	123,50	0,01	-0,08	0,08	275,54	0,15	0,08	0,17	27,99
18,00	123,00	0,09	-0,04	0,10	335,19	0,14	0,15	0,21	47,74
18,50	122,50	-0,01	0,02	0,02	105,00	0,05	0,19	0,20	75,26
19,00	122,00	0,06	0,00	0,06	3,69	0,06	0,17	0,18	71,31
19,50	121,50	0,03	0,10	0,10	75,26	-0,01	0,17	0,17	92,01
20,00	121,00	0,02	-0,03	0,04	303,43	-0,03	0,07	0,08	114,46
20,50	120,50	-0,01	-0,03	0,03	258,43	-0,05	0,10	0,12	117,53
21,00	120,00	0,02	0,08	0,08	78,43	-0,05	0,13	0,14	110,19
21,50	119,50	-0,06	0,06	0,08	131,57	-0,06	0,05	0,08	143,66
22,00	119,00	-0,05	0,08	0,09	120,95	-0,01	-0,02	0,02	240,00
22,50	118,50	0,01	0,00	0,01	15,00	0,04	-0,09	0,10	292,13
23,00	118,00	0,02	0,01	0,03	15,00	0,03	-0,10	0,10	285,00
23,50	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,10	270,96
24,00	117,00	0,00	-0,01	0,01	285,00	0,00	-0,10	0,10	270,96
24,50	116,50	0,00	-0,05	0,05	270,96	0,00	-0,09	0,09	269,05
25,00	116,00	0,00	-0,04	0,04	266,57	0,00	-0,04	0,04	266,57

Misura inclinometrica del 11/04/2016 00:00

Data/Ora: 11/04/2016 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S091260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 10/06/2015 00:00

Elaborazione dati - misura del 11/04/2016 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	140,50	-0,16	0,01	0,16	176,57	-0,96	0,49	1,08	152,82
1,00	140,00	-0,03	-0,09	0,09	251,31	-0,80	0,48	0,94	148,92
1,50	139,50	-0,10	-0,01	0,10	187,87	-0,77	0,57	0,96	143,66
2,00	139,00	-0,02	0,06	0,06	105,00	-0,67	0,58	0,89	139,14
2,50	138,50	-0,13	0,16	0,21	130,02	-0,66	0,52	0,84	141,53
3,00	138,00	0,02	-0,01	0,02	330,00	-0,52	0,36	0,64	145,24
3,50	137,50	0,02	-0,02	0,03	311,57	-0,54	0,37	0,66	145,36
4,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,39	0,68	144,81
4,50	136,50	0,02	-0,01	0,02	330,00	-0,56	0,39	0,68	144,81
5,00	136,00	-0,01	0,02	0,02	105,00	-0,57	0,40	0,70	144,94
5,50	135,50	0,02	-0,01	0,02	330,00	-0,57	0,38	0,68	146,28
6,00	135,00	0,02	-0,02	0,03	311,57	-0,58	0,39	0,70	146,38
6,50	134,50	-0,03	0,02	0,04	150,00	-0,60	0,41	0,73	145,82
7,00	134,00	-0,01	-0,02	0,02	240,00	-0,57	0,39	0,69	145,60
7,50	133,50	0,02	-0,03	0,04	303,43	-0,56	0,41	0,69	144,14
8,00	133,00	0,01	-0,05	0,05	285,00	-0,58	0,44	0,73	143,05
8,50	132,50	-0,04	0,01	0,05	161,31	-0,60	0,49	0,77	140,75
9,00	132,00	-0,02	0,02	0,03	131,57	-0,55	0,47	0,73	139,51
9,50	131,50	-0,03	0,03	0,05	138,69	-0,54	0,45	0,70	139,82
10,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,42	0,66	139,90
10,50	130,50	-0,03	-0,02	0,04	213,43	-0,50	0,42	0,66	139,90
11,00	130,00	0,03	-0,03	0,05	318,69	-0,47	0,44	0,65	136,53
11,50	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,47	0,69	136,68
12,00	129,00	0,01	-0,04	0,04	285,00	-0,50	0,47	0,69	136,68
12,50	128,50	0,00	0,04	0,04	86,57	-0,51	0,51	0,72	135,11
13,00	128,00	-0,02	0,01	0,02	150,00	-0,51	0,47	0,70	137,55
13,50	127,50	-0,09	0,03	0,09	161,31	-0,50	0,46	0,68	137,23
14,00	127,00	-0,01	0,00	0,01	195,00	-0,41	0,43	0,60	133,71
14,50	126,50	-0,07	0,03	0,08	156,34	-0,40	0,44	0,59	132,65
15,00	126,00	-0,01	0,04	0,04	105,00	-0,33	0,40	0,52	129,10
15,50	125,50	0,01	0,05	0,06	78,43	-0,32	0,37	0,49	130,91
16,00	125,00	0,02	0,03	0,04	60,00	-0,33	0,31	0,45	136,50
16,50	124,50	0,04	0,09	0,10	65,19	-0,35	0,28	0,45	140,91
17,00	124,00	0,01	0,09	0,10	81,80	-0,39	0,19	0,43	153,50
17,50	123,50	-0,11	0,06	0,12	150,00	-0,40	0,10	0,41	166,11
18,00	123,00	-0,04	0,05	0,07	126,80	-0,29	0,04	0,30	172,75
18,50	122,50	0,01	0,02	0,02	60,00	-0,25	-0,02	0,25	183,69
19,00	122,00	-0,04	0,04	0,06	131,57	-0,26	-0,03	0,27	186,87
19,50	121,50	0,07	-0,07	0,10	314,74	-0,23	-0,07	0,24	198,01
20,00	121,00	-0,05	0,01	0,06	168,43	-0,30	0,00	0,30	180,38
20,50	120,50	-0,13	0,02	0,13	173,20	-0,24	-0,01	0,24	183,11
21,00	120,00	0,08	0,07	0,11	41,57	-0,11	-0,03	0,11	195,00
21,50	119,50	-0,06	0,05	0,08	143,66	-0,19	-0,10	0,22	208,24
22,00	119,00	-0,03	0,02	0,04	150,00	-0,13	-0,15	0,20	229,70
22,50	118,50	0,00	0,01	0,01	105,00	-0,10	-0,17	0,19	240,00
23,00	118,00	-0,02	-0,03	0,04	240,00	-0,09	-0,18	0,20	242,49
23,50	117,50	-0,07	-0,02	0,08	195,00	-0,08	-0,15	0,17	243,01
24,00	117,00	-0,01	-0,07	0,07	263,20	0,00	-0,13	0,13	268,30
24,50	116,50	0,03	-0,03	0,05	318,69	0,00	-0,06	0,06	273,69
25,00	116,00	-0,03	-0,03	0,05	228,69	-0,03	-0,03	0,05	228,69

Misura inclinometrica del 08/09/2016 00:00

Data/Ora: 08/09/2016 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S091260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 10/06/2015 00:00

Elaborazione dati - misura del 08/09/2016 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	140,50	0,18	-0,22	0,29	308,20	-0,78	0,13	0,79	170,85
1,00	140,00	0,01	0,20	0,20	86,57	-0,96	0,35	1,02	159,95
1,50	139,50	-0,04	0,26	0,26	99,56	-0,97	0,15	0,98	171,04
2,00	139,00	-0,03	0,25	0,25	96,47	-0,93	-0,11	0,94	186,54
2,50	138,50	-0,06	0,24	0,25	105,00	-0,90	-0,36	0,97	201,67
3,00	138,00	-0,05	0,03	0,05	150,00	-0,84	-0,60	1,03	215,64
3,50	137,50	0,00	-0,04	0,04	266,57	-0,79	-0,63	1,01	218,39
4,00	137,00	-0,02	0,01	0,02	150,00	-0,79	-0,59	0,98	216,67
4,50	136,50	-0,03	-0,03	0,05	228,69	-0,77	-0,60	0,98	217,62
5,00	136,00	-0,03	0,01	0,03	168,43	-0,74	-0,56	0,93	217,09
5,50	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72	-0,57	0,91	218,40
6,00	135,00	-0,02	-0,02	0,03	221,57	-0,72	-0,57	0,91	218,40
6,50	134,50	-0,05	-0,03	0,05	209,04	-0,69	-0,55	0,88	218,30
7,00	134,00	0,02	0,02	0,03	41,57	-0,65	-0,52	0,83	218,88
7,50	133,50	0,00	-0,01	0,01	285,00	-0,67	-0,54	0,86	218,96
8,00	133,00	-0,03	-0,05	0,05	240,00	-0,67	-0,53	0,86	218,20
8,50	132,50	-0,07	0,01	0,07	173,20	-0,65	-0,48	0,81	216,80
9,00	132,00	0,00	-0,04	0,04	266,57	-0,58	-0,49	0,76	220,30
9,50	131,50	-0,05	0,04	0,06	141,87	-0,58	-0,45	0,73	218,07
10,00	131,00	-0,01	-0,02	0,02	240,00	-0,53	-0,49	0,72	222,90
10,50	130,50	0,01	0,03	0,03	78,43	-0,52	-0,48	0,70	222,47
11,00	130,00	0,01	-0,02	0,02	285,00	-0,53	-0,50	0,73	223,77
11,50	129,50	0,00	-0,01	0,01	285,00	-0,53	-0,48	0,72	222,01
12,00	129,00	-0,05	-0,06	0,08	233,66	-0,53	-0,47	0,71	221,11
12,50	128,50	-0,02	-0,02	0,03	221,57	-0,49	-0,40	0,63	219,54
13,00	128,00	-0,03	-0,02	0,04	213,43	-0,47	-0,38	0,60	219,44
13,50	127,50	-0,02	-0,03	0,04	240,00	-0,43	-0,36	0,56	219,86
14,00	127,00	0,01	-0,02	0,03	285,00	-0,42	-0,33	0,53	218,55
14,50	126,50	-0,04	0,01	0,05	161,31	-0,42	-0,31	0,52	216,04
15,00	126,00	-0,01	-0,02	0,02	240,00	-0,38	-0,32	0,50	220,28
15,50	125,50	-0,01	0,00	0,01	195,00	-0,37	-0,31	0,48	219,57
16,00	125,00	0,00	0,01	0,01	105,00	-0,36	-0,30	0,47	220,20
16,50	124,50	-0,03	-0,03	0,05	228,69	-0,36	-0,32	0,48	221,57
17,00	124,00	0,00	0,01	0,01	105,00	-0,33	-0,28	0,43	220,82
17,50	123,50	0,00	-0,09	0,09	269,05	-0,32	-0,29	0,44	222,30
18,00	123,00	-0,11	0,06	0,12	150,00	-0,32	-0,20	0,38	212,24
18,50	122,50	0,02	-0,03	0,04	303,43	-0,21	-0,26	0,34	231,03
19,00	122,00	-0,04	0,07	0,08	123,43	-0,24	-0,23	0,33	224,48
19,50	121,50	-0,03	-0,10	0,10	255,26	-0,19	-0,30	0,35	237,14
20,00	121,00	-0,09	-0,15	0,18	240,00	-0,17	-0,20	0,26	230,22
20,50	120,50	-0,05	0,01	0,06	168,43	-0,08	-0,05	0,09	210,95
21,00	120,00	0,01	0,03	0,03	78,43	-0,02	-0,06	0,06	248,13
21,50	119,50	-0,05	-0,03	0,05	209,04	-0,03	-0,09	0,09	251,31
22,00	119,00	-0,02	-0,01	0,03	195,00	0,02	-0,06	0,06	285,00
22,50	118,50	0,01	-0,02	0,02	285,00	0,04	-0,05	0,07	306,80
23,00	118,00	-0,01	-0,02	0,02	240,00	0,03	-0,03	0,05	318,69
23,50	117,50	-0,02	0,01	0,02	150,00	0,04	-0,01	0,05	341,31
24,00	117,00	0,02	0,06	0,06	68,13	0,06	-0,02	0,06	338,13
24,50	116,50	0,04	-0,05	0,07	306,80	0,03	-0,08	0,09	293,13
25,00	116,00	-0,01	-0,03	0,03	258,43	-0,01	-0,03	0,03	258,43

Misura inclinometrica del 08/06/2017 00:00

Data/Ora: 08/06/2017 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S091260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 10/06/2015 00:00

Elaborazione dati - misura del 08/06/2017 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	140,50	-0,08	0,24	0,25	107,86	-1,42	0,50	1,50	160,52
1,00	140,00	-0,04	0,09	0,10	112,13	-1,34	0,26	1,36	168,90
1,50	139,50	-0,16	0,23	0,28	125,85	-1,30	0,17	1,31	172,59
2,00	139,00	-0,08	0,19	0,20	112,13	-1,14	-0,06	1,14	182,95
2,50	138,50	-0,13	0,28	0,30	114,46	-1,06	-0,25	1,09	193,03
3,00	138,00	-0,04	0,04	0,06	131,57	-0,93	-0,52	1,07	209,20
3,50	137,50	-0,01	-0,03	0,03	258,43	-0,90	-0,56	1,06	212,15
4,00	137,00	0,01	0,02	0,02	60,00	-0,89	-0,54	1,04	211,04
4,50	136,50	-0,03	0,01	0,03	168,43	-0,90	-0,55	1,06	211,50
5,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,87	-0,56	1,04	212,56
5,50	135,50	0,01	-0,02	0,03	285,00	-0,87	-0,56	1,04	212,56
6,00	135,00	0,00	-0,01	0,01	285,00	-0,88	-0,53	1,03	211,23
6,50	134,50	0,00	-0,04	0,04	266,57	-0,88	-0,52	1,03	210,56
7,00	134,00	0,01	-0,02	0,03	285,00	-0,88	-0,48	1,00	208,69
7,50	133,50	0,02	-0,02	0,03	311,57	-0,89	-0,46	1,00	207,30
8,00	133,00	0,01	-0,02	0,02	285,00	-0,91	-0,44	1,01	205,75
8,50	132,50	-0,02	-0,06	0,06	248,13	-0,91	-0,41	1,00	204,34
9,00	132,00	-0,02	-0,07	0,07	254,04	-0,89	-0,35	0,96	201,75
9,50	131,50	-0,02	-0,01	0,02	195,00	-0,87	-0,28	0,91	198,14
10,00	131,00	-0,04	0,01	0,05	161,31	-0,84	-0,28	0,89	198,22
10,50	130,50	0,04	0,09	0,10	65,19	-0,80	-0,29	0,85	200,04
11,00	130,00	0,02	-0,03	0,04	303,43	-0,84	-0,38	0,92	204,33
11,50	129,50	-0,01	0,00	0,01	195,00	-0,86	-0,35	0,93	201,93
12,00	129,00	-0,04	-0,05	0,06	231,87	-0,85	-0,34	0,92	202,03
12,50	128,50	-0,01	-0,02	0,02	240,00	-0,81	-0,30	0,87	199,97
13,00	128,00	-0,03	-0,02	0,04	213,43	-0,80	-0,28	0,85	199,21
13,50	127,50	-0,05	-0,04	0,07	216,80	-0,77	-0,26	0,81	198,52
14,00	127,00	0,01	-0,02	0,03	285,00	-0,72	-0,22	0,75	196,91
14,50	126,50	-0,02	0,02	0,03	131,57	-0,72	-0,19	0,75	195,00
15,00	126,00	0,01	0,02	0,02	60,00	-0,71	-0,22	0,74	196,94
15,50	125,50	-0,02	-0,02	0,03	221,57	-0,71	-0,23	0,75	197,86
16,00	125,00	0,00	-0,01	0,01	285,00	-0,69	-0,21	0,73	196,97
16,50	124,50	-0,07	-0,03	0,08	204,46	-0,70	-0,20	0,73	195,99
17,00	124,00	0,02	-0,02	0,03	311,57	-0,63	-0,17	0,65	195,00
17,50	123,50	-0,02	-0,07	0,07	254,04	-0,65	-0,15	0,66	192,84
18,00	123,00	-0,11	0,09	0,14	142,87	-0,63	-0,08	0,63	187,03
18,50	122,50	0,01	-0,05	0,05	285,00	-0,51	-0,16	0,54	197,66
19,00	122,00	0,02	-0,02	0,03	311,57	-0,53	-0,11	0,54	192,34
19,50	121,50	-0,02	-0,02	0,03	221,57	-0,54	-0,09	0,55	189,81
20,00	121,00	-0,03	-0,03	0,05	228,69	-0,52	-0,08	0,53	188,21
20,50	120,50	-0,17	0,07	0,19	158,13	-0,49	-0,04	0,50	184,82
21,00	120,00	-0,05	0,09	0,10	119,04	-0,32	-0,11	0,34	199,24
21,50	119,50	-0,05	-0,01	0,05	195,00	-0,27	-0,20	0,34	216,80
22,00	119,00	-0,09	0,00	0,09	179,05	-0,22	-0,19	0,29	220,46
22,50	118,50	-0,04	-0,01	0,04	195,00	-0,13	-0,19	0,23	235,60
23,00	118,00	-0,05	-0,01	0,05	195,00	-0,09	-0,18	0,20	242,49
23,50	117,50	-0,03	-0,05	0,05	240,00	-0,05	-0,17	0,17	254,74
24,00	117,00	0,00	-0,01	0,01	285,00	-0,02	-0,12	0,12	261,04
24,50	116,50	0,00	-0,08	0,08	266,57	-0,02	-0,11	0,11	258,43
25,00	116,00	-0,02	-0,03	0,04	240,00	-0,02	-0,03	0,04	240,00

Misura inclinometrica del 14/05/2018 00:00

Data/Ora: 14/05/2018 00:00:00 Sequenza Letture: A1A3B1B3
 ID Sonda (serial number): S091260 Sensibilità sonda [sin α]: 20000
 Ch A convenzione: -1 Ch B convenzione: -1
 Profondità 1.a lettura [m]: 0,50 Intervallo letture [m]: 0,50
 Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 10/06/2015 00:00

Elaborazione dati - misura del 14/05/2018 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	140,50	-0,45	0,13	0,47	164,30	-2,07	1,54	2,58	143,31
1,00	140,00	-0,20	0,06	0,21	162,26	-1,62	1,42	2,15	138,87
1,50	139,50	-0,27	0,20	0,34	143,99	-1,42	1,35	1,96	136,46
2,00	139,00	-0,17	0,21	0,27	129,23	-1,15	1,15	1,63	134,91
2,50	138,50	-0,25	0,34	0,42	126,16	-0,98	0,94	1,36	136,05
3,00	138,00	-0,06	0,06	0,08	131,57	-0,73	0,61	0,95	140,36
3,50	137,50	0,00	-0,01	0,01	285,00	-0,68	0,54	0,87	141,21
4,00	137,00	-0,02	0,02	0,03	131,57	-0,68	0,56	0,88	140,73
4,50	136,50	-0,02	0,01	0,02	150,00	-0,66	0,53	0,85	141,03
5,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,53	0,83	140,84
5,50	135,50	0,03	-0,01	0,03	348,43	-0,65	0,53	0,83	140,84
6,00	135,00	-0,01	0,00	0,01	195,00	-0,67	0,53	0,86	141,70
6,50	134,50	-0,01	0,00	0,01	195,00	-0,66	0,53	0,85	141,03
7,00	134,00	0,01	0,00	0,01	15,00	-0,65	0,54	0,84	140,34
7,50	133,50	-0,01	-0,03	0,03	258,43	-0,66	0,53	0,85	141,03
8,00	133,00	0,01	-0,05	0,05	285,00	-0,66	0,56	0,86	139,38
8,50	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,61	0,91	137,59
9,00	132,00	0,00	-0,04	0,04	266,57	-0,67	0,61	0,91	137,59
9,50	131,50	-0,03	0,02	0,04	150,00	-0,67	0,65	0,93	135,70
10,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,64	0,63	0,90	135,14
10,50	130,50	0,06	0,08	0,10	54,81	-0,64	0,63	0,90	135,14
11,00	130,00	0,03	-0,02	0,04	330,00	-0,69	0,55	0,89	141,38
11,50	129,50	0,01	0,04	0,05	71,31	-0,72	0,57	0,92	141,71
12,00	129,00	-0,01	-0,05	0,06	258,43	-0,74	0,53	0,91	144,40
12,50	128,50	0,01	0,02	0,02	60,00	-0,73	0,58	0,93	141,25
13,00	128,00	-0,02	0,03	0,04	123,43	-0,73	0,57	0,93	142,33
13,50	127,50	-0,03	0,01	0,03	168,43	-0,71	0,53	0,89	143,16
14,00	127,00	0,01	-0,04	0,04	285,00	-0,69	0,53	0,87	142,37
14,50	126,50	-0,02	0,06	0,06	105,00	-0,69	0,56	0,90	140,91
15,00	126,00	0,03	0,05	0,05	60,00	-0,68	0,50	0,85	143,40
15,50	125,50	-0,01	0,05	0,05	105,00	-0,71	0,46	0,84	146,99
16,00	125,00	0,02	-0,02	0,03	311,57	-0,69	0,41	0,80	149,37
16,50	124,50	-0,02	-0,01	0,03	195,00	-0,71	0,43	0,83	148,78
17,00	124,00	0,00	0,01	0,01	105,00	-0,69	0,44	0,81	147,51
17,50	123,50	-0,05	-0,01	0,05	195,00	-0,68	0,43	0,80	148,11
18,00	123,00	-0,16	0,11	0,20	144,81	-0,64	0,44	0,77	145,40
18,50	122,50	-0,01	-0,02	0,02	240,00	-0,48	0,33	0,58	145,60
19,00	122,00	-0,03	0,01	0,03	168,43	-0,47	0,34	0,58	143,85
19,50	121,50	-0,01	-0,03	0,03	258,43	-0,44	0,34	0,55	142,65
20,00	121,00	-0,11	0,03	0,12	162,99	-0,43	0,36	0,57	140,10
20,50	120,50	-0,21	0,14	0,25	145,91	-0,32	0,33	0,46	134,36
21,00	120,00	0,00	0,12	0,12	92,47	-0,12	0,19	0,22	121,39
21,50	119,50	-0,08	0,04	0,09	150,00	-0,11	0,07	0,13	146,19
22,00	119,00	-0,02	0,02	0,03	131,57	-0,03	0,03	0,05	138,69
22,50	118,50	0,01	0,00	0,01	15,00	-0,02	0,01	0,02	150,00
23,00	118,00	0,01	-0,02	0,02	285,00	-0,03	0,01	0,03	168,43
23,50	117,50	-0,01	-0,02	0,02	240,00	-0,03	0,03	0,05	138,69
24,00	117,00	0,00	0,04	0,04	86,57	-0,03	0,05	0,05	119,04
24,50	116,50	-0,01	-0,02	0,02	240,00	-0,03	0,01	0,03	168,43
25,00	116,00	-0,02	0,02	0,03	131,57	-0,02	0,02	0,03	131,57

Misura inclinometrica del 05/06/2019 00:00

Data/Ora: 05/06/2019 00:00:00

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S091260

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1

Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50

Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 10/06/2015 00:00

Elaborazione dati - misura del 05/06/2019 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	140,50	-0,06	-0,02	0,06	195,00	-2,14	1,56	2,65	143,87
1,00	140,00	-0,10	0,41	0,43	103,32	-2,08	1,58	2,61	142,80
1,50	139,50	-0,26	0,45	0,52	120,38	-1,98	1,16	2,30	149,56
2,00	139,00	-0,25	0,39	0,46	122,45	-1,72	0,72	1,86	157,36
2,50	138,50	-0,29	0,41	0,51	125,22	-1,47	0,33	1,51	167,37
3,00	138,00	-0,09	0,09	0,13	134,05	-1,18	-0,08	1,18	184,05
3,50	137,50	-0,02	-0,03	0,04	240,00	-1,09	-0,18	1,11	189,16
4,00	137,00	0,06	0,02	0,06	15,00	-1,07	-0,15	1,08	187,71
4,50	136,50	-0,03	-0,02	0,04	213,43	-1,13	-0,16	1,15	188,11
5,00	136,00	-0,01	-0,02	0,02	240,00	-1,10	-0,14	1,11	187,23
5,50	135,50	0,02	-0,01	0,02	330,00	-1,09	-0,12	1,10	186,50
6,00	135,00	-0,03	-0,02	0,04	213,43	-1,11	-0,12	1,11	185,96
6,50	134,50	-0,02	-0,02	0,03	221,57	-1,07	-0,09	1,08	184,99
7,00	134,00	-0,02	-0,02	0,03	221,57	-1,05	-0,08	1,06	184,09
7,50	133,50	0,01	-0,02	0,03	285,00	-1,03	-0,06	1,03	183,15
8,00	133,00	-0,01	-0,02	0,02	240,00	-1,04	-0,03	1,04	181,80
8,50	132,50	-0,01	-0,04	0,05	251,31	-1,03	-0,02	1,03	180,96
9,00	132,00	-0,02	-0,08	0,08	258,43	-1,02	0,03	1,02	178,57
9,50	131,50	-0,02	0,01	0,02	150,00	-1,00	0,11	1,01	173,86
10,00	131,00	0,01	-0,02	0,03	285,00	-0,98	0,10	0,99	174,27
10,50	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,12	1,00	172,93
11,00	130,00	0,02	-0,02	0,03	311,57	-0,99	0,12	1,00	172,93
11,50	129,50	0,01	0,02	0,02	60,00	-1,01	0,14	1,02	171,89
12,00	129,00	0,00	-0,09	0,09	269,05	-1,02	0,13	1,03	172,81
12,50	128,50	-0,02	0,01	0,02	150,00	-1,02	0,22	1,04	167,82
13,00	128,00	-0,02	-0,02	0,03	221,57	-1,00	0,21	1,02	168,12
13,50	127,50	0,00	-0,01	0,01	285,00	-0,98	0,23	1,01	166,84
14,00	127,00	0,00	-0,01	0,01	285,00	-0,98	0,24	1,01	166,22
14,50	126,50	-0,10	0,04	0,11	159,46	-0,99	0,25	1,02	165,60
15,00	126,00	0,00	0,14	0,14	89,74	-0,89	0,22	0,91	166,33
15,50	125,50	-0,02	-0,01	0,02	195,00	-0,89	0,07	0,89	175,29
16,00	125,00	0,00	-0,01	0,01	285,00	-0,86	0,08	0,87	174,73
16,50	124,50	-0,02	-0,01	0,03	195,00	-0,87	0,09	0,87	173,96
17,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,84	0,10	0,85	173,36
17,50	123,50	-0,03	-0,03	0,05	228,69	-0,84	0,10	0,85	173,36
18,00	123,00	-0,18	0,09	0,20	152,49	-0,81	0,13	0,82	170,77
18,50	122,50	0,06	-0,06	0,08	311,57	-0,63	0,04	0,63	176,57
19,00	122,00	0,01	-0,04	0,04	285,00	-0,69	0,10	0,69	171,67
19,50	121,50	-0,04	0,00	0,04	176,57	-0,70	0,14	0,71	168,89
20,00	121,00	-0,15	0,01	0,15	175,02	-0,66	0,13	0,67	168,43
20,50	120,50	-0,28	0,18	0,34	146,99	-0,51	0,12	0,53	166,61
21,00	120,00	-0,02	0,08	0,09	105,00	-0,23	-0,06	0,24	195,00
21,50	119,50	-0,07	0,01	0,07	173,20	-0,21	-0,15	0,25	215,22
22,00	119,00	-0,02	0,02	0,03	131,57	-0,14	-0,15	0,21	227,74
22,50	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,17	0,21	235,24
23,00	118,00	-0,01	-0,04	0,05	251,31	-0,12	-0,17	0,21	235,24
23,50	117,50	-0,05	-0,05	0,07	225,96	-0,11	-0,13	0,17	231,03
24,00	117,00	-0,02	-0,03	0,04	240,00	-0,06	-0,08	0,10	234,81
24,50	116,50	-0,03	-0,05	0,05	240,00	-0,04	-0,05	0,06	231,87
25,00	116,00	-0,01	0,00	0,01	195,00	-0,01	0,00	0,01	195,00

Misura inclinometrica del 15/06/2023 00:00

Data/Ora: 15/06/2023 00:00:00	Sequenza Letture: A1A3B1B3
ID Sonda (serial number): S091260	Sensibilità sonda [sin α]: 20000
Ch A convenzione: -1	Ch B convenzione: -1
Profondità 1.a lettura [m]: 0,5	Intervallo letture [m]: 0,50
Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 10/06/2015 00:00	

Elaborazione dati - misura del 15/06/2023 00:00									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	140,50	0,09	0,15	0,18	60,00	-4,15	3,30	5,30	141,46
1,00	140,00	-0,03	0,50	0,50	93,41	-4,23	3,15	5,28	143,36
1,50	139,50	-0,27	0,61	0,67	113,58	-4,20	2,65	4,97	147,76
2,00	139,00	-0,48	0,69	0,84	125,06	-3,94	2,04	4,43	152,63
2,50	138,50	-0,51	0,66	0,84	127,75	-3,46	1,35	3,71	158,63
3,00	138,00	-0,14	0,17	0,22	128,63	-2,94	0,69	3,02	166,84
3,50	137,50	-0,06	-0,02	0,06	195,00	-2,80	0,52	2,85	169,56
4,00	137,00	-0,03	0,02	0,04	150,00	-2,74	0,53	2,80	169,01
4,50	136,50	-0,06	0,02	0,06	158,13	-2,71	0,52	2,76	169,25
5,00	136,00	-0,02	0,01	0,02	150,00	-2,66	0,49	2,70	169,50
5,50	135,50	0,00	-0,01	0,01	285,00	-2,64	0,48	2,68	169,63
6,00	135,00	-0,02	-0,01	0,02	195,00	-2,64	0,50	2,69	169,39
6,50	134,50	-0,03	-0,03	0,05	228,69	-2,62	0,50	2,67	169,16
7,00	134,00	0,01	-0,04	0,04	285,00	-2,59	0,54	2,64	168,31
7,50	133,50	-0,02	-0,02	0,03	221,57	-2,60	0,57	2,66	167,59
8,00	133,00	-0,04	-0,04	0,06	221,57	-2,58	0,59	2,64	167,10
8,50	132,50	-0,03	-0,03	0,05	228,69	-2,54	0,63	2,61	166,11
9,00	132,00	0,01	-0,05	0,05	285,00	-2,51	0,66	2,59	165,22
9,50	131,50	-0,01	-0,03	0,03	258,43	-2,52	0,71	2,62	164,27
10,00	131,00	-0,13	-0,05	0,14	200,19	-2,51	0,74	2,62	163,66
10,50	130,50	0,04	0,01	0,04	15,00	-2,38	0,78	2,51	161,78
11,00	130,00	-0,07	-0,08	0,11	230,54	-2,42	0,77	2,54	162,25
11,50	129,50	0,02	0,01	0,03	15,00	-2,35	0,86	2,50	159,96
12,00	129,00	-0,01	-0,03	0,03	258,43	-2,38	0,85	2,52	160,29
12,50	128,50	-0,04	-0,04	0,06	221,57	-2,37	0,88	2,53	159,66
13,00	128,00	-0,01	-0,04	0,05	251,31	-2,33	0,92	2,50	158,53
13,50	127,50	-0,07	-0,02	0,07	195,00	-2,31	0,96	2,51	157,50
14,00	127,00	-0,02	-0,01	0,02	195,00	-2,24	0,98	2,45	156,43
14,50	126,50	-0,04	0,01	0,05	161,31	-2,22	0,98	2,43	156,06
15,00	126,00	-0,01	0,04	0,04	105,00	-2,18	0,97	2,38	155,96
15,50	125,50	-0,06	-0,03	0,06	206,31	-2,17	0,93	2,36	156,67
16,00	125,00	-0,05	-0,03	0,05	209,04	-2,11	0,96	2,32	155,47
16,50	124,50	-0,04	0,00	0,04	176,57	-2,06	0,99	2,29	154,43
17,00	124,00	-0,01	0,00	0,01	195,00	-2,02	0,98	2,25	154,05
17,50	123,50	-0,10	0,00	0,10	180,96	-2,01	0,99	2,24	153,84
18,00	123,00	-0,33	0,25	0,41	142,57	-1,91	0,99	2,15	152,59
18,50	122,50	-0,01	-0,02	0,02	240,00	-1,58	0,74	1,75	154,93
19,00	122,00	-0,01	-0,02	0,02	240,00	-1,57	0,76	1,75	154,35
19,50	121,50	-0,04	-0,01	0,04	195,00	-1,57	0,77	1,75	153,78
20,00	121,00	-0,35	0,11	0,37	162,38	-1,53	0,78	1,72	152,95
20,50	120,50	-0,72	0,42	0,83	150,00	-1,18	0,67	1,35	150,37
21,00	120,00	-0,11	0,15	0,19	124,65	-0,46	0,25	0,52	150,97
21,50	119,50	-0,07	0,03	0,08	156,34	-0,35	0,10	0,36	164,04
22,00	119,00	-0,08	0,02	0,08	168,43	-0,28	0,07	0,29	166,19
22,50	118,50	-0,04	0,01	0,05	161,31	-0,19	0,05	0,20	165,26
23,00	118,00	0,05	0,04	0,07	36,80	-0,15	0,04	0,16	166,39
23,50	117,50	-0,09	-0,01	0,09	186,87	-0,21	0,00	0,21	180,96
24,00	117,00	-0,05	0,04	0,06	141,87	-0,12	0,01	0,12	176,57
24,50	116,50	-0,04	-0,04	0,06	221,57	-0,07	-0,03	0,08	204,46
25,00	116,00	-0,03	0,01	0,03	168,43	-0,03	0,01	0,03	168,43

Misura inclinometrica del 22/07/2024 08:06

Data/Ora: 22/07/2024 08:06:57

Sequenza Letture: A1A3B1B3

ID Sonda (serial number): S222643

Sensibilità sonda [sin α]: 20000

Ch A convenzione: -1

Ch B convenzione: -1


Profondità 1.a lettura [m]: 0,50

Intervallo letture [m]: 0,50


Misura di riferimento: Misura inclinometrica del 10/06/2015 00:00

Elaborazione dati - misura del 22/07/2024 08:06									
Prof [m]	Quota [m slm]	Mov. rel. Nord [mm]	Mov. rel. Est [mm]	Mov. rel. Risultante [mm]	Azimuth Mov. rel. [°]	Σ Mov. rel. Nord [mm]	Σ Mov. rel. Est [mm]	Σ Mov. rel. Risultante [mm]	Σ Azimuth Mov. rel. [°]
0,50	140,50	0,11	0,36	0,38	72,95	-4,59	4,04	6,11	138,64
1,00	140,00	-0,03	0,67	0,67	92,19	-4,70	3,68	5,96	141,94
1,50	139,50	-0,27	0,75	0,80	109,56	-4,67	3,00	5,55	147,24
2,00	139,00	-0,52	0,81	0,97	122,80	-4,40	2,25	4,94	152,92
2,50	138,50	-0,55	0,75	0,93	126,37	-3,88	1,44	4,13	159,67
3,00	138,00	-0,14	0,17	0,22	130,14	-3,33	0,69	3,40	168,28
3,50	137,50	-0,06	-0,02	0,06	197,64	-3,18	0,52	3,23	170,73
4,00	137,00	-0,03	0,02	0,04	147,02	-3,12	0,54	3,17	170,22
4,50	136,50	-0,06	0,02	0,06	160,62	-3,09	0,52	3,14	170,49
5,00	136,00	-0,01	0,00	0,01	193,09	-3,03	0,50	3,07	170,69
5,50	135,50	0,00	-0,01	0,01	270,07	-3,03	0,50	3,07	170,64
6,00	135,00	-0,02	-0,03	0,03	228,86	-3,03	0,51	3,07	170,39
6,50	134,50	-0,03	-0,02	0,04	217,36	-3,00	0,54	3,05	169,83
7,00	134,00	0,01	-0,05	0,05	286,71	-2,97	0,56	3,02	169,30
7,50	133,50	-0,02	-0,03	0,03	233,88	-2,99	0,61	3,05	168,46
8,00	133,00	-0,04	-0,04	0,05	225,87	-2,97	0,64	3,03	167,86
8,50	132,50	-0,03	-0,03	0,04	228,69	-2,93	0,68	3,01	167,01
9,00	132,00	0,00	-0,04	0,04	268,67	-2,90	0,71	2,99	166,29
9,50	131,50	-0,01	-0,04	0,04	254,91	-2,90	0,75	3,00	165,47
10,00	131,00	-0,13	-0,04	0,14	197,32	-2,89	0,79	3,00	164,77
10,50	130,50	0,03	0,00	0,03	4,95	-2,76	0,83	2,88	163,29
11,00	130,00	-0,07	-0,08	0,10	228,85	-2,79	0,83	2,91	163,49
11,50	129,50	0,03	0,00	0,03	2,47	-2,72	0,90	2,86	161,63
12,00	129,00	-0,02	-0,03	0,03	236,50	-2,75	0,90	2,89	161,85
12,50	128,50	-0,06	-0,04	0,07	213,02	-2,73	0,93	2,89	161,27
13,00	128,00	-0,02	-0,06	0,06	250,75	-2,68	0,96	2,85	160,23
13,50	127,50	-0,08	-0,01	0,08	187,11	-2,66	1,02	2,85	158,94
14,00	127,00	-0,03	-0,01	0,03	204,28	-2,58	1,03	2,78	158,16
14,50	126,50	-0,05	0,01	0,05	168,38	-2,55	1,05	2,75	157,67
15,00	126,00	-0,02	0,05	0,05	117,31	-2,50	1,04	2,70	157,46
15,50	125,50	-0,07	-0,05	0,08	214,41	-2,47	0,99	2,66	158,18
16,00	125,00	-0,05	-0,02	0,05	199,49	-2,40	1,04	2,62	156,66
16,50	124,50	-0,03	-0,01	0,03	199,01	-2,35	1,05	2,58	155,84
17,00	124,00	0,00	-0,02	0,02	263,09	-2,32	1,07	2,55	155,31
17,50	123,50	-0,10	-0,01	0,10	186,88	-2,32	1,09	2,56	154,81
18,00	123,00	-0,33	0,26	0,42	141,97	-2,21	1,10	2,47	153,56
18,50	122,50	-0,01	-0,02	0,02	244,18	-1,88	0,84	2,06	155,93
19,00	122,00	-0,02	-0,02	0,03	227,95	-1,87	0,86	2,06	155,42
19,50	121,50	-0,05	-0,02	0,05	204,31	-1,86	0,88	2,05	154,71
20,00	121,00	-0,40	0,14	0,43	160,77	-1,81	0,90	2,02	153,54
20,50	120,50	-0,83	0,48	0,96	149,64	-1,40	0,76	1,60	151,62
21,00	120,00	-0,13	0,16	0,21	129,30	-0,58	0,27	0,64	154,59
21,50	119,50	-0,08	0,04	0,09	153,29	-0,44	0,11	0,46	166,10
22,00	119,00	-0,09	0,01	0,09	176,81	-0,36	0,07	0,37	169,25
22,50	118,50	-0,06	0,03	0,06	151,82	-0,27	0,06	0,28	166,72
23,00	118,00	0,04	0,05	0,06	46,00	-0,21	0,03	0,21	171,11
23,50	117,50	-0,10	-0,02	0,10	188,91	-0,26	-0,01	0,26	182,92
24,00	117,00	-0,05	0,05	0,07	139,11	-0,15	0,00	0,15	178,90
24,50	116,50	-0,06	-0,04	0,07	210,69	-0,10	-0,04	0,11	203,69
25,00	116,00	-0,04	-0,01	0,04	191,46	-0,04	-0,01	0,04	191,46

Spostamento Nord [mm]

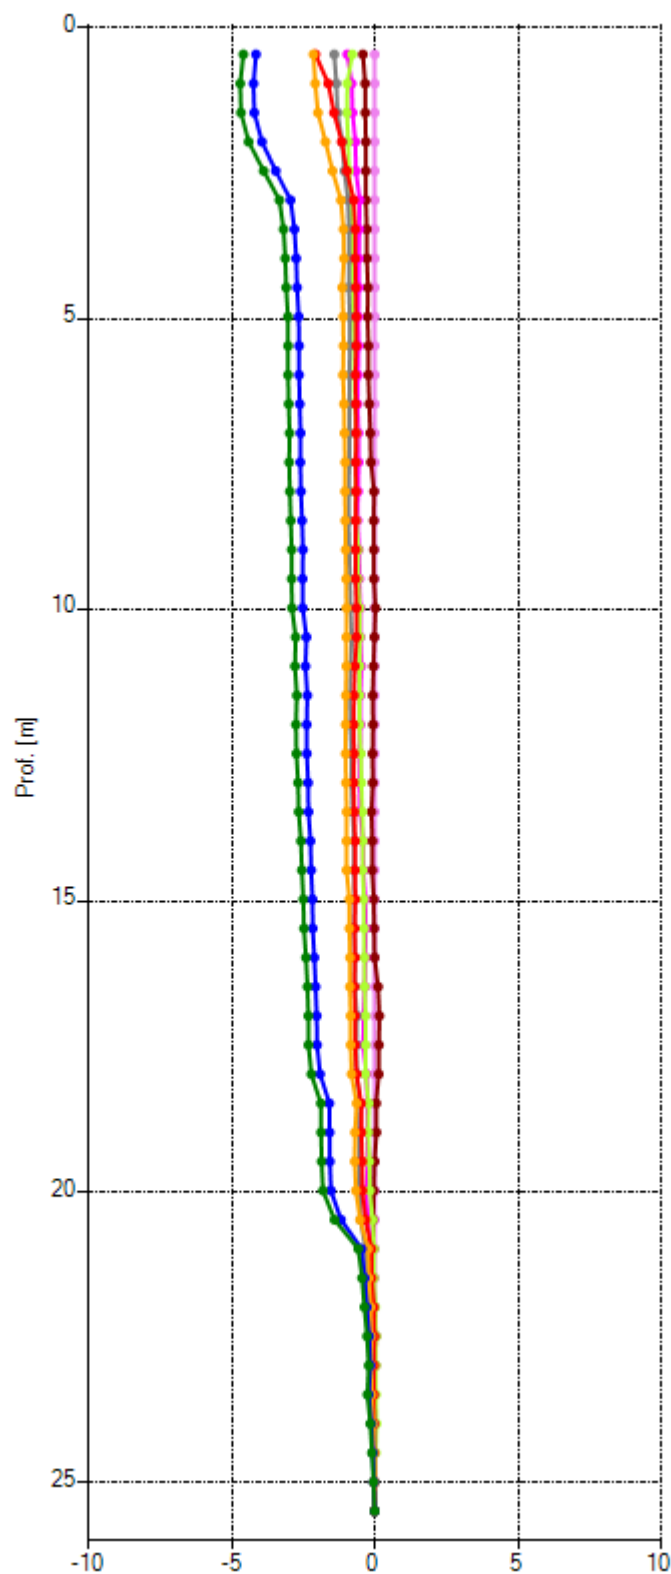


Spostamento Est [mm]

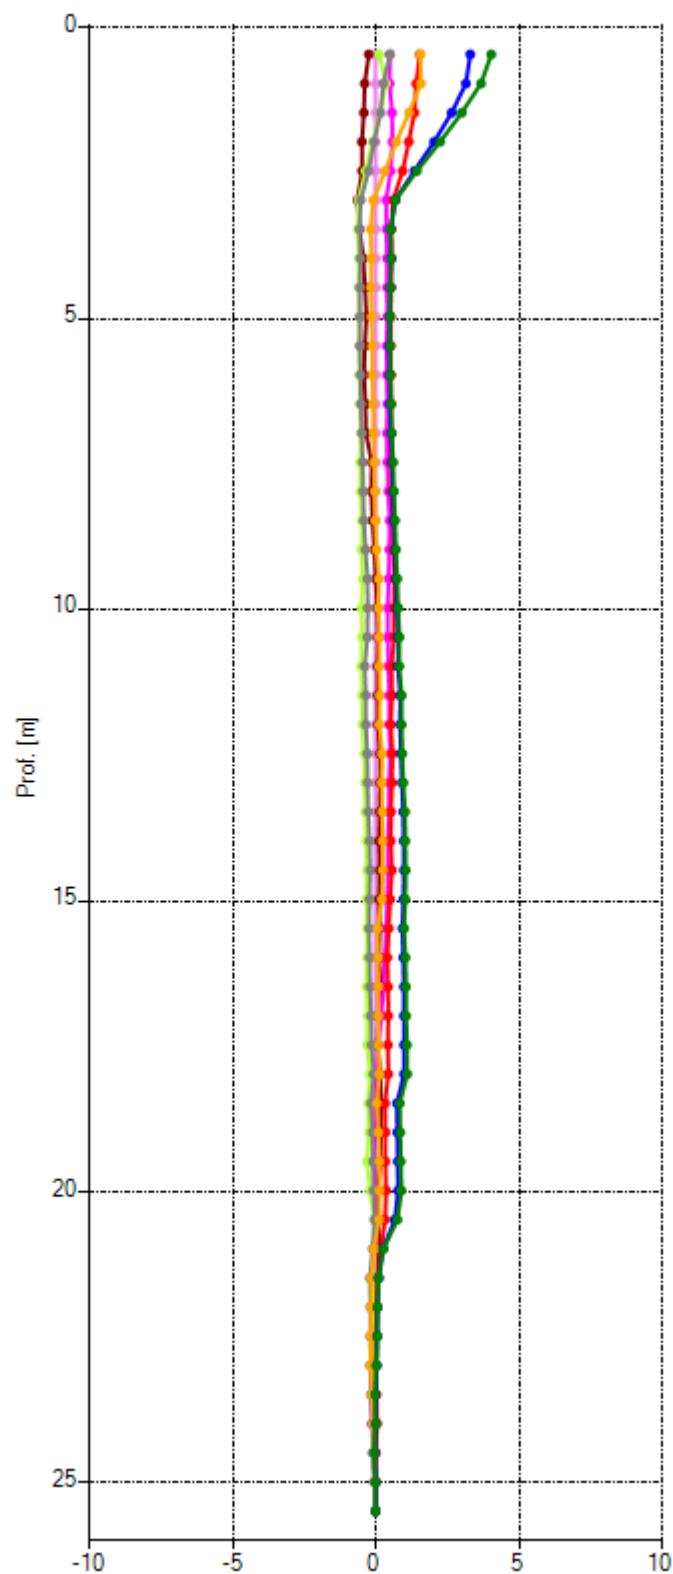


■ 22/07/2024 08:06:57
 ■ 15/06/2023 00:00:00
 ■ 05/06/2019 00:00:00
 ■ 14/05/2018 00:00:00
 ■ 08/06/2017 00:00:00
■ 08/09/2016 00:00:00
■ 11/04/2016 00:00:00
■ 15/09/2015 00:00:00
■ 10/06/2015 00:00:00

Misura inclinometrica di riferimento 10/06/2015 00:00

Curva Cumulata [mm]

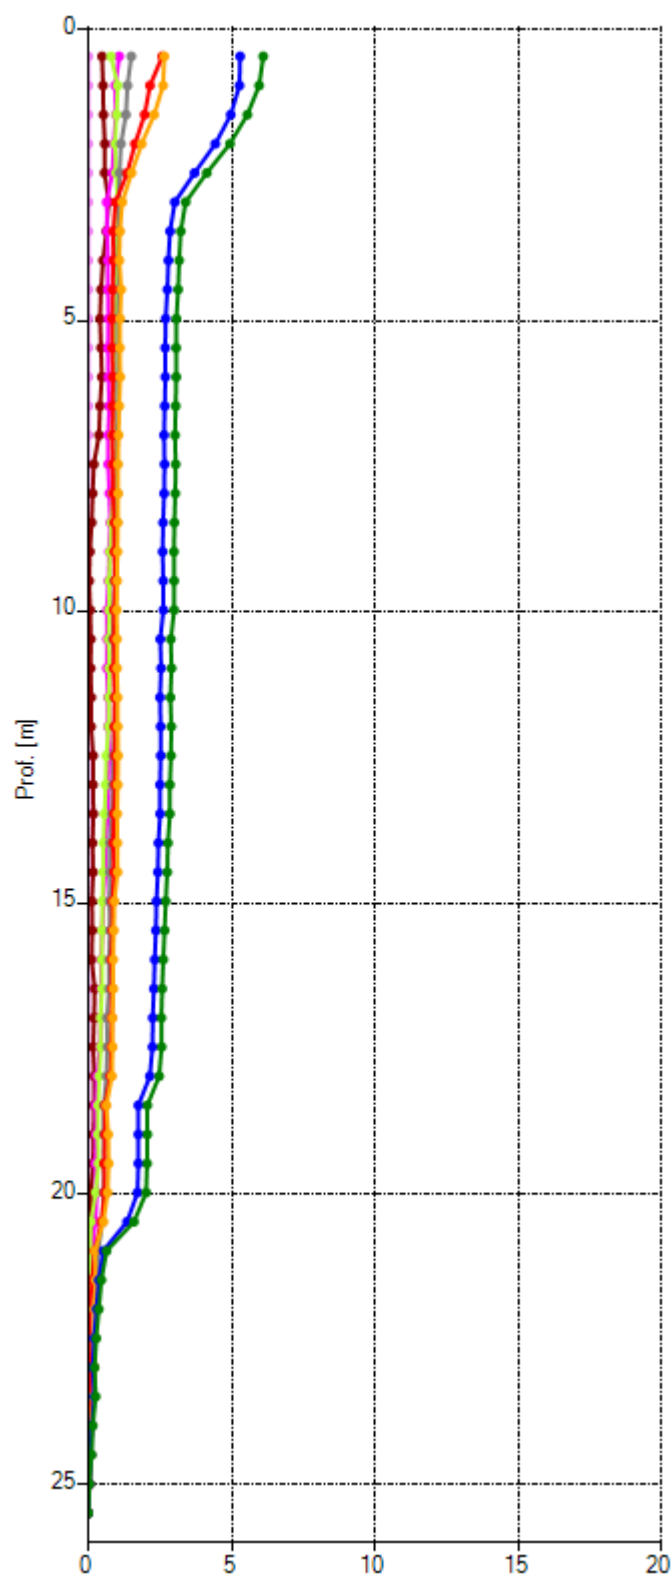

Azimuth [°]

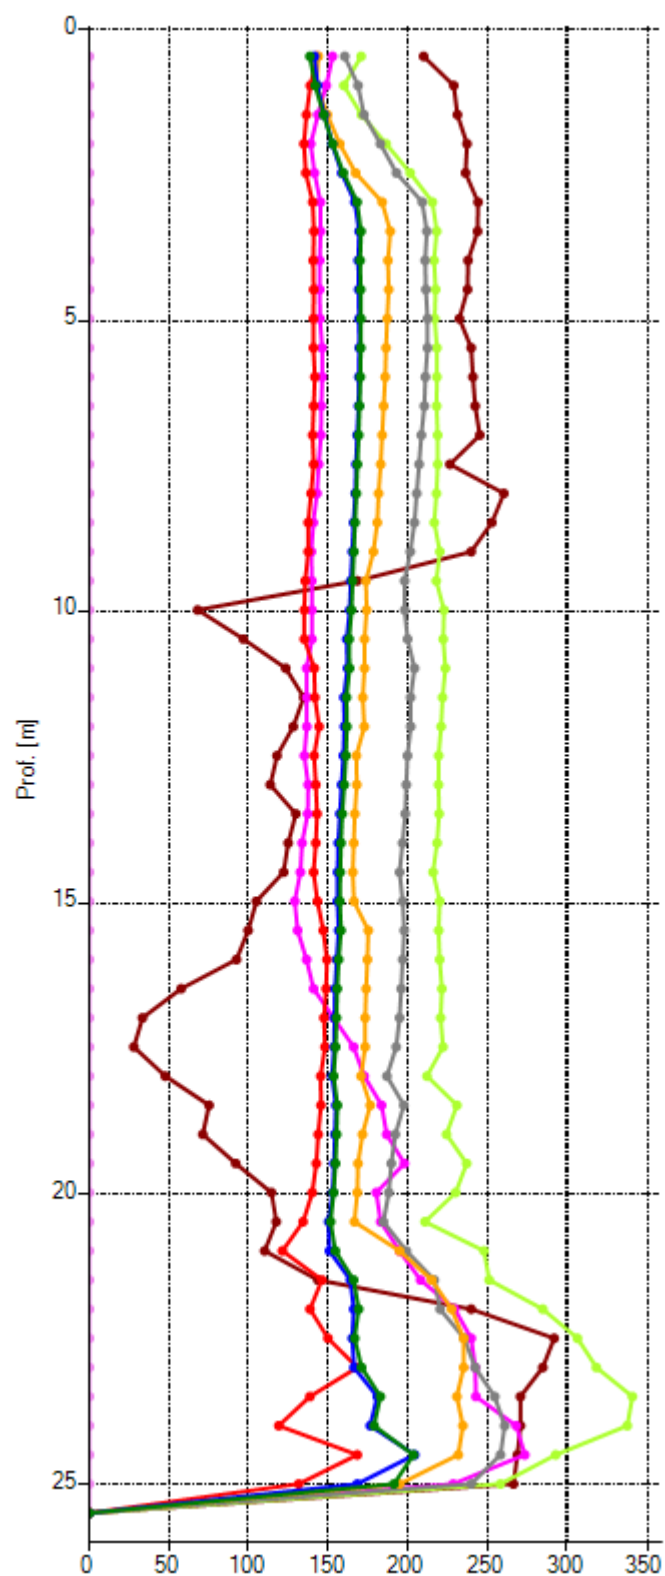


■ 22/07/2024 08:06:57 ■ 15/06/2023 00:00:00 ■ 05/06/2019 00:00:00 ■ 14/05/2018 00:00:00 ■ 08/06/2017 00:00:00
■ 08/09/2016 00:00:00 ■ 11/04/2016 00:00:00 ■ 15/09/2015 00:00:00 ■ 10/06/2015 00:00:00


Misura inclinometrica di riferimento 10/06/2015 00:00

Deformazione nel tempo


Nord

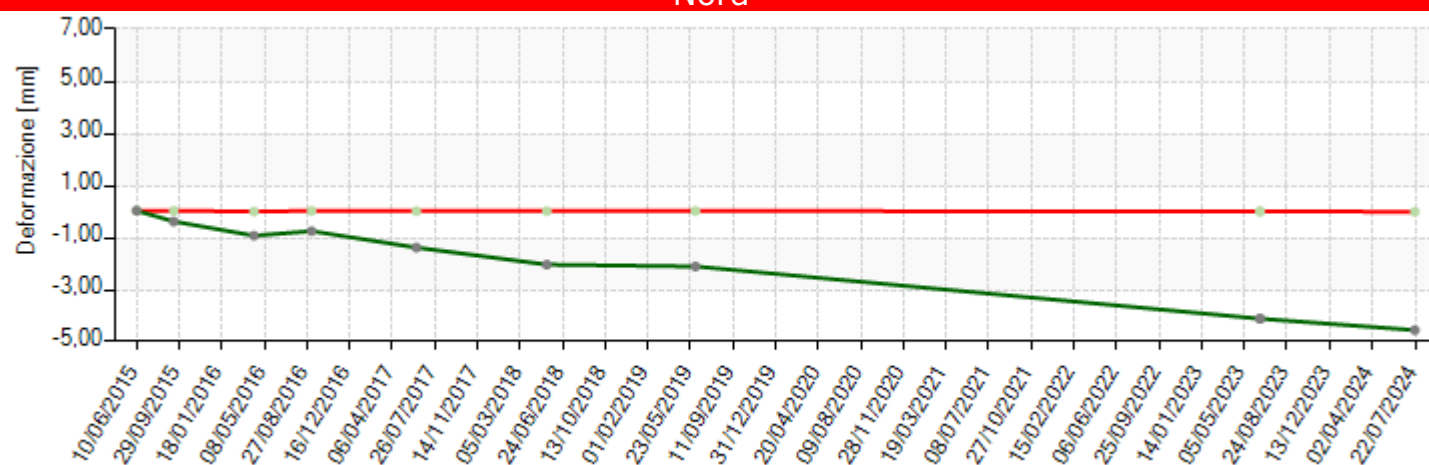

Est

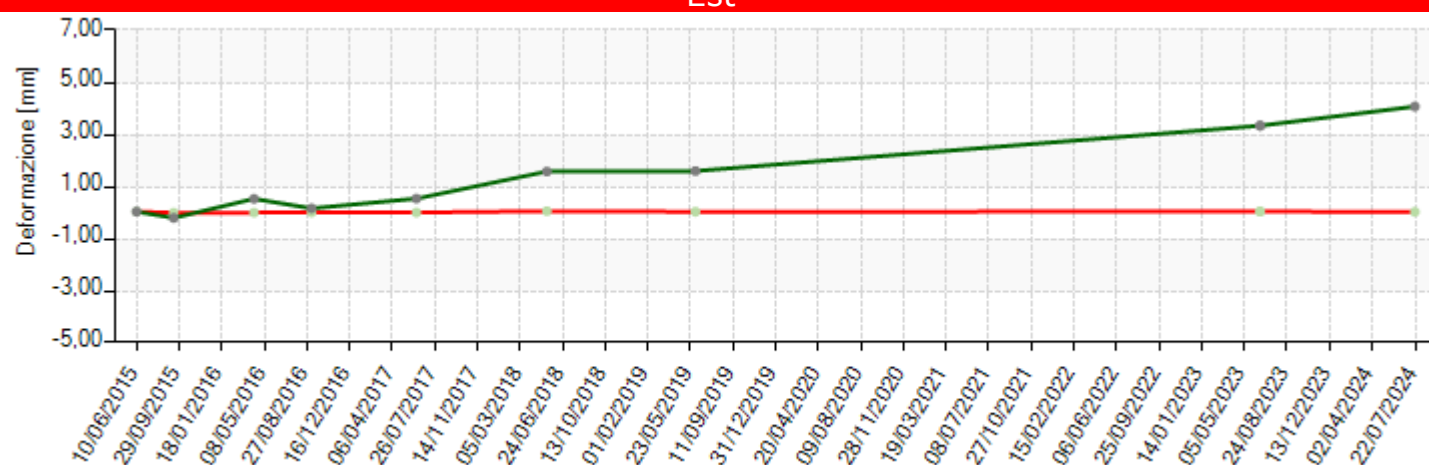

Risultante

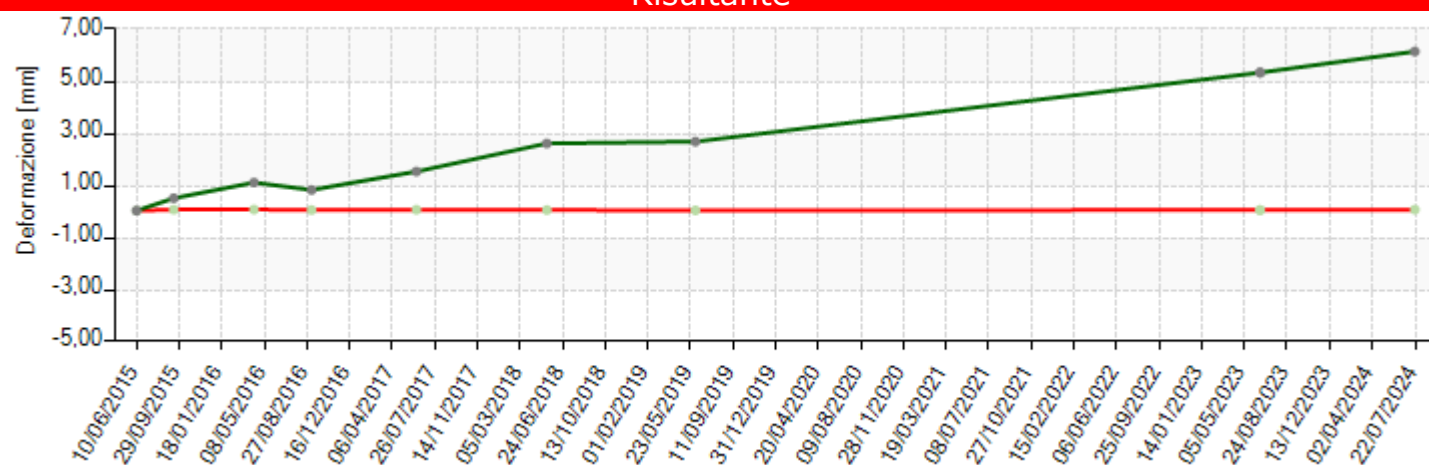

Prof.: ■ 0,50 (140,50) [m] ■ 25,00 (116,00) [m]